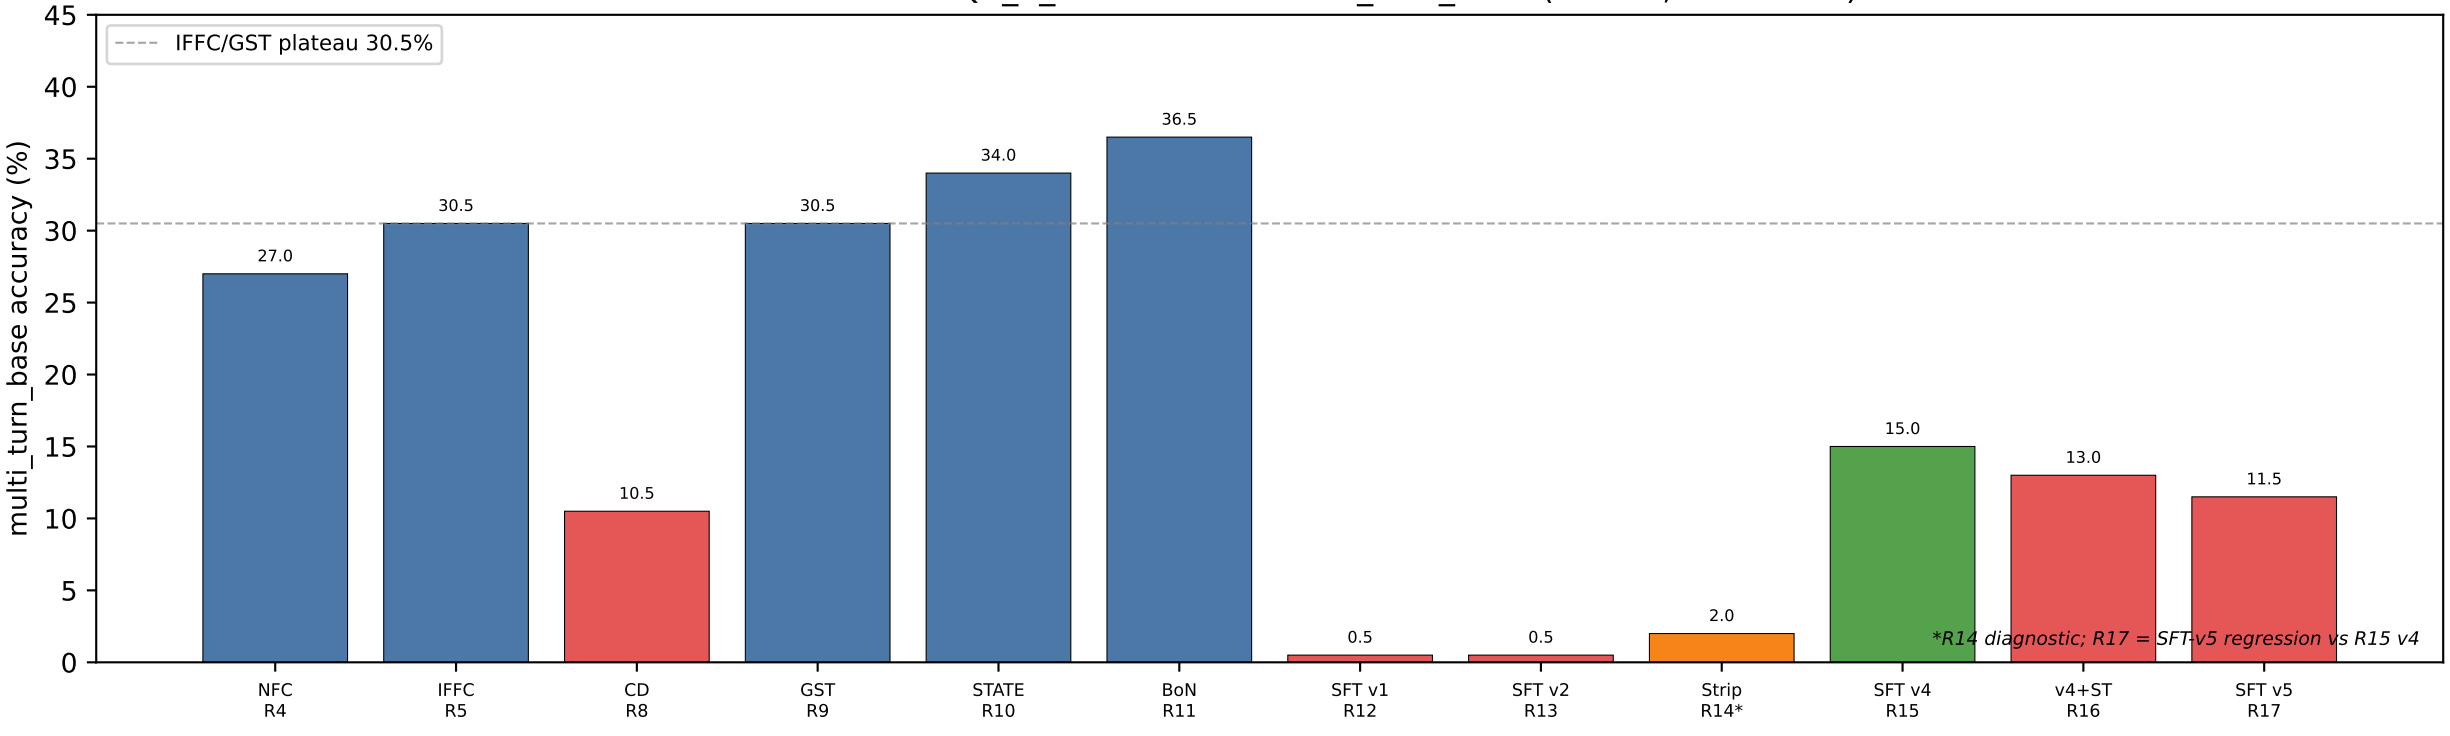
Gemma-4-E2B-it Q4_K_M — BFCL v4 multi_turn_base (n=200, Mac Metal)
multi_turn_base accuracy (%)
IFFC/GST plateau 30.5%
27.0
30.5
10.5
30.5
34.0
36.5
0.5
0.5
2.0
15.0
13.0
11.5
*R14 diagnostic; R17 = SFT-v5 regression vs R15 v4
NFC R4
IFFC R5
CD R8
GST R9
STATE R10
BoN R11
SFT v1 R12
SFT v2 R13
Strip R14*
SFT v4 R15
v4+ST R16
SFT v5 R17