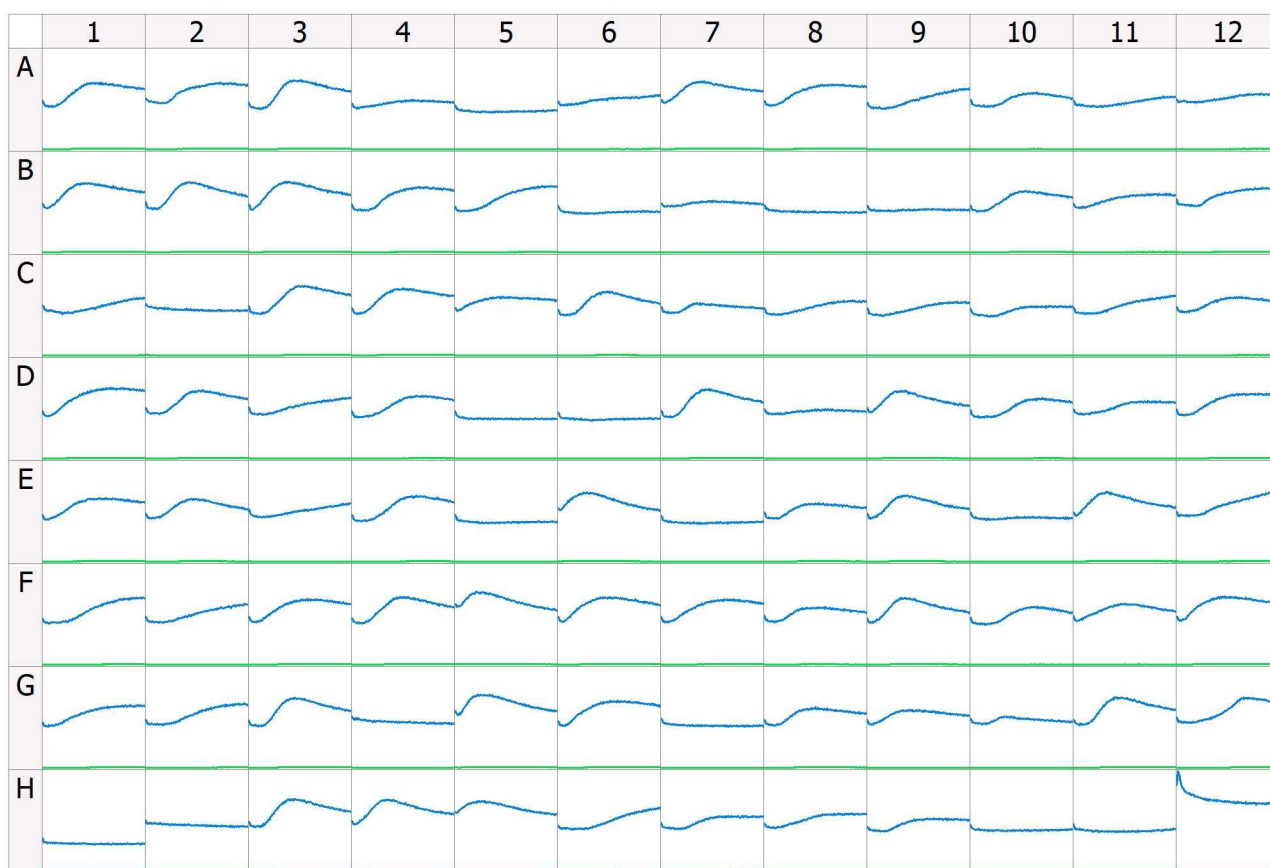


Test Name: LD PI Assay SE

Date: 9/20/2019 Time: 4:21:42 PM

ID1: Vananz plate 2 190920 ID2: HeLa death assay n4

Fluorescence (FI), multichromatic

Microplate View**Legend:**

1. Raw Data (535-15/617-20 1)
2. Raw Data (493-15/636-15 2)