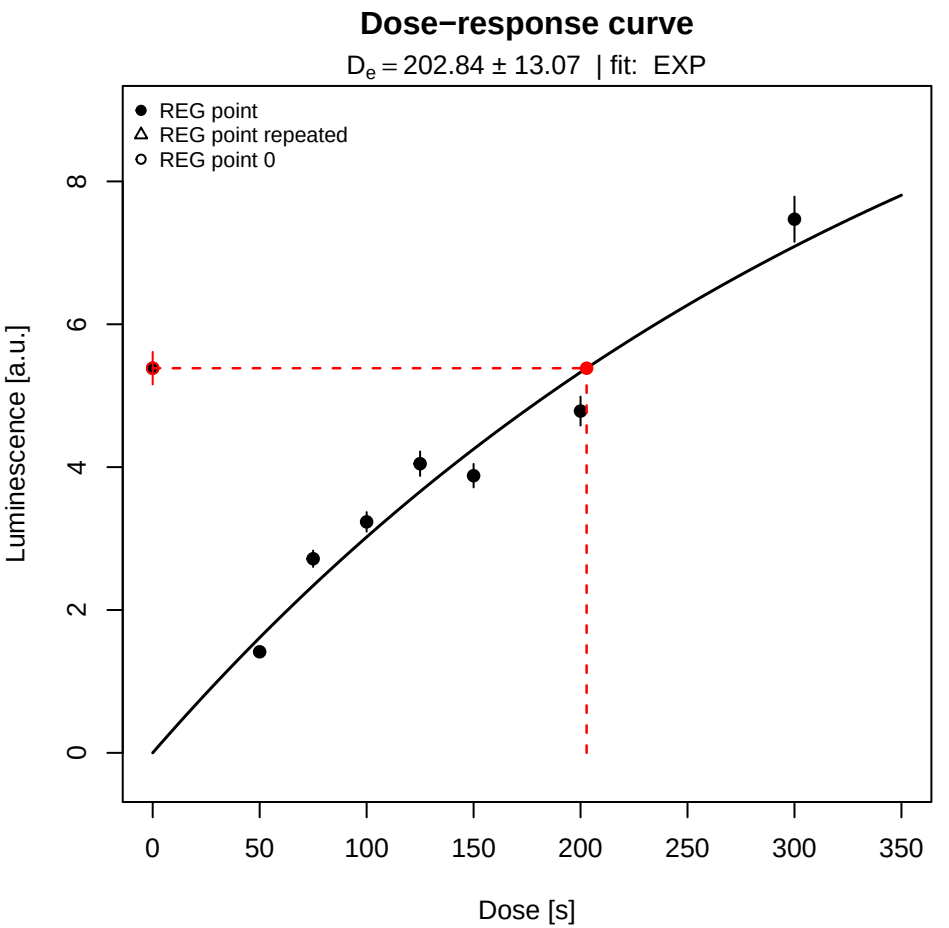
Dose−response curve
De = 202.84 ± 13.07 | fit: EXP
REG point
REG point repeated
REG point 0
Luminescence [a.u.]
0
2
4
6
8
0
50
100
150
200
250
300
350
Dose [s]

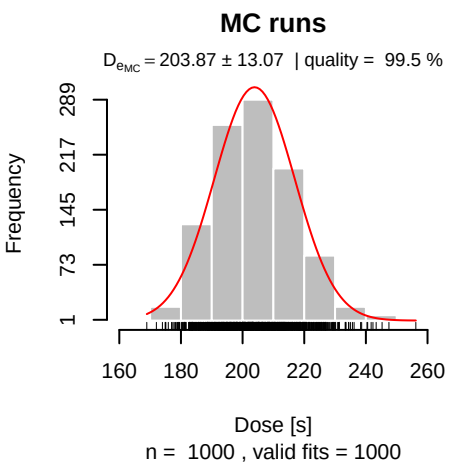
MC runs
DeMC = 203.87 ± 13.07 | quality = 99.5 %
Frequency
1
73
145
217
289
160
180
200
220
240
260
Dose [s]
n = 1000 , valid fits = 1000

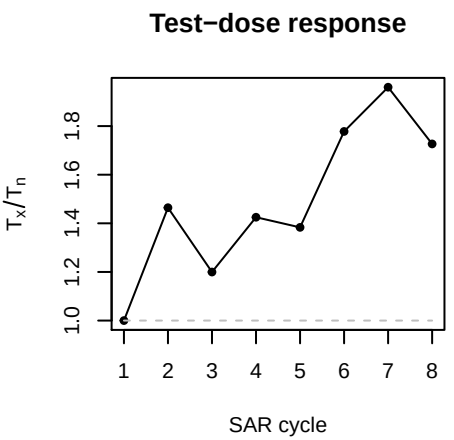
Test−dose response
Tx/Tn
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
1
2
3
4
5
6
7
8
SAR cycle