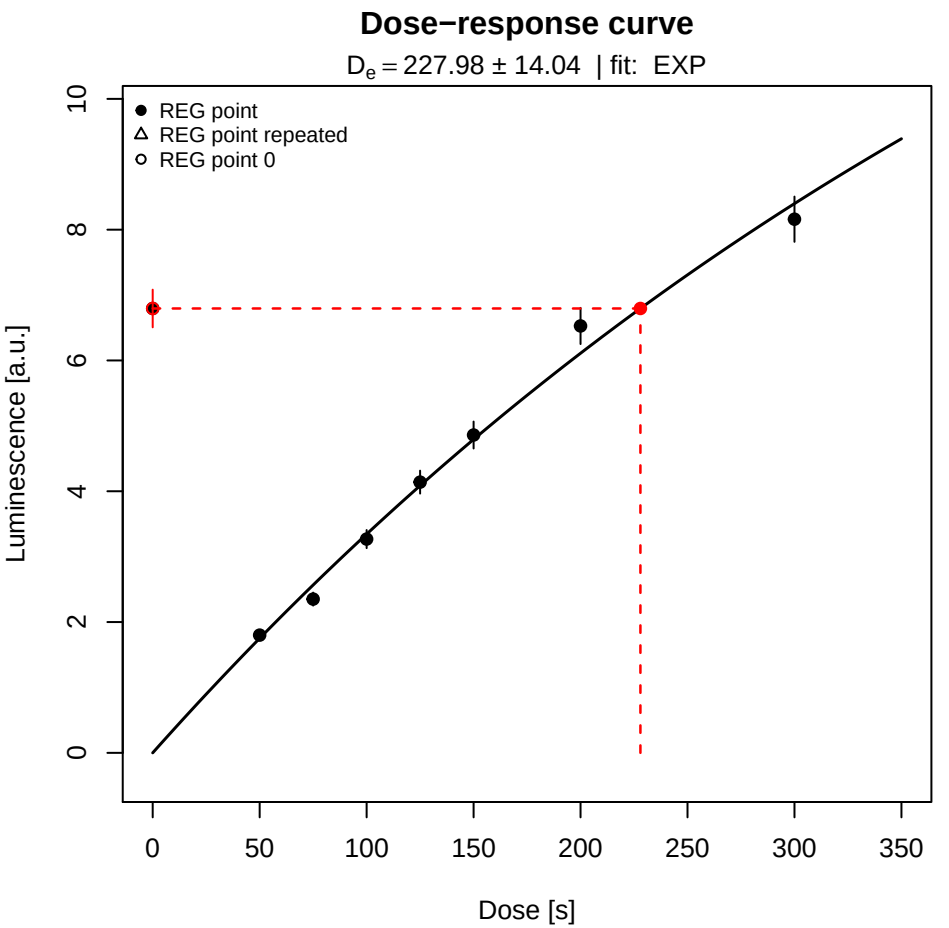
Dose−response curve
D_e = 227.98 ± 14.04 | fit: EXP
REG point
REG point repeated
REG point 0
Luminescence [a.u.]
0
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
250
300
350
Dose [s]

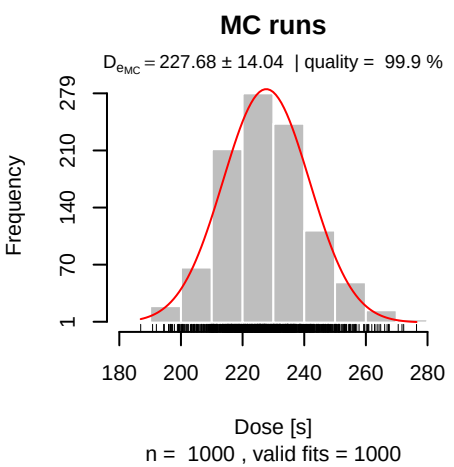
MC runs
D_eMC = 227.68 ± 14.04 | quality = 99.9 %
Frequency
1
70
140
210
279
180
200
220
240
260
280
Dose [s]
n = 1000 , valid fits = 1000

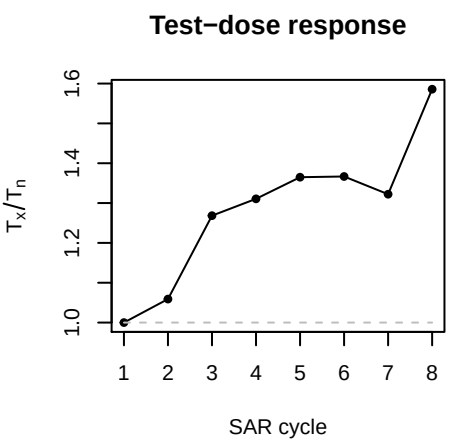
Test−dose response
T_x/T_n
1.0
1.2
1.4
1.6
1
2
3
4
5
6
7
8
SAR cycle