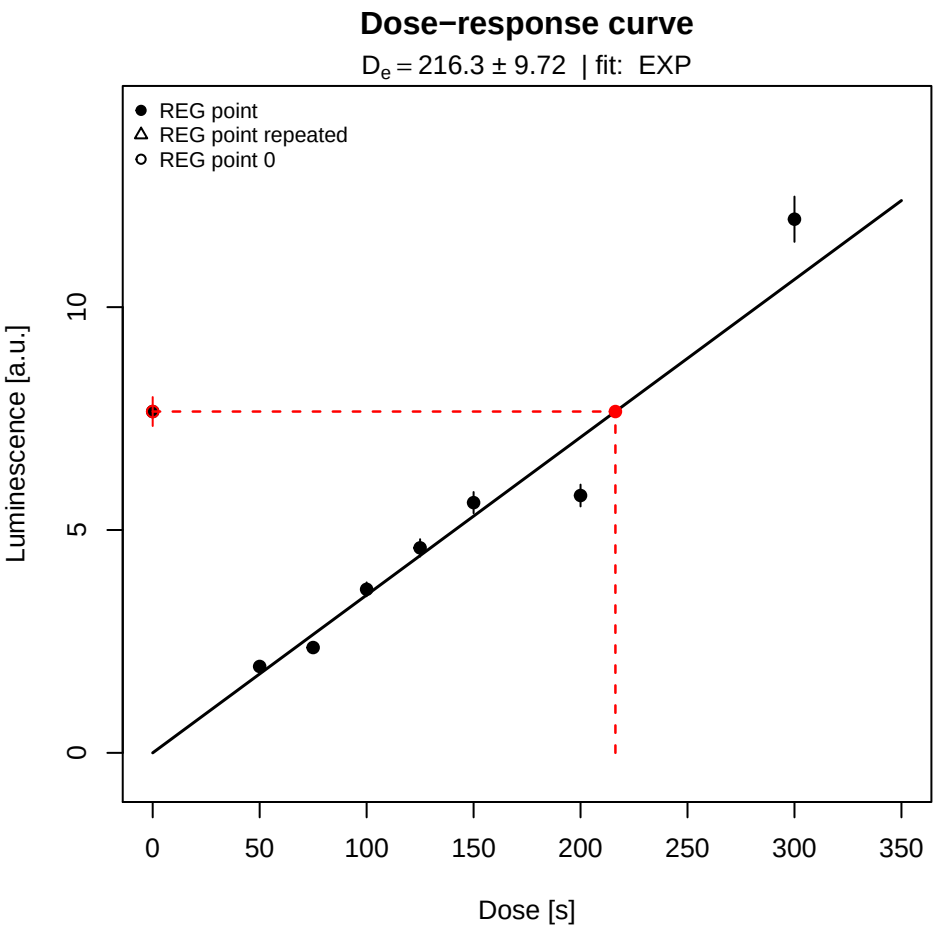
Dose−response curve
De = 216.3 ± 9.72 | fit: EXP
REG point
REG point repeated
REG point 0
Luminescence [a.u.]
0
5
10
0
50
100
150
200
250
300
350
Dose [s]

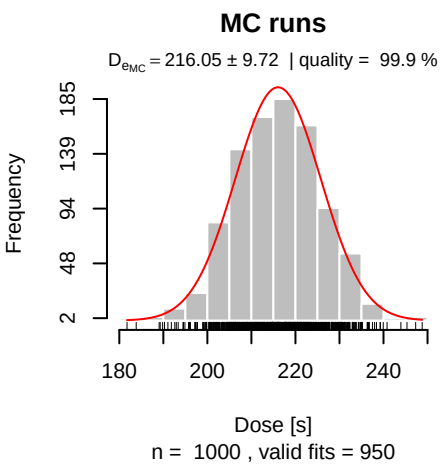
MC runs
DeMC = 216.05 ± 9.72 | quality = 99.9 %
Frequency
2
48
94
139
185
180
200
220
240
Dose [s]
n = 1000 , valid fits = 950

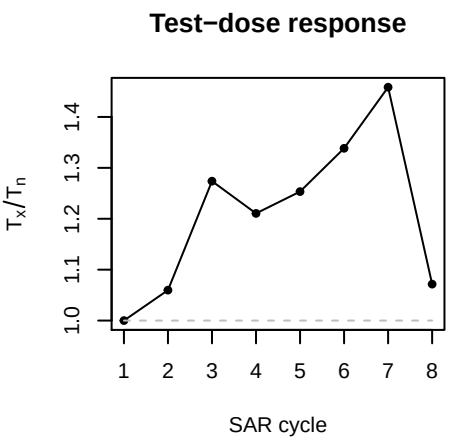
Test−dose response
Tx/Tn
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1
2
3
4
5
6
7
8
SAR cycle