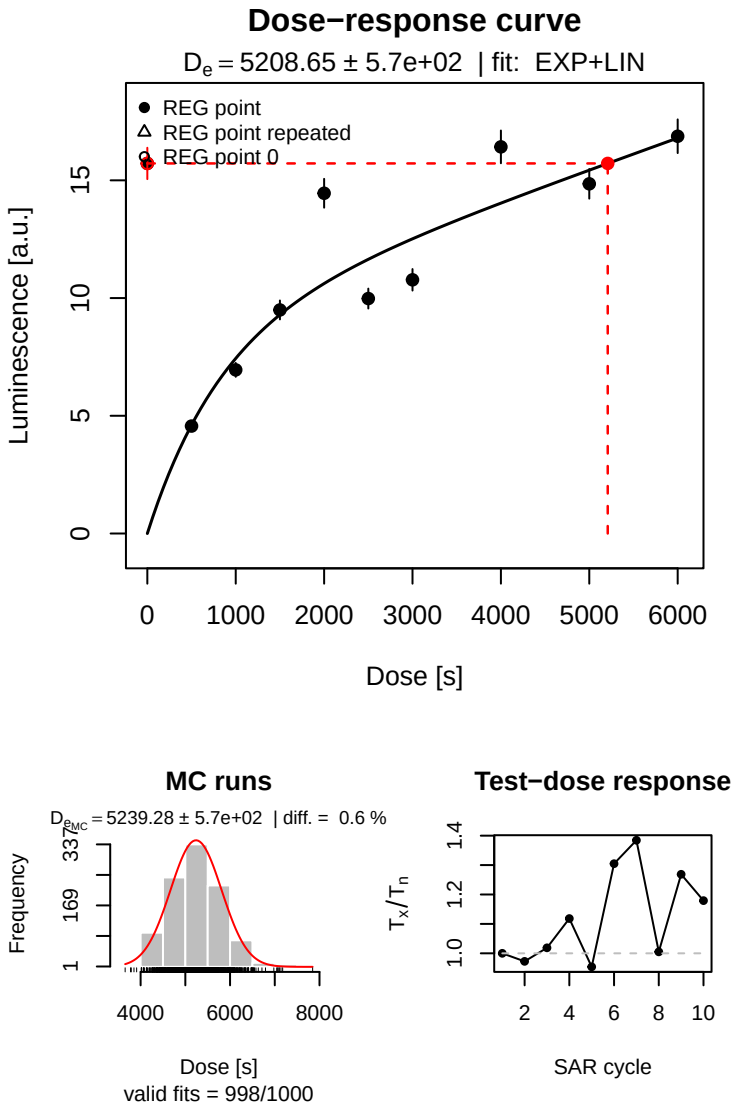
Dose−response curve
De = 5208.65 ± 5.7e+02 | fit: EXP+LIN
REG point
REG point repeated
REG point 0
Luminescence [a.u.]
0
5
10
15
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Dose [s]
MC runs
DeMC = 5239.28 ± 5.7e+02 | diff. = 0.6 %
Frequency
1
169
337
4000
6000
8000
Dose [s]
valid fits = 998/1000
Test−dose response
Tx/Tn
1.0
1.2
1.4
2
4
6
8
10
SAR cycle