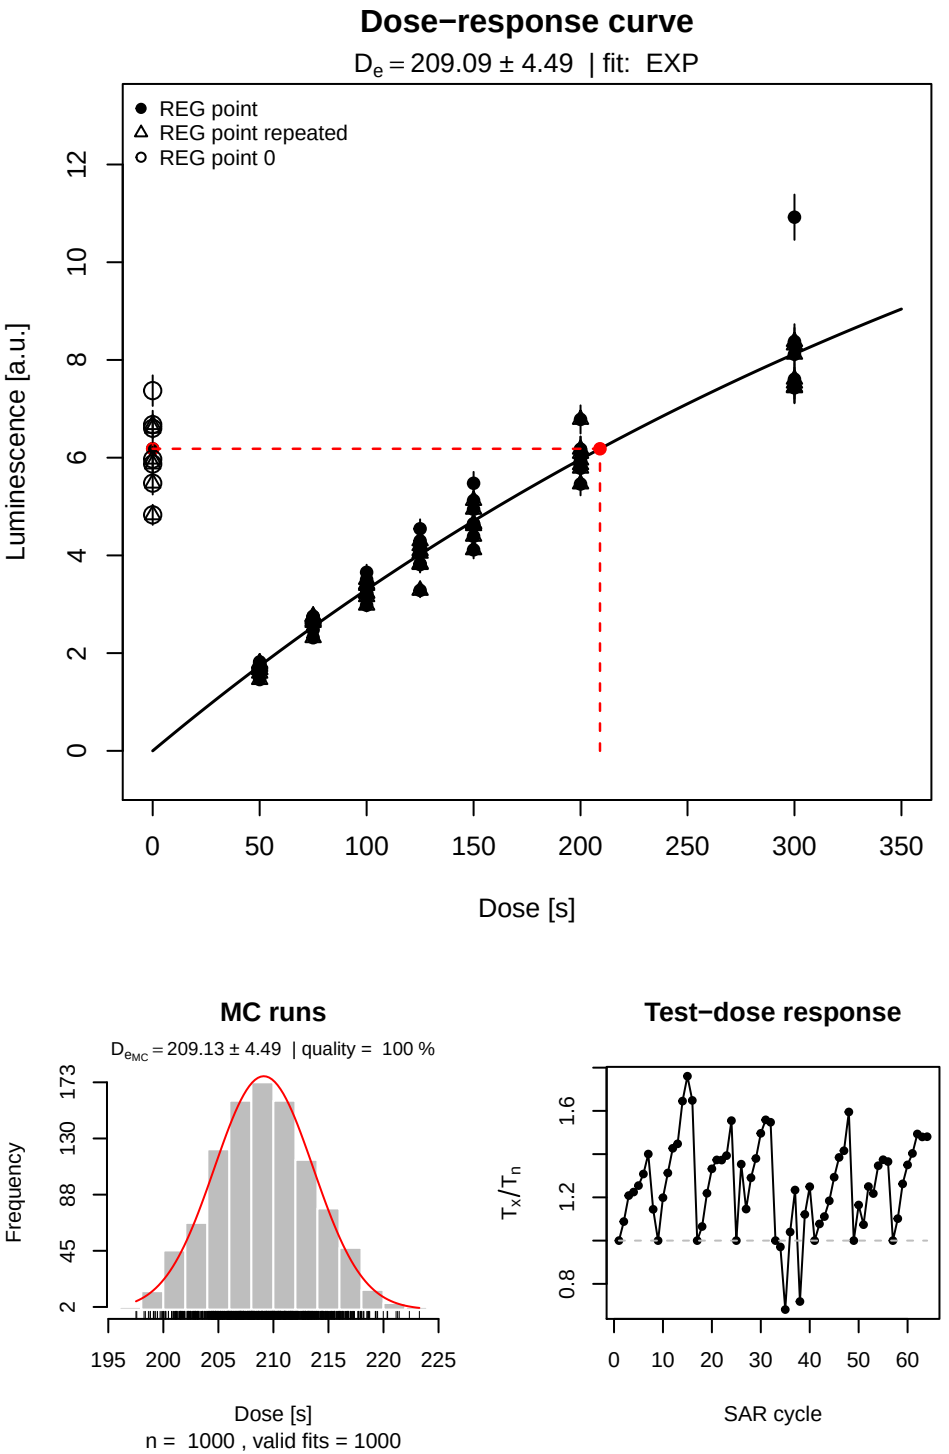
Dose−response curve
De = 209.09 ± 4.49 | fit: EXP
REG point
REG point repeated
REG point 0
Luminescence [a.u.]
0
2
4
6
8
10
12
0
50
100
150
200
250
300
350
Dose [s]
MC runs
DeMC = 209.13 ± 4.49 | quality = 100 %
Frequency
2
45
88
130
173
195
200
205
210
215
220
225
Dose [s]
n = 1000 , valid fits = 1000
Test−dose response
Tx/Tn
0.8
1.2
1.6
0
10
20
30
40
50
60
SAR cycle