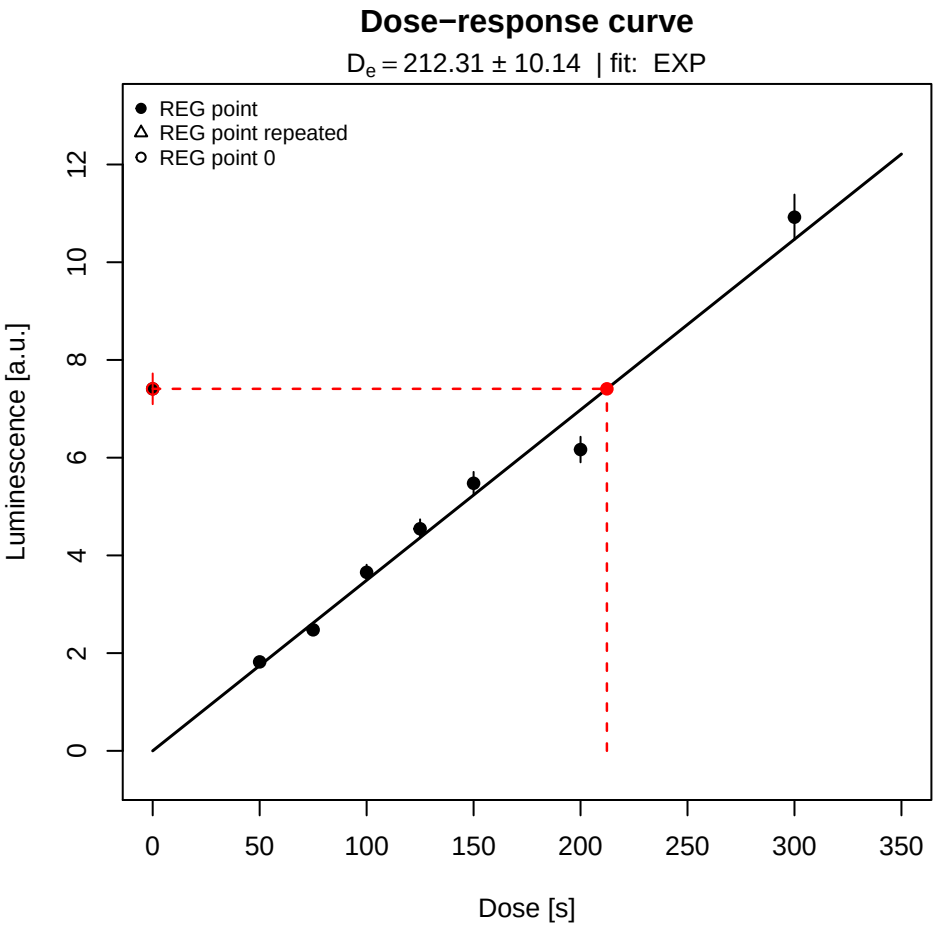
Dose−response curve
De = 212.31 ± 10.14 | fit: EXP
REG point
REG point repeated
REG point 0
Luminescence [a.u.]
0
2
4
6
8
10
12
0
50
100
150
200
250
300
350
Dose [s]

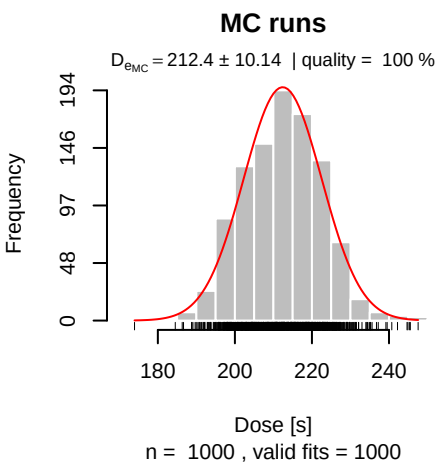
MC runs
DeMC = 212.4 ± 10.14 | quality = 100 %
Frequency
0
48
97
146
194
180
200
220
240
Dose [s]
n = 1000 , valid fits = 1000

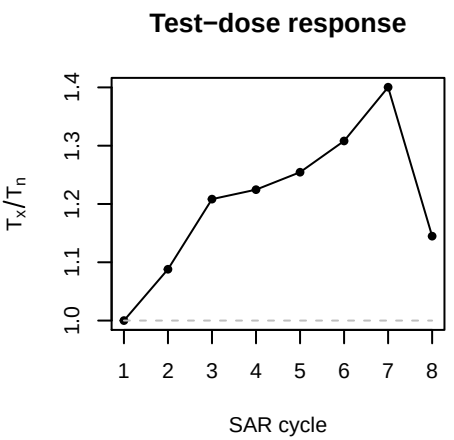
Test−dose response
Tx/Tn
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1
2
3
4
5
6
7
8
SAR cycle