



Labor für ICT und DSV (T205)

Anti-Aliasing-Filter NI USB-6009

Übersicht der Hardware

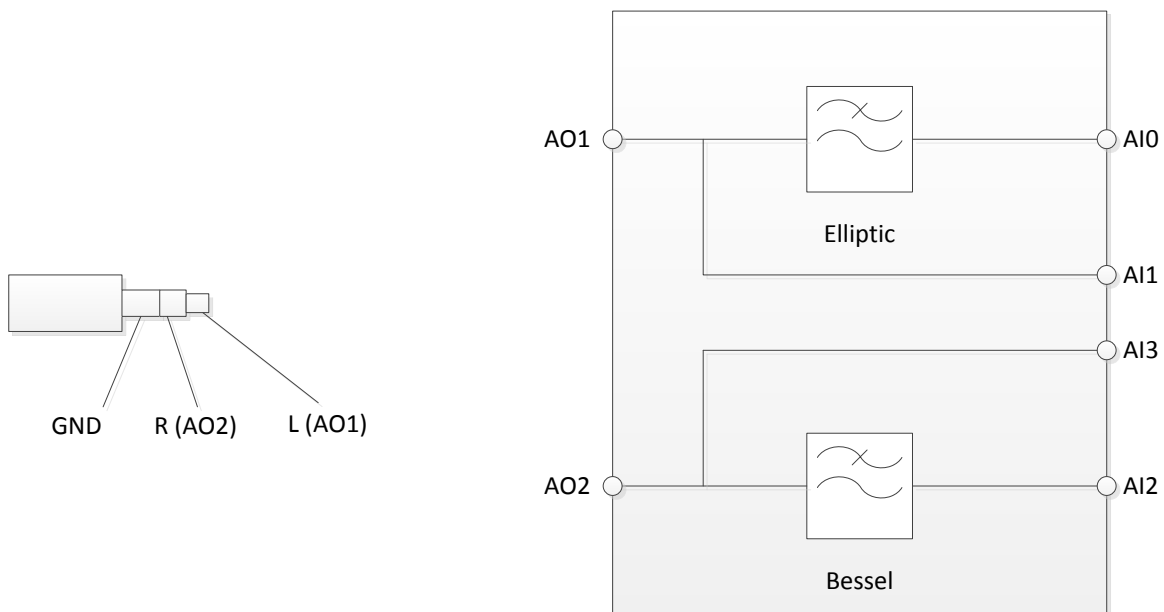


Schalterstellung für die Wahl der Grenzfrequenzen

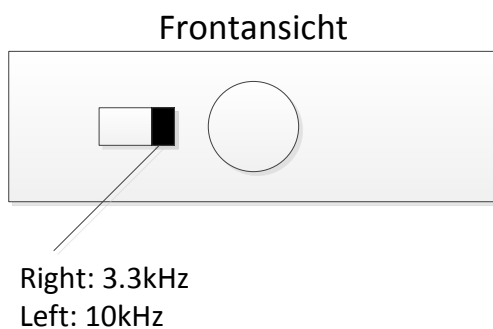



Frequenzgang der Filter

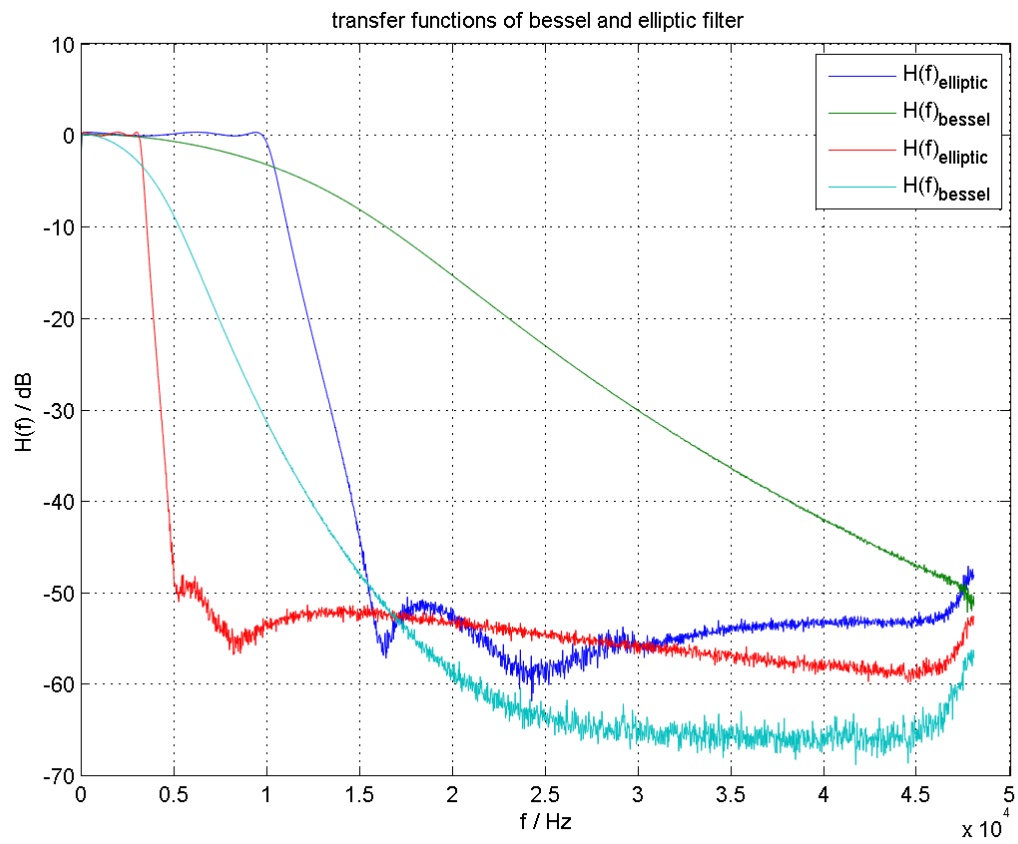

Schema

