

RATASVARTIO / LOHKO NOLLA – ALAPUOLEN HUOLTO

TYÖMÄÄRÄYKSET: ROTAATIO 41 Asentaja: YÖMYRÄ Lupa: C (alapinta + Juurakko) Esimies: Ruuvvari


#	KOHDE	TILA	HUOM
01	Suodatin, ilmanvaihto J-12	TEHTY	
02	Suodatin, ilmanvaihto J-13	TEHTY	taas tukossa
03	Valaistus, Juurakon käytävä 4	KESKEN	polttimoita ei oo
04	Venttiili 02A (lauhde)	TEHTY	
05	Venttiili 03C (lauhde)	TEHTY	
06	Venttiili 05B	EI TEHTY	ei osia
07	Kahvinkeitin, taukotila R-6	EI MUN	ilmoitettu 3 kertaa
08	Venttiili 08B (syöttö P-4)	TEHTY	!!!
09	Pumppu 2, laakeri	TEHTY	
10	Pumppu 4, painemittari	EI TEHTY	KIELLETTY (ks. alla)
11	Ritilä, biomurskain BM-3	TEHTY	terä vaihdettu
12	Huoltoluukku J-21 (itä)	SULJETTU	RV hitsas umpeen
13	Viemäri, taukotila	TEHTY	älkää kysykö
14	Valaistus, nostolava RP-2 (reuna)	TEHTY	lava TOIMII
15	Venttiili 11A	TEHTY	

Varastosta kadonnut: 2 jakoavainta, 1 hitsausmaski, 4 kahvikuppia.
Joku tietää kuka. – Ruuvvari

#10 — mulle sanottiin ettei P-4:n mittaria saa koskea. MIKS EI?? normaalisti kaikki mittarit pitää kalibroida. sanoivat että "telakka hoitaa". mikä telakka. ei siellä oo laivaa



#8 — 08B on se mistä pääsee syöttöputkeen. ks. kartta

kahvikupit en ottanut

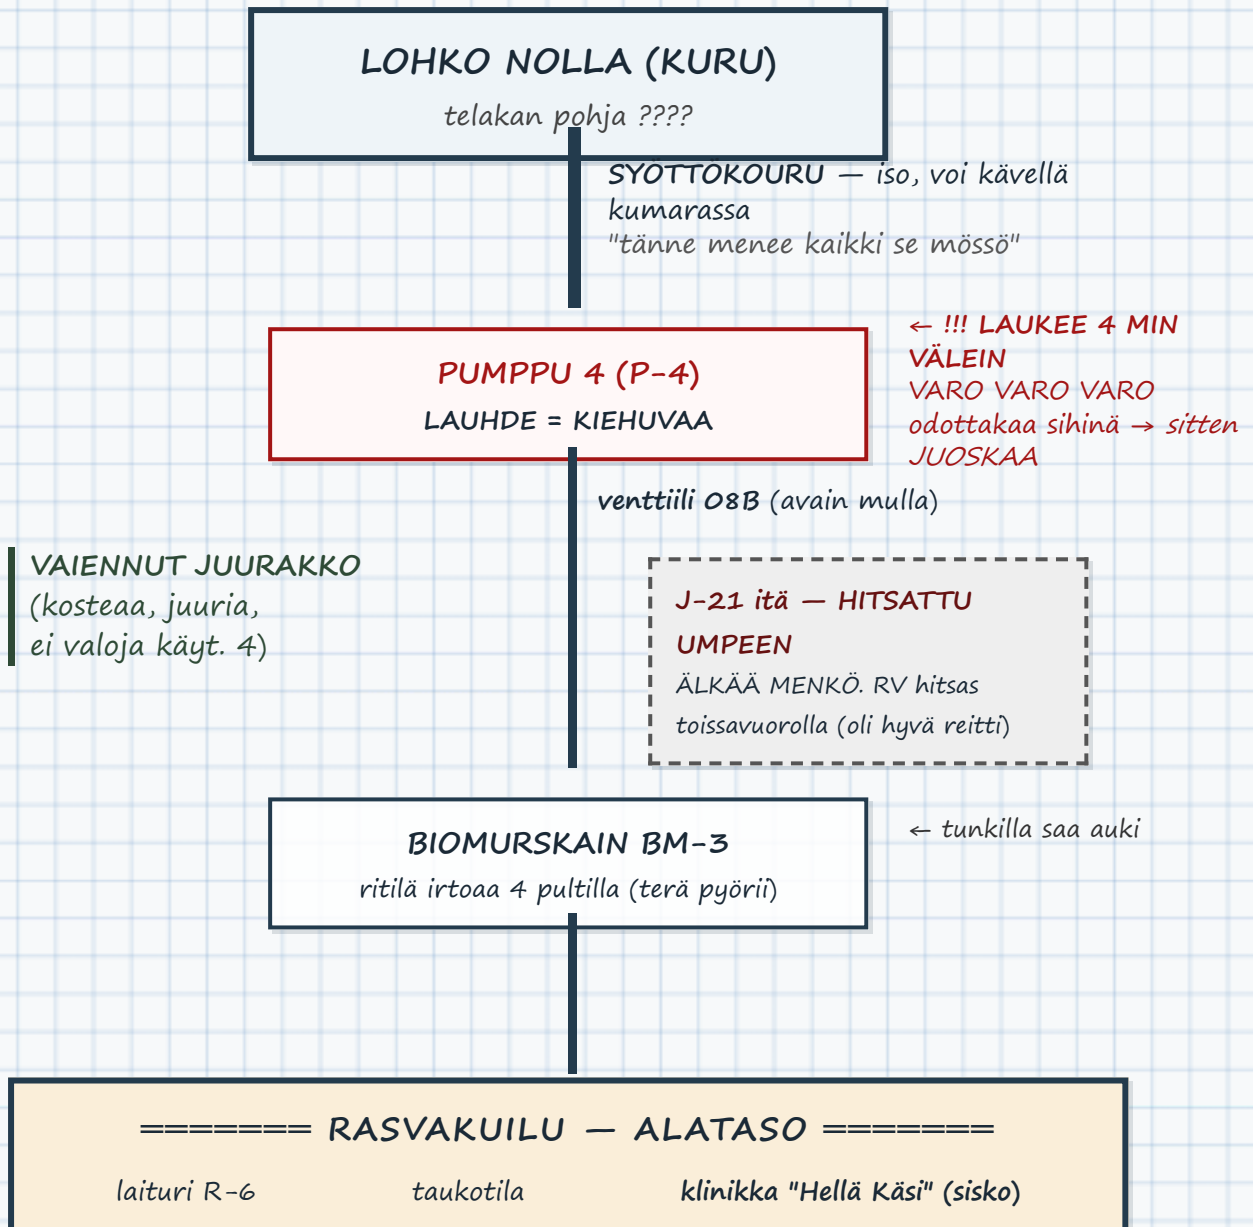

REUNALLE → nostolava RP-2 TOIMII (korjasin valot)
putouksen takana tikkaat glös, painovoima kääntyy puolivälissä.
ÄLKÄÄ KATSOKO ALAS. siis oikeesti.

LOHKO NOLLA / ALAPINNAN TYÖMAATUNNISTEET (4 KPL)

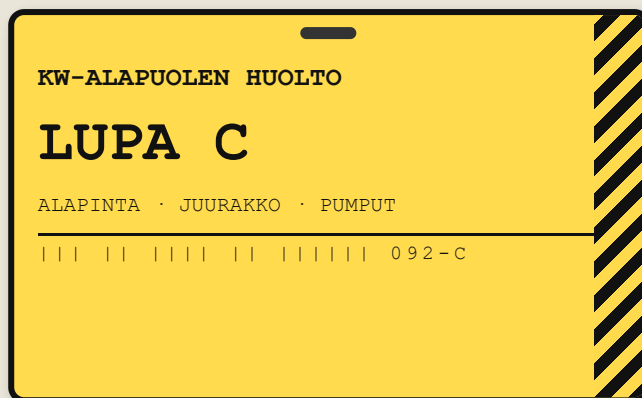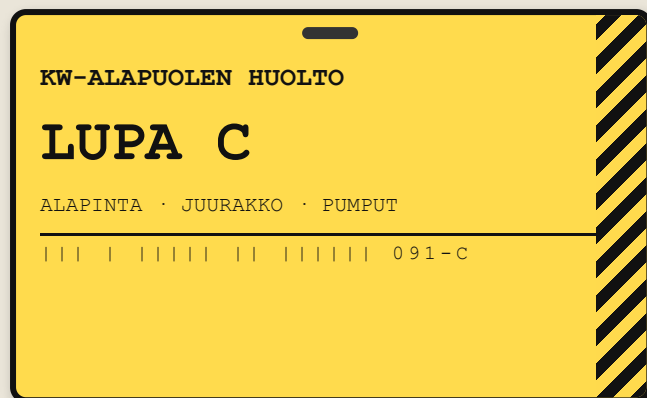

KUPARISAVU · AITO TERVA · 20 KPL

4 kpl C-lupia.

ei nimiä eikä kuvia. laittakaa rintaan ja ottakaa joku jakoavain tai putki käteen niin kukaan ei kysele mitään.

Ruuvари tekee kierroksen pari kertaa vuorossa, se ei nää mitään jos sille ei ala selittämään.

Viite: **VH-11-30027** / Hellä Käsi -sopimuslinikka
Velallinen: **PISARA** (huollettava)
Takaaja: **YÖMYRÄ** (lähiomainen)

Arvoisa takaaja,

Kiitämme Teitä luottamuksesta Med-Apexin hermostolliseen kumppanuusohjelmaan. Huollettavallenne asennettiin 14. jaksopäivänä neuroproteesi mallia NX-3 "Rauhallinen Mieli" (sarjanumero NX3-00418) sopimuksen VH-11-30027 mukaisesti.

Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että sopimuksen mukainen jaksoerä (1 200 kr) on jäänyt suorittamatta kolmena (3) peräkkäisenä kautena. Avoin saatava korkoineen on **45 260 kr**.

Sopimuksen kohdan 14.2 (Vakuudet) mukaisesti Med-Apex on oikeutettu realisoimaan vakuuden, joka tässä tapauksessa on:

VAKUUS A: huollettavan vasen keuhko (elinsiirtokelpoinen)
VAKUUS B: proteesin palautus, mikäli vakuus A ei riitä

Huomautamme ystävällisesti, että proteesin NX-3 käytönaikainen "epämukavuus" on tunnettu ominaisuus, joka lievenee, kun maksuliikenne normalisoituu (ks. kohta 9.1, Palvelutason säätö).

Proteesi on varustettu valmistajan huoltoliitännällä C7 (takaraivo), jonka kautta laite voidaan sammuttaa ainoastaan Med-Apexin valtuutetun tekniikon toimesta. Laitteen luvaton irrottaminen muualta kuin liitännästä C7 voi aiheuttaa pysyvän vaurion.

Noutaja saapuu klinikalle Hellä Käsi jaksopäivänä 3. Mikäli saatava suoritetaan ennen noutajan saapumista, toimenpide peruuntuu.

Arvostamme kumppanuuttanne.

Ystävällisin terveisin,

KORKO

Vakuushallinnan virkailija, Med-Apex