
RATASVARTIO · TEKNINEN PÄÄPIIRUSTUS

LOHKO NOLLA (SEKTORI 00) · KUIVATELAKKA-ALLAS 0 · LEIKKAUS A-A' (PROJEKTI S-0)

SOTILASSALAISUUS LUOKKA A-1

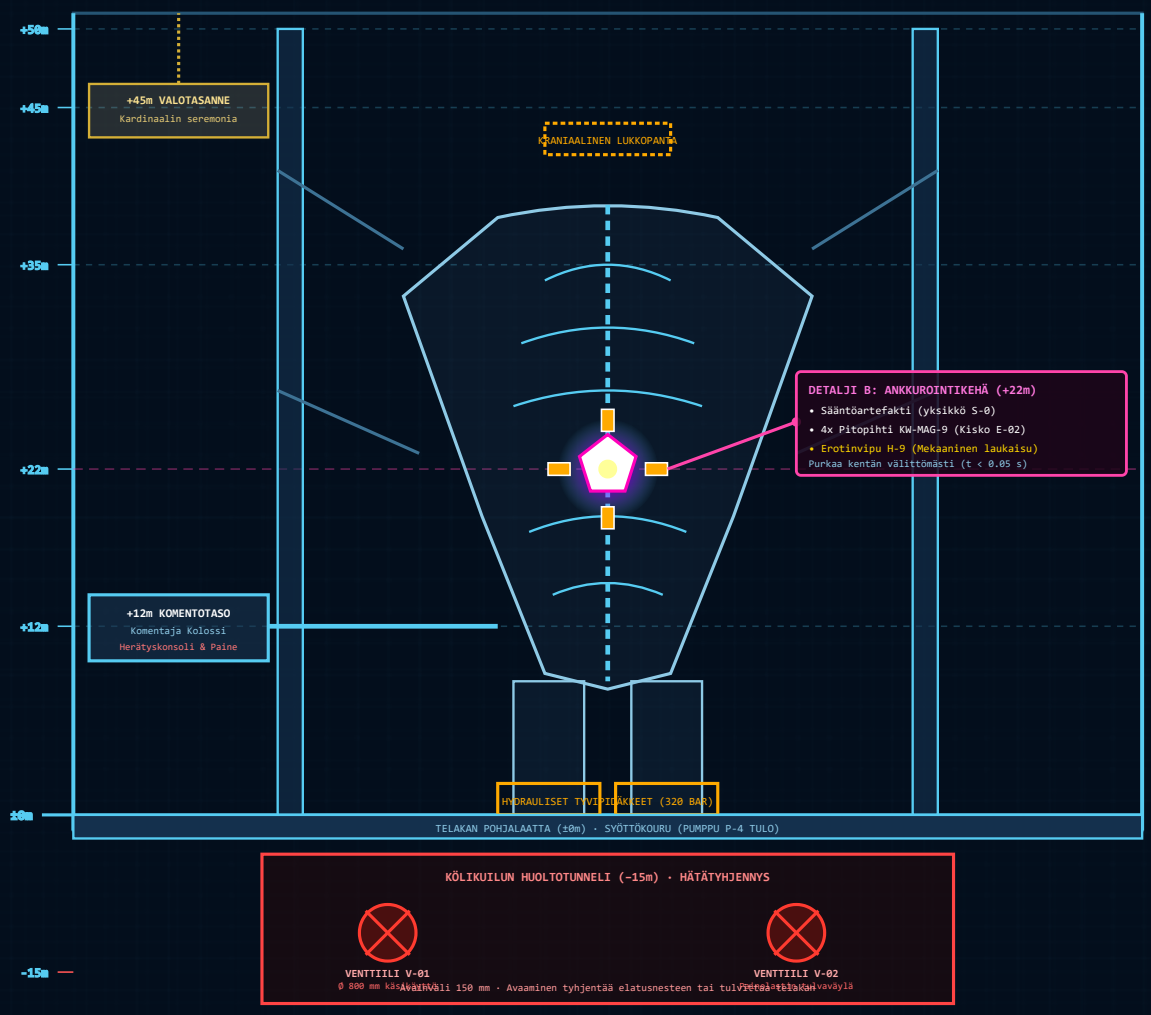

1. KORKEUSTASOT
+45m: Valotasanne (Kardinaali)
+22m: Rintalasta (S-0 Core)
+12m: Komentotaso (Kolossi)
±0m: Pohjalaatta & P-4 kouru

2. S-0 CORE (+22m)
Evoluution sääntöartefakti. Magneettipihdit KW-MAG-9.
Hätävapautus: Kampi H-9 tai virran katkaisu (E-02).

3. POHJAVENTTIILIT
Kölikuilu -15m: V-01 / V-02.
Mekaaniset luukut (18 000 l/s).
Tyhjennys suoraan tyhjiöön.

PIIRUSTUS: DWG-00-8812-C / REV 4.4

KOHDE: TELAKKA-ALLAS 0 (LOHKO 00)

PÄÄSUUNNITTELIJA: RAUTAHAMMAS

JAKELU: RATASVARTIO ESITYS

PROJEKTI S-0: JÄRJESTELMÄSPESIFIKAATIO JA COREN PURKUOHJE

RATASVARTIO KONESUUNNITTELUOSASTO · TEKNINEN LIITE ASIAKIRJAAN DWG-00-8812-C

1. KUIVATELAKKA-ALTAAN 0 PÄÄJÄRJESTELMÄT

KOMPONENTTI	TASO	PARAMETRIT	TOIMINTA & HUOMIO
S-0 Core -kehä	+22 m	Magneetti 4,2 T (E-02)	**Ontologinen sydän.** 4 keraamista pihtiä puristaa artefaktia.
Kallopanta	+42 m	Hydrauliikka 320 bar	Lukitsee titaanin aivorungon kattoon estäen pään liikkeen.
Komentotasanne	+12 m	Panssariteräs 80 mm	Kolossin ohjauspöytä. Herätyskytkin ja telemetriaseuranta.
Syöttökouru P-4	±0 m	32 bar / sykli 4 min	Syöttää biomassan ja ravinnenesteen vatsaonteloon.
Venttiilit V-01/02	−15 m	Ø 800 mm / mekaaninen	Kölikuilun pohjaluukut. Avaaminen tyhjentää altaan nesteet.

KYTKENTÄSPESIFIKAATIO: YKSIKKÖ S-0 ANKKUROINTI (+22 m)

Ensisijainen teholähde: Moniulotteinen **sääntöartefakti**. Biomekaaninen 50-metrinen runko toimii ontologisen resonanssikentän fyysisenä kanavana ja vahvistimena.

- **Pitomekanismi KW-MAG-9:** Artefaktia ankkuroi neljä keraamista magneettisankaa, joiden pito ottaa ohjausjännitteen varavoimakiskolta E-02.
- **Mekaaninen erotusvipu H-9:** Rintatason huoltopaneelissa sijaitseva jousitettu erotinvipu H-9 oikosulkee kiskon E-02 ja laukaisee magneettisangat välittömästi (t < 0,05 s).
- **Mekaaninen leikkaus:** Keraamiset tukirakenteet kestävät 150 kN kuorman ennen mekaanista murtumista.
- **VAIKUTUS JÄRJESTELMÄÄN:** *Magneettisen pitopiirin katketessa ja resonanssin purkautuessa orgaanisen matriisin hermopaine putoaa nollaan (t = 0 s), jolloin runkorakenteen solujännite purkautuu välittömästi.*

2. HERÄTYSDYNAMIIKKA JA TELEMETRIAPARAMETRIT

TELEMETRIAMUISTIO: PROTOKOLLA S-0 SYNKKIÖVASTAINE (KYTKENTÄKOE #3)

Ekklesian tilaama *"Yleinen sakramentaalinen ekstaasi"* (KW-tunnus: *Taktinen komentokoheesio*) saavutetaan resonanssikynnyksellä:

1. **Kytketyt komentoverkot:** Kaikki KW-tunnisteella tai Ekklesian liturgiaverkolla varustetut vastaanottimet (kaartilaiset, kirkkokuoro, komentopäätteet) siirtyvät automaattiseen orjasynkroniin. Yksiköt toistavat annettua suoritussilmukkaa mekaanisessa hurmostilassa ilman itsenäistä harkintaa.
2. **Suojaamattomat orgaaniset yksiköt:** Verkon ulkopuoliset hermojärjestelmät säilyttävät itsenäisen motorisen ohjauksensa kentän diffuusioviiveen ajan (arvio 60–180 s), kunnes kenttä saavuttaa kylläisyyden. Kolossin määräys: suojaamattomat henkilöt poistettava altaasta ennen kytkentää.

MUISTIO / KONESUUNNITTELUOSASTO (LOHKO 00):

"Olen esikunnalle toistuvasti ilmoittanut, että kiskon E-02 virransyöttö on mitoitettu staattiselle kuormalle. Mekaaninen erotinvipu H-9 on asennettu ainoastaan laboratorion hätäerotusta varten. Mikäli virta katkeaa tai tärinä laukaisee vivun, pitokenttä purkautuu välittömästi. Ilman artefaktin resonanssia koko 50-metrinen orgaaninen runko menettää koheesionsa ja lyyhistyy kuolleena massana telakan pohjalaatalle. Lisäksi magneettikentän äkillinen purkautuminen heittää paikallisen painovoiman epävakaaksi. Esikunnan on huolehdittava, ettei seremoniatasanteen tärinä pääse heilauttamaan kiskon E-02 kytkentöjä."

— Pääkonstruktööri Rautahammas