01 检查结果

sub-01_ses-01_task-offline_run-01_eeg.edf

基础检查方案

EDF · 头皮 EEG · 62 通道 · 512 Hz

本次检查 0–733 秒；原记录 733 秒。

总分 / 100

74.43

本次为项目试行评分，未设合格线。各项权重见下表。

主要发现：工频干扰，76.63% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 62 个通道。

已计算 733/733 秒；来源间隙 0 秒。

计分项目


检查项目	分项 / 100	权重	检查发现
信号完整性	99.92	33.3%	0.08% 的采样点被标记为无效或持续恒值
工频干扰	23.37	33.3%	76.63% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 62 个通道
高频突发	99.99	33.3%	<0.01% 的累计通道时长被标记，共 3 段候选

分数越低，表示该方法标记的候选负担越大。候选仍需结合原始信号复核。

02 问题定位与图表

类型 / 通道	原始时间	复核依据
高频突发 / O2	4.5–5.75 s	峰值 z = 5.50
高频突发 / F7	242.75–244.25 s	峰值 z = 10.06
工频 / F2	43–47 s	557/712 个检查窗命中；代表频率 150 Hz
工频 / FC2	41–45 s	556/712 个检查窗命中；代表频率 150 Hz

展示前2条高频候选及命中最多的2个工频通道；完整候选保留在在线报告。

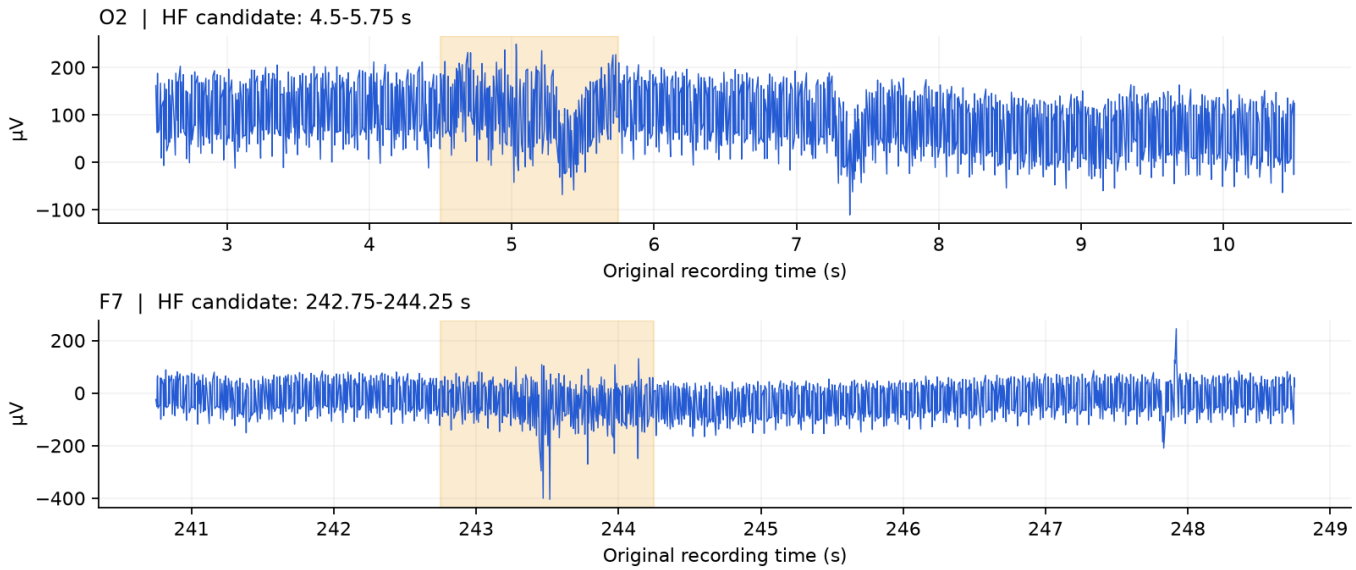

阴影为候选区间；显示原始信号，未清洗、未重参考。

复核记录

结论: _____ 复核人 / 日期: _____

意见: _____

03 总分组成与测量依据

3 项同等计入，总分为这些分项的平均分。

计分项目	占总分	分项 / 100
信号完整性	33.3%	99.92
工频干扰	33.3%	23.37
高频突发	33.3%	99.99

分项 = 100 ×（1 − 候选占比）；总分 = 各分项 × 对应占比，再相加。比例按显示精度四舍五入。

实际测量

检查项目	实际测量
信号完整性	无效数值 0 个；持续恒值 17,856 个采样点
工频干扰	33,827 / 44,144 个通道检查窗被标记
高频突发	各通道候选时长合计 4.25 秒 / 有效检查时长合计 44,977.12 秒

通道检查窗是一个通道的一个时间窗；累计通道时长是各通道秒数之和。工频命中窗占比不能直接当成整份记录受干扰的时长占比。

计分项目缺失或范围未完成，不补满分、不重新分配比例。比较结果时应使用相同方法、处理状态和计分配置。

本次为展示修订；运行时 eeg-basic-screen/0.2 为 23.37 分，原文件保留。

来源与追溯

任务 3c389db9af894de7b7386c1d188ab374；规则 project-weighted/1.0；配置 ac602c19e5e9ab46。

方法来源：BrainElecQC / DBCI-QC

本地报告：/api/v1/jobs/3c389db9af894de7b7386c1d188ab374/report

图表：/api/v1/jobs/3c389db9af894de7b7386c1d188ab374/visualizations