01 检查结果

sub-02_ses-01_task-offline_run-01_eeg.edf

基础检查方案

EDF · 头皮 EEG · 62 通道 · 512 Hz

本次检查 0–753 秒；原记录 753 秒。

总分 / 100

74.12

本次为项目试行评分，未设合格线。各项权重见下表。

主要发现：工频干扰，75.89% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 62 个通道。

已计算 753/753 秒；来源间隙 0 秒。

计分项目


检查项目	分项 / 100	权重	检查发现
信号完整性	99.94	33.3%	0.06% 的采样点被标记为无效或持续恒值
工频干扰	24.11	33.3%	75.89% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 62 个通道
高频突发	98.32	33.3%	1.68% 的累计通道时长被标记，共 551 段候选

分数越低，表示该方法标记的候选负担越大。候选仍需结合原始信号复核。

02 问题定位与图表

类型 / 通道	原始时间	复核依据
高频突发 / FP1	15–16.5 s	峰值 z = 15.98
高频突发 / FPz	15–16.5 s	峰值 z = 15.97
工频 / AF4	464–468 s	560/732 个检查窗命中；代表频率 150 Hz
工频 / C5	464–468 s	560/732 个检查窗命中；代表频率 150 Hz

展示前2条高频候选及命中最多的2个工频通道；完整候选保留在在线报告。

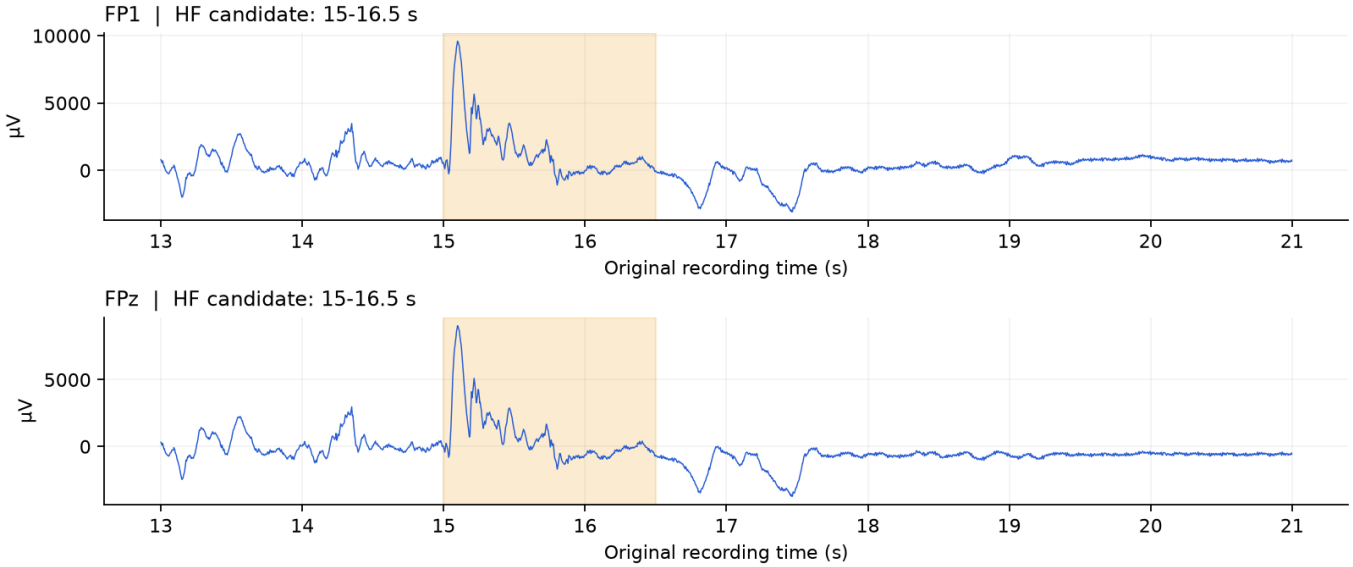

阴影为候选区间；显示原始信号，未清洗、未重参考。

复核记录

结论： _____ **复核人 / 日期：** _____

意见： _____

03 总分组成与测量依据

3 项同等计入，总分为这些分项的平均分。

计分项目	占总分	分项 / 100
信号完整性	33.3%	99.94
工频干扰	33.3%	24.11
高频突发	33.3%	98.32

分项 = 100 ×（1 − 候选占比）；总分 = 各分项 × 对应占比，再相加。比例按显示精度四舍五入。

实际测量

检查项目	实际测量
信号完整性	无效数值 0 个；持续恒值 13,948 个采样点
工频干扰	34,441 / 45,384 个通道检查窗被标记
高频突发	各通道候选时长合计 778.75 秒 / 有效检查时长合计 46,223.76 秒

通道检查窗是一个通道的一个时间窗；累计通道时长是各通道秒数之和。工频命中窗占比不能直接当成整份记录受干扰的时长占比。

计分项目缺失或范围未完成，不补满分、不重新分配比例。比较结果时应使用相同方法、处理状态和计分配置。

本次为展示修订；运行时 eeg-basic-screen/0.2 为 24.11 分，原文件保留。

来源与追溯

任务 789d4534433441879120cb78cfef9b0e；规则 project-weighted/1.0；配置 ac602c19e5e9ab46。

方法来源：BrainElecQC / DBCI-QC

本地报告：/api/v1/jobs/789d4534433441879120cb78cfef9b0e/report

图表：/api/v1/jobs/789d4534433441879120cb78cfef9b0e/visualizations