# 数据质量检查报告

sub-02_ses-01_task-offline_run-01_eeg.edf

基础检查方案 / 整份记录

| 模态 / 格式 | 分析通道 | 采样率 |
| --- | --- | --- |
| 头皮 EEG / EDF | 62 道 | 512 Hz |
| **检查范围** | **原始记录** | **已计算时长** |
| 0-753 秒 | 753 秒 | 753 / 753 秒 |

综合分 / 100

**74.12**

### 主要发现 · 工频干扰

75.89% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 62 个通道

分数描述本方案候选负担，不设通用合格线。

## 检查结果

| 检查项目 | 得分 / 100 | 权重 | 检查发现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号完整性 | 99.94 | 33.3% | 0.06% 的采样点被标记为无效或持续恒值 |
| 工频干扰 | 24.11 | 33.3% | 75.89% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 62 个通道 |
| 高频突发 | 98.32 | 33.3% | 1.68% 的累计通道时长被标记，共 551 段候选 |


综合分 = 各项得分 × 对应权重，再相加。权重按显示精度四舍五入。各项完成后才汇总。

# 问题定位与证据

候选位置与输入信号

| 通道 / 类型 | 原始时间 | 定位依据 |
| --- | --- | --- |
| FP1 / 高频突发 | 15-16.5 秒 | 峰值 z = 15.98 |
| FPz / 高频突发 | 15-16.5 秒 | 峰值 z = 15.97 |
| AF4 / 工频 | 464-468 秒 | 560/732 窗命中；代表频率 150 Hz |
| C5 / 工频 | 464-468 秒 | 560/732 窗命中；代表频率 150 Hz |

展示前 2 条高频候选及命中最多的 2 个工频通道；工频时间为代表窗口。

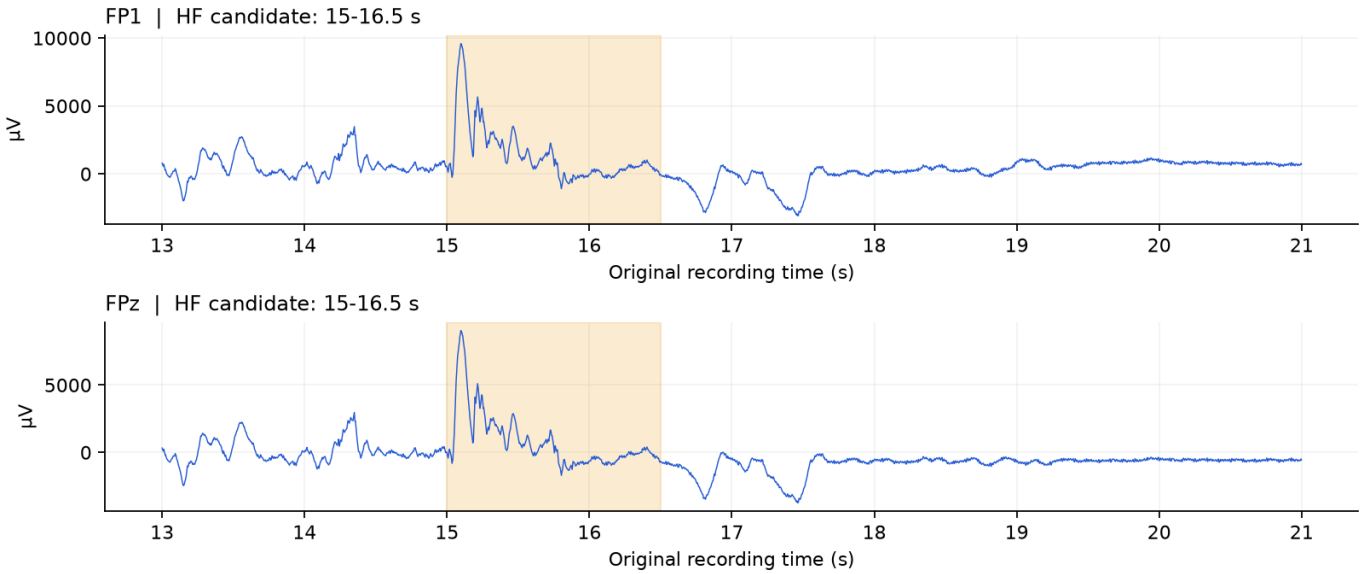


阴影标出待复核区间，横轴为原始记录时间。图中示例不代表全部候选。

## 测量依据

| 检查项目 | 实际测量 |
| --- | --- |
| 信号完整性 | 无效数值 0 个；持续恒值 13,948 个采样点 |
| 工频干扰 | 34,441 / 45,384 个通道检查窗被标记 |
| 高频突发 | 各通道候选时长合计 778.75 秒 / 有效检查时长合计 46,223.76 秒 |

通道窗指一个通道的一个检查窗；累计通道秒为各通道时长之和。工频窗命中比例不等于整份记录的污染时长比例。

分项 = 100 × (1 - 候选占比)。权重见检查结果表；缺失项目不补满分，也不重新分配权重。

自动标记为待复核线索。比较不同记录时，需使用相同检查项目、输入处理状态及评分配置。

本报告使用保存的展示修订；原评分 eeg-basic-screen/0.2 为 24.11 分，原始报告保留。

评分规则：project-weighted/1.0 · 导出版本：eeg-pdf/1.5 · 报告编号：789d45344334418791 20cb78cfef9b0e