数据质量检查报告

ds002034 · sub-01 注意任务

灵犀云扩展方案 / 整份记录

模态 / 格式	分析通道	采样率
头皮 EEG / EDF	62 道	512 Hz
检查范围	**原始记录**	**已计算时长**
0-733 秒	733 秒	733 / 733 秒

综合分 / 100

98.37

主要发现 · 灵犀云 · 低频异常

4.36% 的累计通道时长被标记

分数描述本方案候选负担，不设通用合格线。

检查结果

检查项目	得分 / 100	权重	检查发现
灵犀云 · 线长通道候选	100.00	20.0%	本项未检出候选
灵犀云 · 伪差区间	99.28	20.0%	0.72% 的累计通道时长被标记
灵犀云 · 低频异常	95.64	20.0%	4.36% 的累计通道时长被标记
灵犀云 · 高频异常	98.40	20.0%	1.60% 的累计通道时长被标记
灵犀云 · PSD 异常通道	98.52	20.0%	分段通道候选占比 1.48%（按分析时长汇总）

另有 6 项补充检查，详见附页；不计入本方案综合分。

综合分 = 各项得分 × 对应权重，再相加。权重按显示精度四舍五入。受限项权重为 0，其余有效项重新归一化。


灵犀云分项来自分析副本；本报告的评分汇总由 DBCI-QC 提供。共同基础检查独立列示。

问题定位与证据

共同基础检查 · 候选位置与输入信号

通道 / 类型	原始时间	定位依据
O2 / 高频突发	4.5-5.75 秒	峰值 z = 5.50
F7 / 高频突发	242.75-244.25 秒	峰值 z = 10.06
F2 / 工频	43-47 秒	554/711 窗命中；代表频率 150 Hz
FC2 / 工频	41-45 秒	554/711 窗命中；代表频率 150 Hz

展示前 2 条高频候选及命中最多的 2 个工频通道；工频时间为代表窗口。

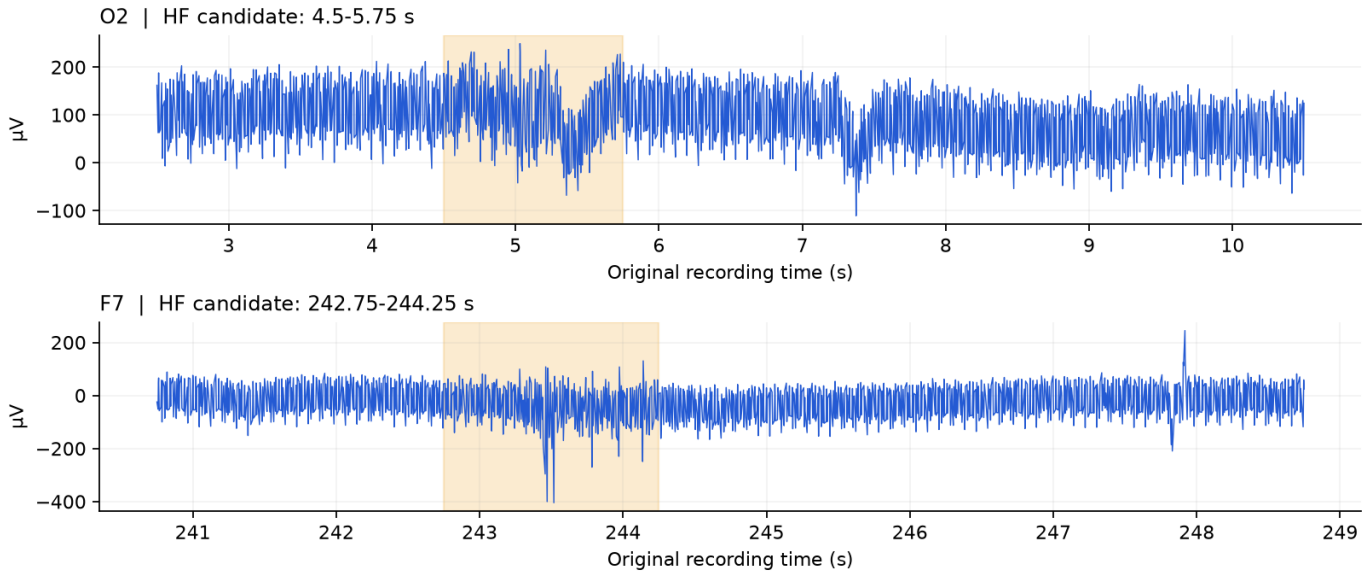

阴影标出待复核区间，横轴为原始记录时间。图中示例不代表全部候选。

本页仅展示共同基础检查定位；灵犀云伪差时间轴、PSD 差异与频带图保留在在线报告的图表分析中。

测量依据

检查项目	实际测量
灵犀云 · 线长通道候选	0 / 45,446 通道与分析块的累计秒数 为候选
灵犀云 · 伪差区间	326.61 / 45,446 秒（各通道累加） 为候选
灵犀云 · 低频异常	1,982 / 45,446 秒（各通道累加） 为候选
灵犀云 · 高频异常	726.5 / 45,446 秒（各通道累加） 为候选
灵犀云 · PSD 异常通道	601.27 / 40,663.52 通道与分析块的累计秒数 为候选

通道窗指一个通道的一个检查窗；累计通道秒为各通道时长之和。工频窗命中比例不等于整份记录的污染时长比例。

补充检查

共同基础检查 · 不计入本方案综合分

检查项目	得分 / 100	权重	检查发现
信号完整性	99.92	不计入	0.08% 的采样点被标记为无效或持续恒值
工频干扰	23.37	不计入	76.63% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 62 个通道
高频突发	99.94	不计入	0.06% 的累计通道时长被标记，共 13 段候选
PREP 非空间通道候选	99.59	不计入	分段通道候选占比 0.41%（按分析时长汇总）
MNE 幅度通道候选	100.00	不计入	本项未检出候选
MNE 幅度区间候选	99.92	不计入	0.08% 的已检查时长被标记

补充测量

检查项目	实际测量
信号完整性	无效数值 0 个；持续恒值 17,856 个采样点
工频干扰	33,779 / 44,082 个通道检查窗被标记
高频突发	各通道候选时长合计 27.25 秒 / 有效检查时长合计 44,977.12 秒
PREP 非空间通道候选	186.5 / 45,446 通道与分析块的累计秒数 为候选
MNE 幅度通道候选	0 / 45,446 通道与分析块的累计秒数 为候选
MNE 幅度区间候选	0.56 / 733 秒 为候选

分项 = 100 × (1 - 候选占比)。权重见检查结果表；受限项权重为 0，其余有效项重新归一化。

自动标记为待复核线索。比较不同记录时，需使用相同检查项目、输入处理状态及评分配置。

本报告使用保存的展示修订；原评分 project-weighted/1.1 为 98.37 分，原始报告保留。

评分规则：project-weighted/1.2 · 导出版本：eeg-pdf/1.5 · 报告编号：c0230a5a6ee64f079257ccd18e4656a6