DBCI-QC　质控报告

01　整份记录评分与结果

sub-02_ses-01_task-offline_run-01_eeg.edf

EDF / 头皮 EEG / 62 道 / 512 Hz

本次检查 0–753 秒；原记录 753 秒。

项目自定义评分

项目自定义 v1.0

74.12 / 100

检出待复核线索。工频候选涉及 62 个通道；高频突发有 551 条候选区间。

工频优先复核：AF4 命中 560/732 窗；C5 命中 560/732 窗。

局部关注：AF4 / 工频干扰 23.50 分。

检查项	得分 / 100	扣分	测量与扣分原因
信号完整性	99.94	0.06	候选占比 0.06%；权重 1；非有限值 0；恒值 13948 个样本
工频干扰	24.11	75.89	候选占比 75.89%；权重 1；34441 / 45384 个通道窗命中
高频突发	98.32	1.68	候选占比 1.68%；权重 1；778.75 / 46223.8 通道秒为候选

分项 = 100 × (1　候选量 / 有效检查量)；总分 = Σ(分项 × 权重) / Σ权重。

整份覆盖：已计算 753/753 秒；间隙 0 秒。先逐通道汇总，再评分。

按当前规则重算；运行时 eeg-basic-screen/0.2 为 24.11 分，原文件保留。

补充检查

补充检查：逐窗保留。通道一致性、辅助锁时、事件及扩展结果见逐窗报告


说明：项目试行评分，未设合格线。扩展计分项见附页，按所存权重纳入总分。

DBCI-QC　质控报告

02　问题定位与复核

类型 / 通道	原始时间	复核依据
高频突发 / FP1	15–16.5 s	峰值 z = 15.98
高频突发 / FPz	15–16.5 s	峰值 z = 15.97
工频 / AF4	464–468 s	560/732 窗命中；代表窗 150 Hz
工频 / C5	464–468 s	560/732 窗命中；代表窗 150 Hz

展示前 2 条高频候选及命中最多的 2 个工频通道；完整候选见在线报告与检测证据。

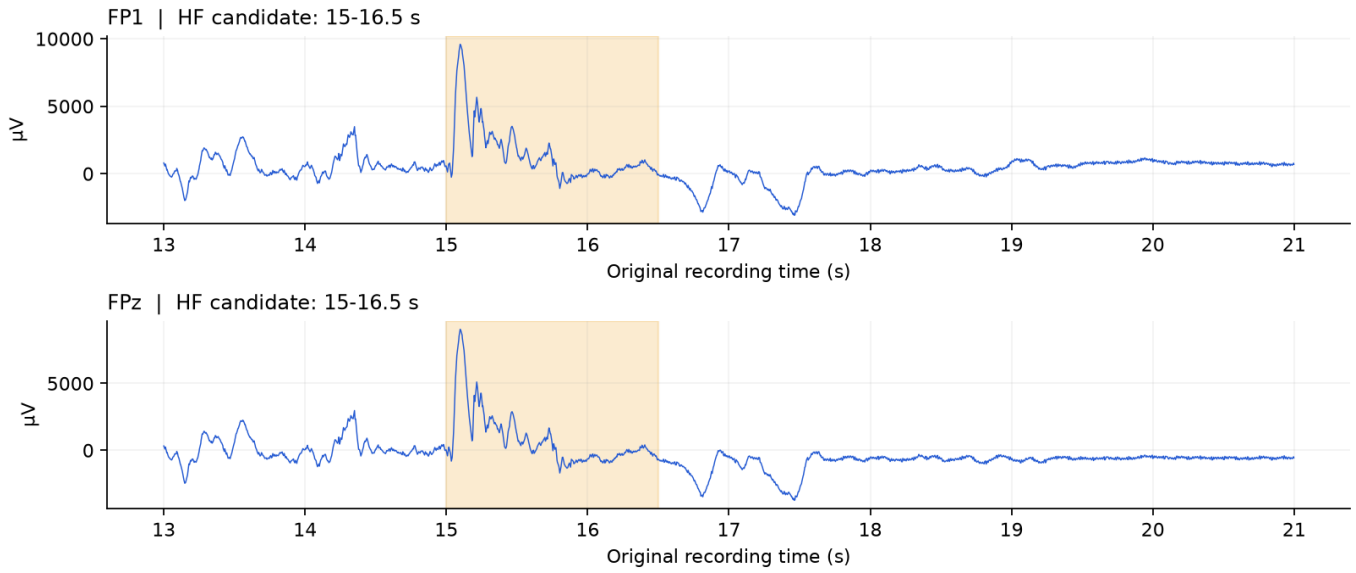

阴影为检测候选区间。波形为对应原始信号的显示抽稀，未清洗、未重参考。

人工复核

结论: _____　复核人 / 日期: _____

意见: _____

追溯信息

任务 789d4534433441879120cb78cfef9b0e；规则 project-weighted/1.0。

计划 db4ca573d730932428769c0b57b623ec74bd4020be018dee3387e49c9455f0d0；检测证据与参数保存在本次任务中。