DBCI-QC　质控报告

01　整份记录评分与结果

sub-01_ses-01_task-offline_run-01_eeg.edf

EDF / 头皮 EEG / 62 道 / 512 Hz

本次检查 0–733 秒；原记录 733 秒。

74.43 / 100

项目自定义评分

项目自定义 v1.0

检出待复核线索。工频候选涉及 62 个通道；高频突发有 3 条候选区间。

工频优先复核：F2 命中 557/712 窗；FC2 命中 556/712 窗。

局部关注：F2 / 工频干扰 21.77 分。

检查项	得分 / 100	扣分	测量与扣分原因
信号完整性	99.92	0.08	候选占比 0.08%；权重 1；非有限值 0；恒值 17856 个样本
工频干扰	23.37	76.63	候选占比 76.63%；权重 1；33827 / 44144 个通道窗命中
高频突发	99.99	0.01	候选占比 0.01%；权重 1；4.25 / 44977.1 通道秒为候选

分项 = 100 × (1　候选量 / 有效检查量)；总分 = Σ(分项 × 权重) / Σ权重。

整份覆盖：已计算 733/733 秒；间隙 0 秒。先逐通道汇总，再评分。

按当前规则重算；运行时 eeg-basic-screen/0.2 为 23.37 分，原文件保留。

补充检查

补充检查：逐窗保留。通道一致性、辅助锁时、事件及扩展结果见逐窗报告


说明：项目试行评分，未设合格线。扩展计分项见附页，按所存权重纳入总分。

DBCI-QC　质控报告

02　问题定位与复核

类型 / 通道	原始时间	复核依据
高频突发 / O2	4.5–5.75 s	峰值 z = 5.50
高频突发 / F7	242.75–244.25 s	峰值 z = 10.06
工频 / F2	43–47 s	557/712 窗命中；代表窗 150 Hz
工频 / FC2	41–45 s	556/712 窗命中；代表窗 150 Hz

展示前 2 条高频候选及命中最多的 2 个工频通道；完整候选见在线报告与检测证据。

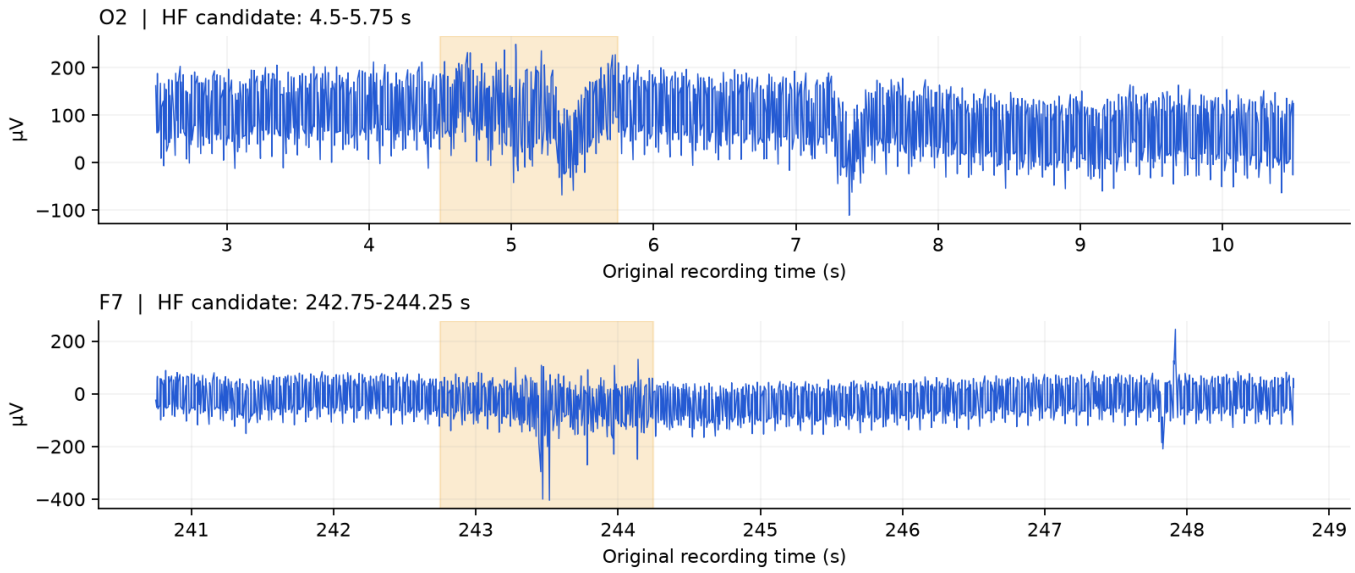

阴影为检测候选区间。波形为对应原始信号的显示抽稀，未清洗、未重参考。

人工复核

结论：_____　复核人 / 日期：_____

意见：_____

追溯信息

任务 3c389db9af894de7b7386c1d188ab374；规则 project-weighted/1.0。

计划 cb6f5327a654c4e20277cf9e5f106c12145985a477fa3c0fec585ef72b985d72；检测证据与参数保存在本次任务中。