01 检查结果

ds002034 · sub-01 注意任务

灵犀云扩展方案（保留共同基础检查）

EDF · 头皮 EEG · 62 通道 · 512 Hz

本次检查 0–733 秒；原记录 733 秒。

总分 / 100

未汇总

5 项同等计入，总分为这些分项的平均分。 本次为项目试行评分，未设合格线。

整份总分未汇总：缺少有效计分证据：灵犀云 · 高频异常、灵犀云 · PSD 异常通道。已完成的分项结果保留。

主要发现：灵犀云 · 低频异常，4.29% 的累计通道时长被标记。

已计算 733/733 秒；来源间隙 0 秒。

计分项目

检查项目	分项 / 100	检查发现
灵犀云 · 线长通道候选	100.00	本项未检出候选
灵犀云 · 伪差区间	99.66	0.34% 的累计通道时长被标记
灵犀云 · 低频异常	95.71	4.29% 的累计通道时长被标记
灵犀云 · 高频异常	未评	720 – 733 秒：高频统计未得到有效结果
灵犀云 · PSD 异常通道	未评	720 – 733 秒：没有连续超过 10 秒的干净片段

另有 6 项共同基础检查，结果见附录；不计入本方案总分。


分数越低，表示该方法标记的候选负担越大。候选仍需结合原始信号复核。

02 问题定位与图表

本页波形与位置来自共同基础检查。灵犀云线长、伪差时间轴、PSD差异与频带热图见在线“查看图表”。

类型 / 通道	原始时间	复核依据
高频突发 / O2	4.5–5.75 s	峰值 z = 5.50
高频突发 / F7	242.75–244.25 s	峰值 z = 10.06
工频 / F2	43–47 s	557/712 个检查窗命中；代表频率 150 Hz
工频 / FC2	41–45 s	556/712 个检查窗命中；代表频率 150 Hz

展示前2条高频候选及命中最多的2个工频通道；完整候选保留在在线报告。

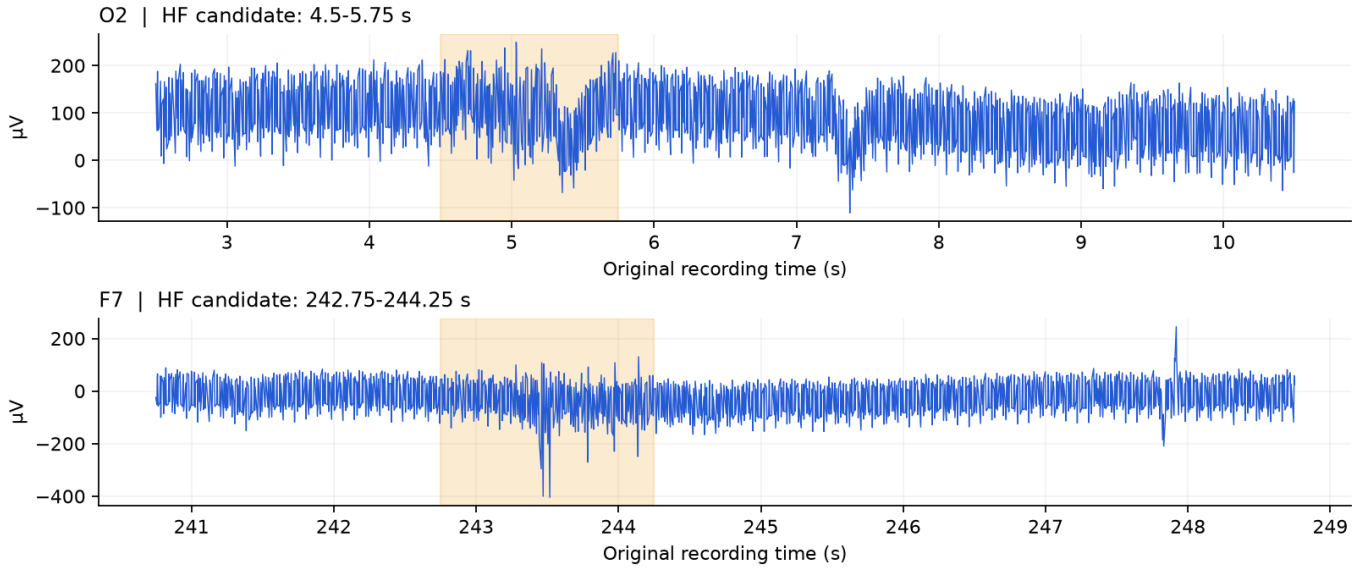

阴影为候选区间；显示原始信号，未清洗、未重参考。

复核记录

结论: _____ 复核人 / 日期: _____

意见: _____

03 总分组成与测量依据

5 项同等计入，总分为这些分项的平均分。

计分项目	占总分	分项 / 100
灵犀云 · 线长通道候选	20.0%	100.00
灵犀云 · 伪差区间	20.0%	99.66
灵犀云 · 低频异常	20.0%	95.71
灵犀云 · 高频异常	20.0%	未评
灵犀云 · PSD 异常通道	20.0%	未评

分项 = 100 ×（1 − 候选占比）；总分 = 各分项 × 对应占比，再相加。比例按显示精度四舍五入。

实际测量

检查项目	实际测量
灵犀云 · 线长通道候选	0 / 45,446 通道与分析块的累计秒数 为候选
灵犀云 · 伪差区间	154.91 / 45,446 秒（各通道累加） 为候选
灵犀云 · 低频异常	1,947.5 / 45,446 秒（各通道累加） 为候选
灵犀云 · 高频异常	已完成 6 / 7 个分析分段；整份分项未汇总。
灵犀云 · PSD 异常通道	已完成 6 / 7 个分析分段；整份分项未汇总。

通道检查窗是一个通道的一个时间窗；累计通道时长是各通道秒数之和。工频命中窗占比不能直接当成整份记录受干扰的时长占比。

计分项目缺失或范围未完成，不补满分、不重新分配比例。比较结果时应使用相同方法、处理状态和计分配置。

灵犀云方法在分析副本上执行，具体滤波、参考和取段参数见在线图表。这里的分项汇总由DBCI-QC提供，并非灵犀云官方总分。

来源与追溯

任务 dc439d321cf540b4a573724b8c9d41b9；规则 project-weighted/1.1；配置 7e24880b79e216d4。

方法来源：BrainElecQC / DBCI-QC / GnosisNeuroDynamicSE

本地报告：/api/v1/jobs/dc439d321cf540b4a573724b8c9d41b9/report

图表：/api/v1/jobs/dc439d321cf540b4a573724b8c9d41b9/visualizations

附录 其他检查

以下结果不计入本方案总分。原始输入的共同基础检查独立保留。

检查项目	分项 / 100	检查发现
信号完整性	99.92	0.08% 的采样点被标记为无效或持续恒值
工频干扰	23.37	76.63% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 62 个通道
高频突发	99.99	<0.01% 的累计通道时长被标记，共 3 段候选
PREP 非空间通道候选	99.74	分段通道候选占比 0.26%（按分析时长汇总）
MNE 幅度通道候选	100.00	本项未检出候选
MNE 幅度区间候选	99.92	0.08% 的已检查时长被标记

实际测量

检查项目	实际测量
信号完整性	无效数值 0 个；持续恒值 17,856 个采样点
工频干扰	33,827 / 44,144 个通道检查窗被标记
高频突发	各通道候选时长合计 4.25 秒 / 有效检查时长合计 44,977.12 秒
PREP 非空间通道候选	120 / 45,446 通道与分析块的累计秒数 为候选
MNE 幅度通道候选	0 / 45,446 通道与分析块的累计秒数 为候选
MNE 幅度区间候选	0.56 / 733 秒 为候选