

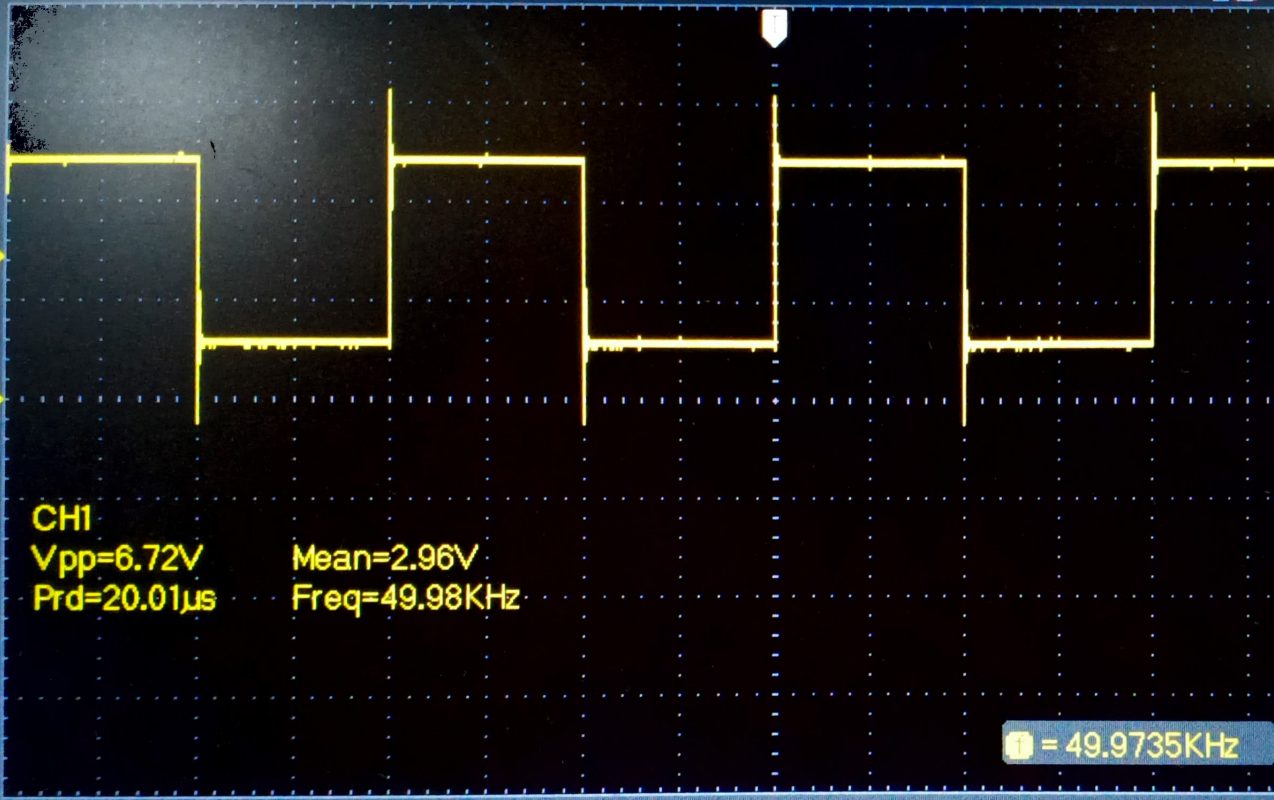
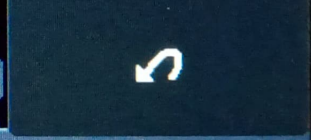
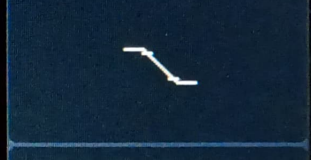


Stop

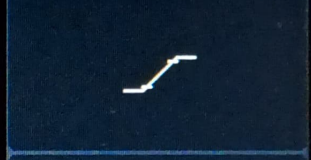

AUTOSET

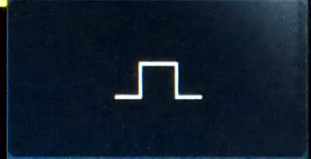

CH1  
Vpp=6.72V  
Prd=20.01μs  
Mean=2.96V  
Freq=49.98KHz

■ = 49.9735KHz

CH1= 2.00V

M5.00 μs MPos:0.00 μs

CH1 /2.88V






Scientech 402 Digital Storage Oscilloscope

70MHz, 1GSa/s

Stop



AUTOSET

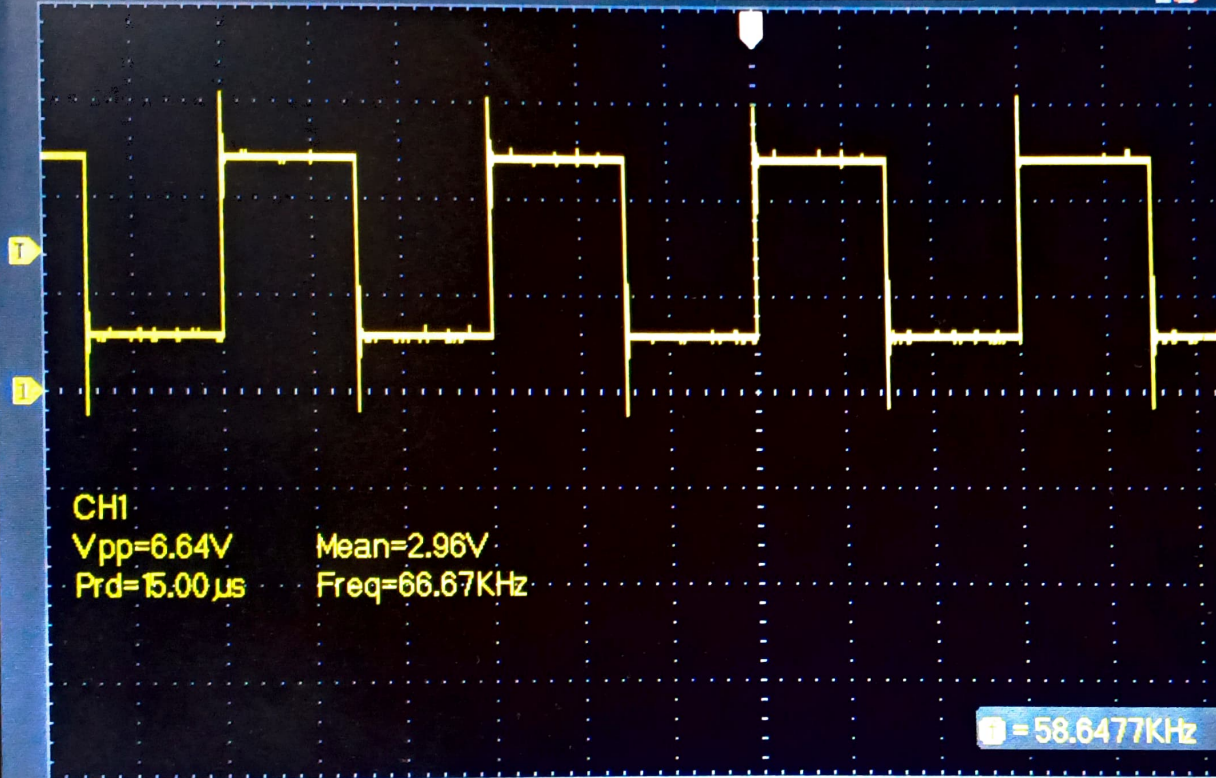

CH1 2.00V

M5.00  $\mu$ s MPos:0.00  $\mu$ s

CH1 /2.88V