


Stop

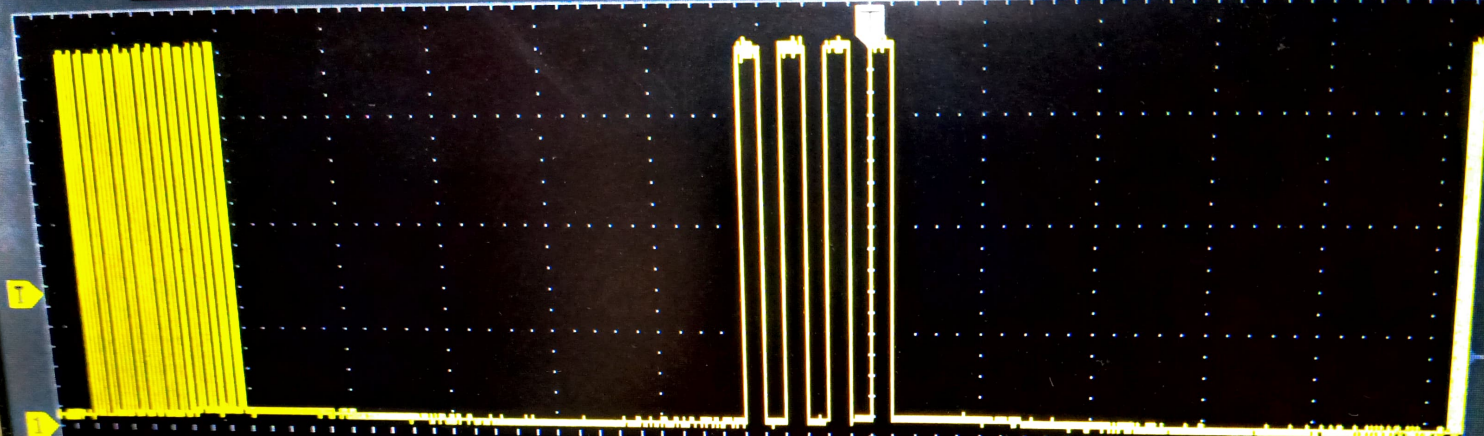

CH1
Vpp=3.68V
Prd=****

Mean=640.0mV
Freq=****

21154KHz

CH1= 100V


M2.50ms MPos:0.00 μ s

CH1 /132V

Armed



AUTOSET

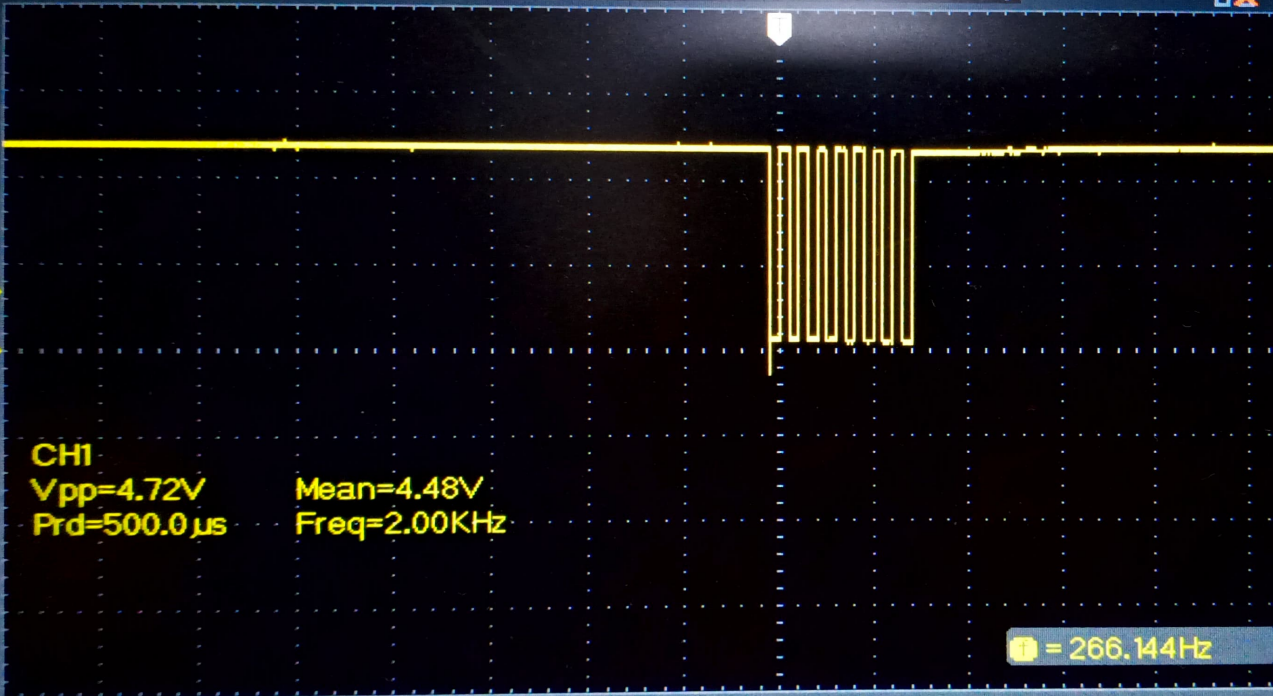


CH1
Vpp=4.72V
Prd=500.0 μs
Mean=4.48V
Freq=2.00KHz

266.144Hz

CH1=2.00V

M2.50ms MPos:0.00 μs


CH1 /136V

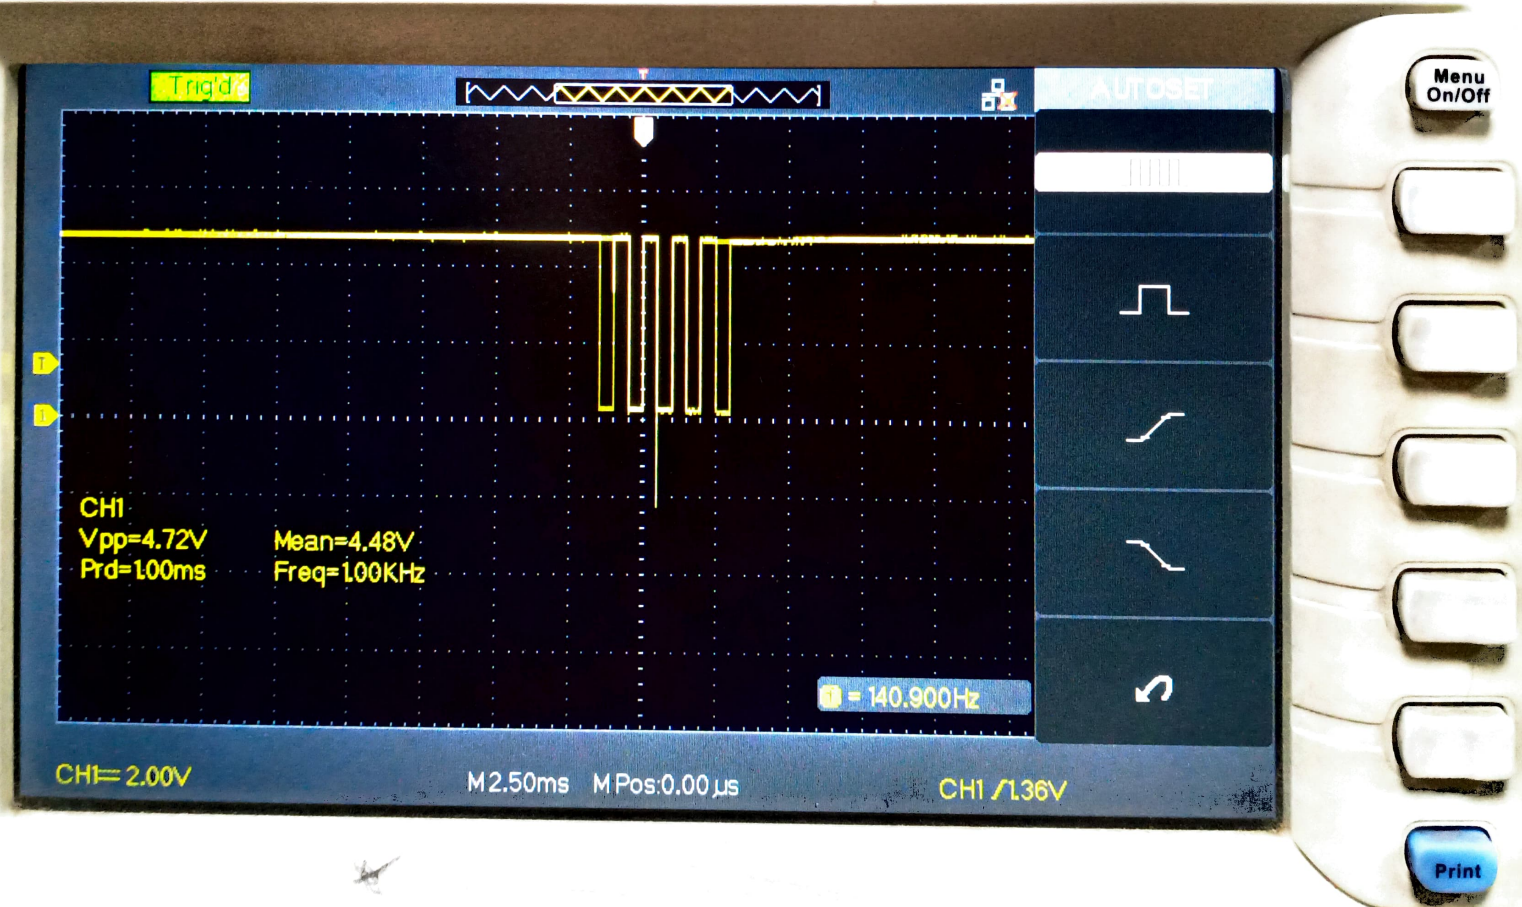



Scientech 402 Digital Storage Oscilloscope

70MHz, 1GSa/s

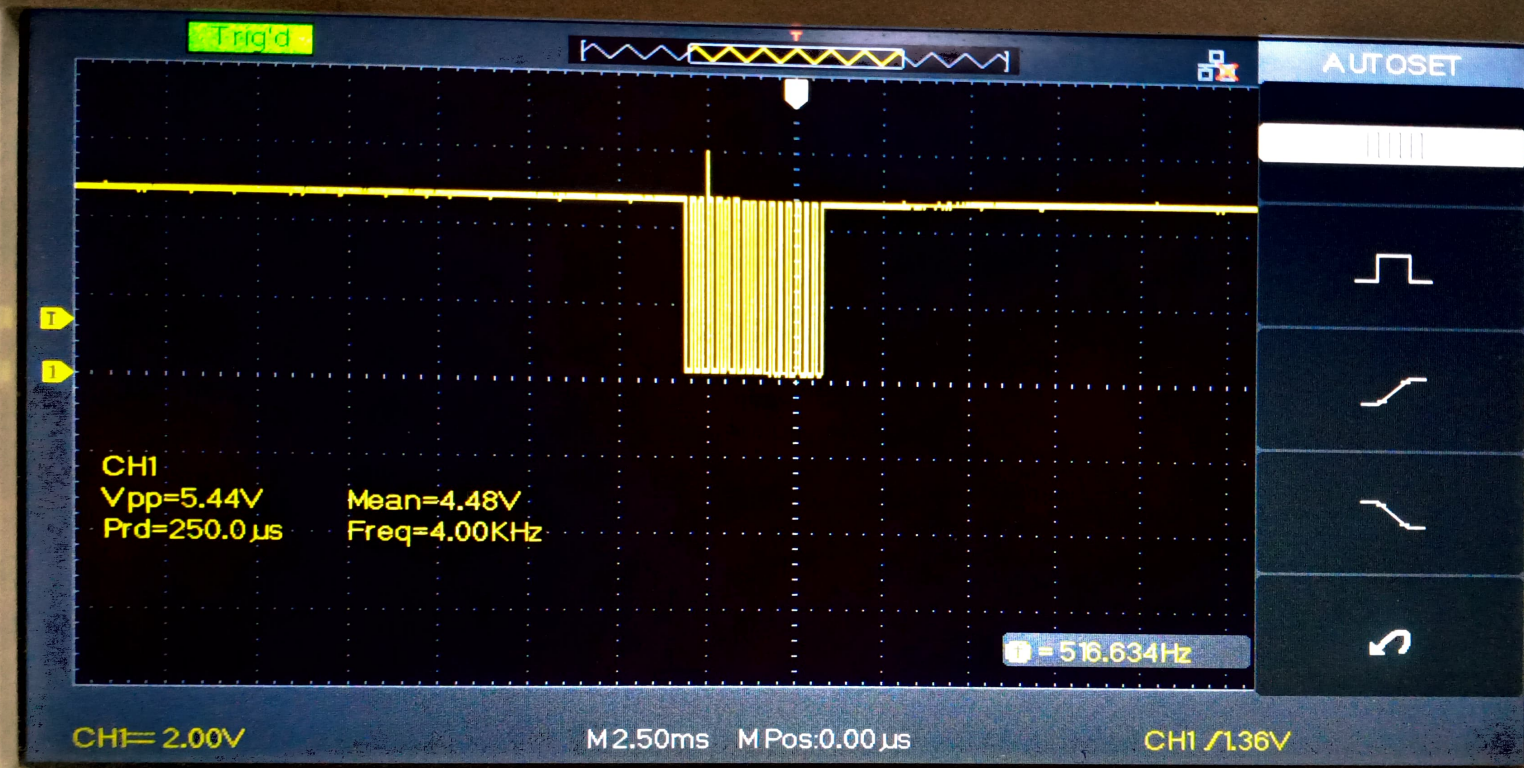

Trig'd



AUTOSET



CH1
Vpp=5.20V
Prd=124.0 μ s
Mean=4.56V
Freq=8.06KHz

101781KHz

CH1 2.00V

M2.50ms MPos:0.00 μ s

CH1 136V