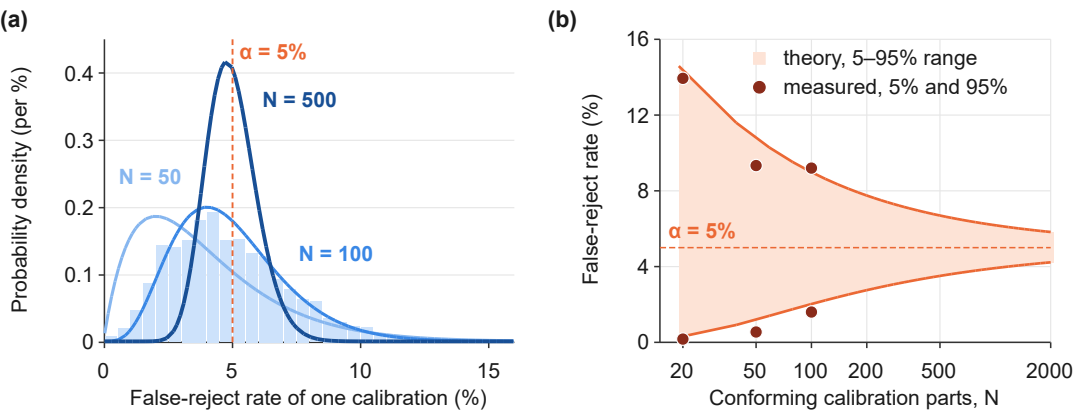
(a)
α = 5%
N = 500
N = 50
N = 100
Probability density (per %)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
5
10
15
False-reject rate of one calibration (%)
(b)
theory, 5–95% range
measured, 5% and 95%
α = 5%
False-reject rate (%)
16
12
8
4
0
20
50
100
200
500
2000
Conforming calibration parts, N