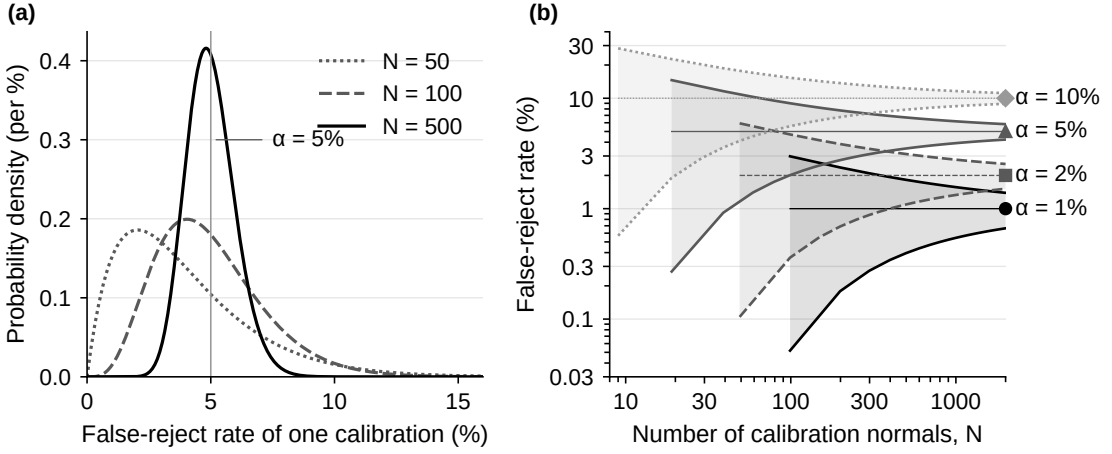
(a)
Probability density (per %)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
N = 50
N = 100
N = 500
α = 5%
0
5
10
15
False-reject rate of one calibration (%)
(b)
False-reject rate (%)
30
10
3
1
0.3
0.1
0.03
α = 10%
α = 5%
α = 2%
α = 1%
10
30
100
300
1000
Number of calibration normals, N