

REVIN BRIELLE

Meet- en regeltechniek

Revision of instruments


TESTRAPPORT

Rapport nummer 1

	Testinstrument	Instrument
Instr.nummer	1A0001R081Z	05MNMS007
Fabrikaat	Wika	Support base
Omschrijving	Dig. Testmanometer	Drukrecorder
Meetbereik	0-100 bar	0-60 bar
Klasse	0.5	1,60
Klant	J de Jonge lease	
Getest door	L. van den Berg	

Meetpunten	Range Meetwaarde		Meetwaarde	Meetfout %	
	Bar	Stijgend		Stijgend	Dalend
1	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2	10,00	10,22	10,54	0,367	0,900
3	20,00	20,26	20,45	0,433	0,750
4	30,00	30,15	30,38	0,250	0,633
5	40,00	40,04	40,41	0,067	0,683
6	50,00	49,93	50,31	-0,117	0,517
7	60,00	59,91	59,91	-0,150	-0,150

Getest volgens en 837/1 en kaart# 1950

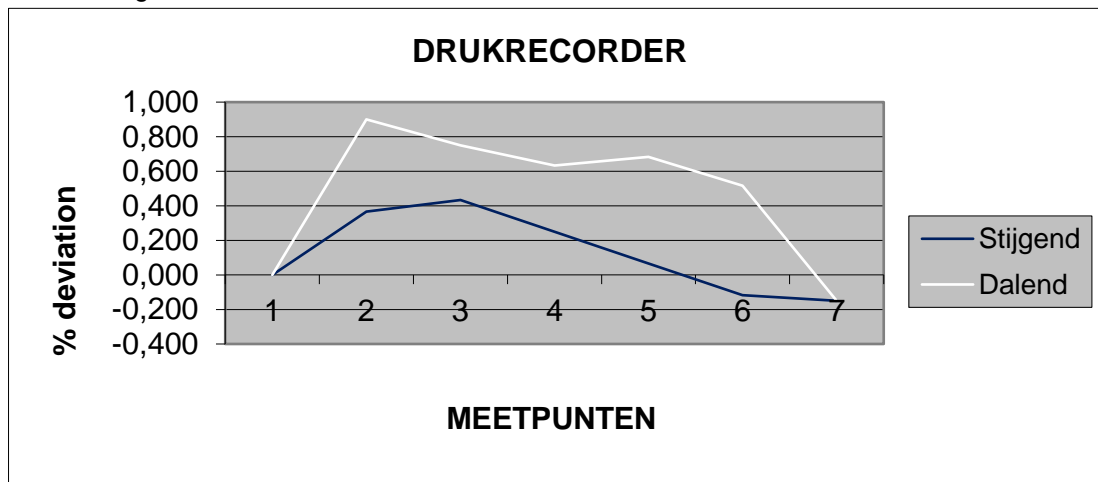

Datum 28-10-19
Ref.klant 05MNMS007/rep
Ref. Revin 20191130

REVIN BRIELLE B.V.
't Woud 16
3332 LN Brielle
Tel: (0181) 413094
email: info@revinbrielle.com

Revin Brielle B.V. - Industrieterrein 't Woud 16, 3232 LN Brielle
Tel. (0181) 41 30 94 - E-mail info@revinbrielle.com - www.revinbrielle.com
Bank: Rabo. Rekeningnr. IBAN NR NL45RABO0344868680 - K.v.K. Rotterdam 24237422

Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid (SMECOMA VOORWAARDEN), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder no. 5325 zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst die voor de eerste maal werd gedeponeerd op 30 juni 1950 doch sindsdien enige malen is aangevuld en gewijzigd.