


TCN19-240 normalized to TCN19-010:  $1.02795210681 \pm 0.00645711624681$

Transmission (normalized during counting)

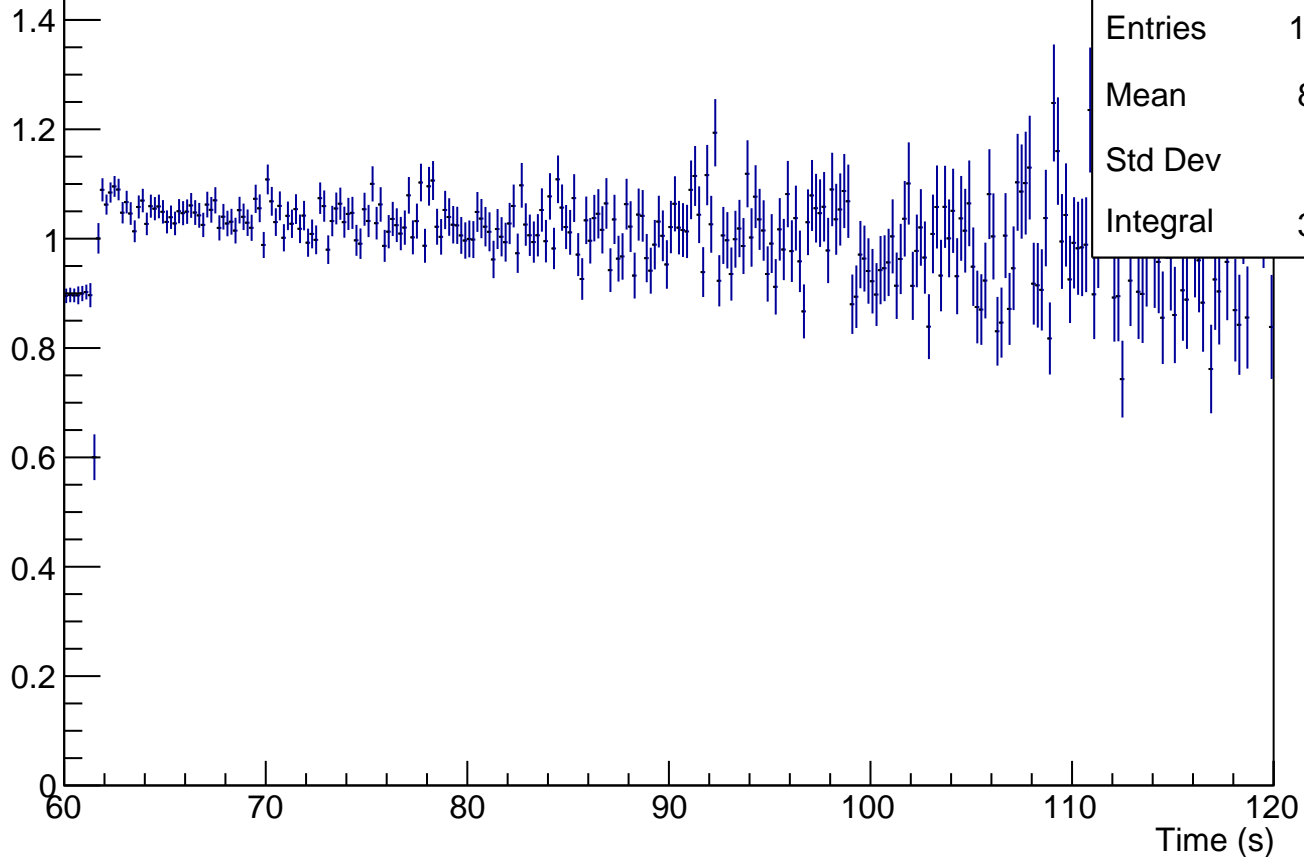

TCN19-240 normalized to TCN19-010:  $1.02585105031 \pm 0.00740331042755$

Transmission (normalized during irradiation)

1.4  
1.2  
1.0  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

60 70 80 90 100 110 120

Time (s)

TCN19-240 (UGD02+22)\_Li6\_norm

Entries 15871

Mean 89.84

Std Dev 17.3

Integral 296.6

