


TCN19-123 normalized to TCN19-120A: $1.00563293849 \pm 0.00603711268296$

Transmission (normalized during counting)

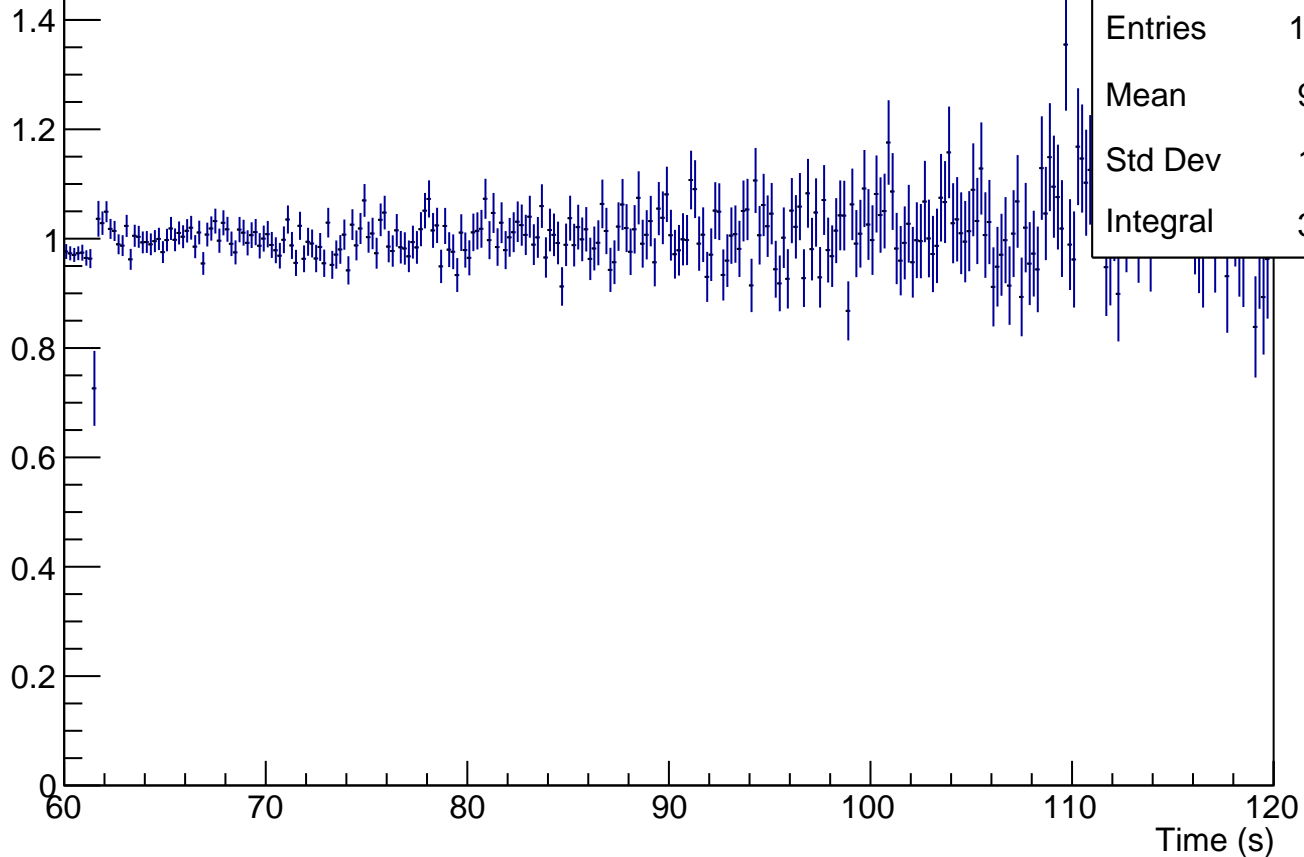

TCN19-123_Li6_norm

Entries 10705


Mean 90.53

Std Dev 17.42

Integral 306.9

TCN19-123 normalized to TCN19-120A: $1.00751644917 \pm 0.00723473119782$

Transmission (normalized during irradiation)

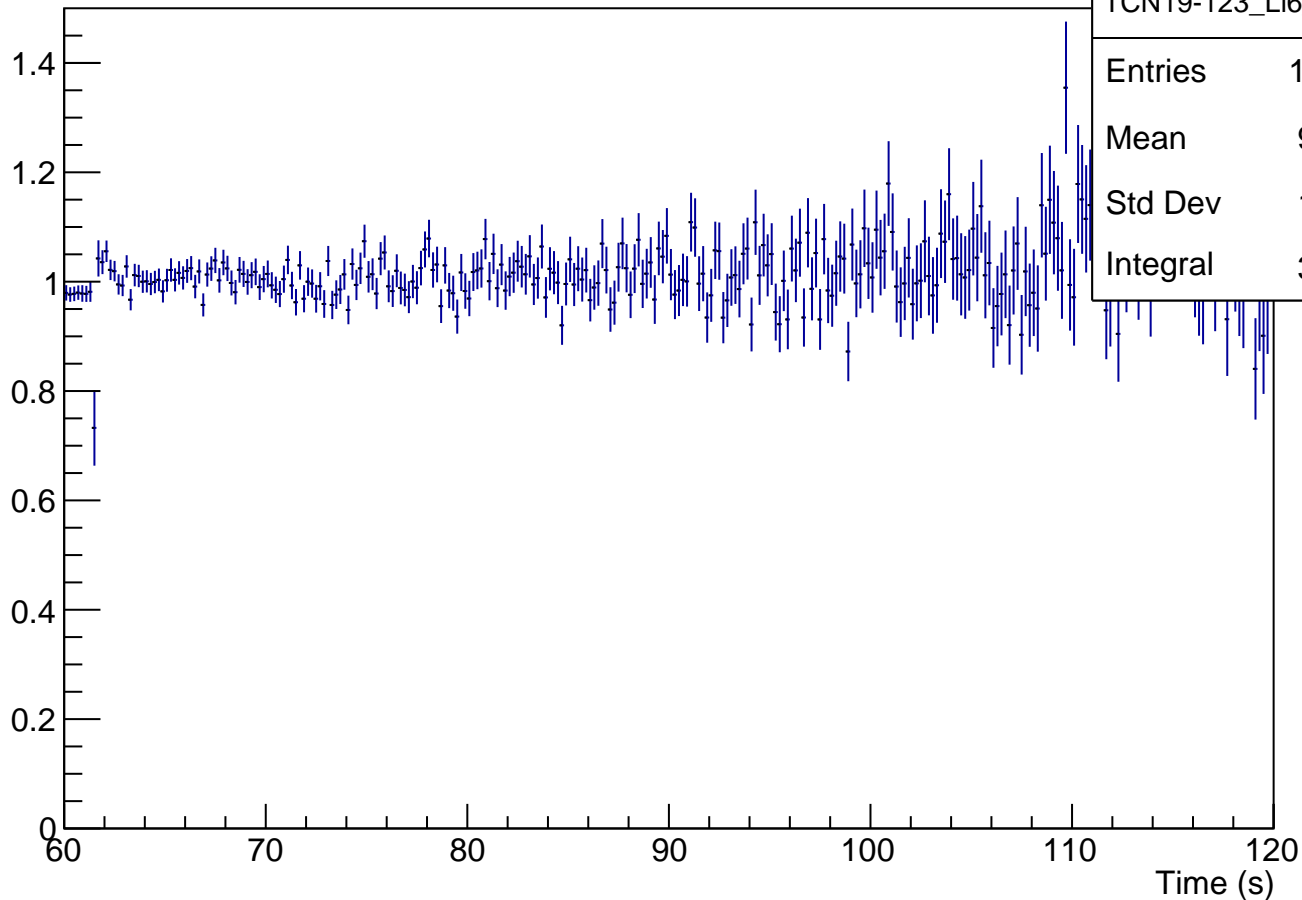

TCN19-123_Li6_norm

Entries 10598

Mean 90.53

Std Dev 17.42

Integral 308.6