


TCN19-010 normalized to TCN19-010D: 0.9984762449 +/- 0.00577315845986

Transmission (normalized during counting)

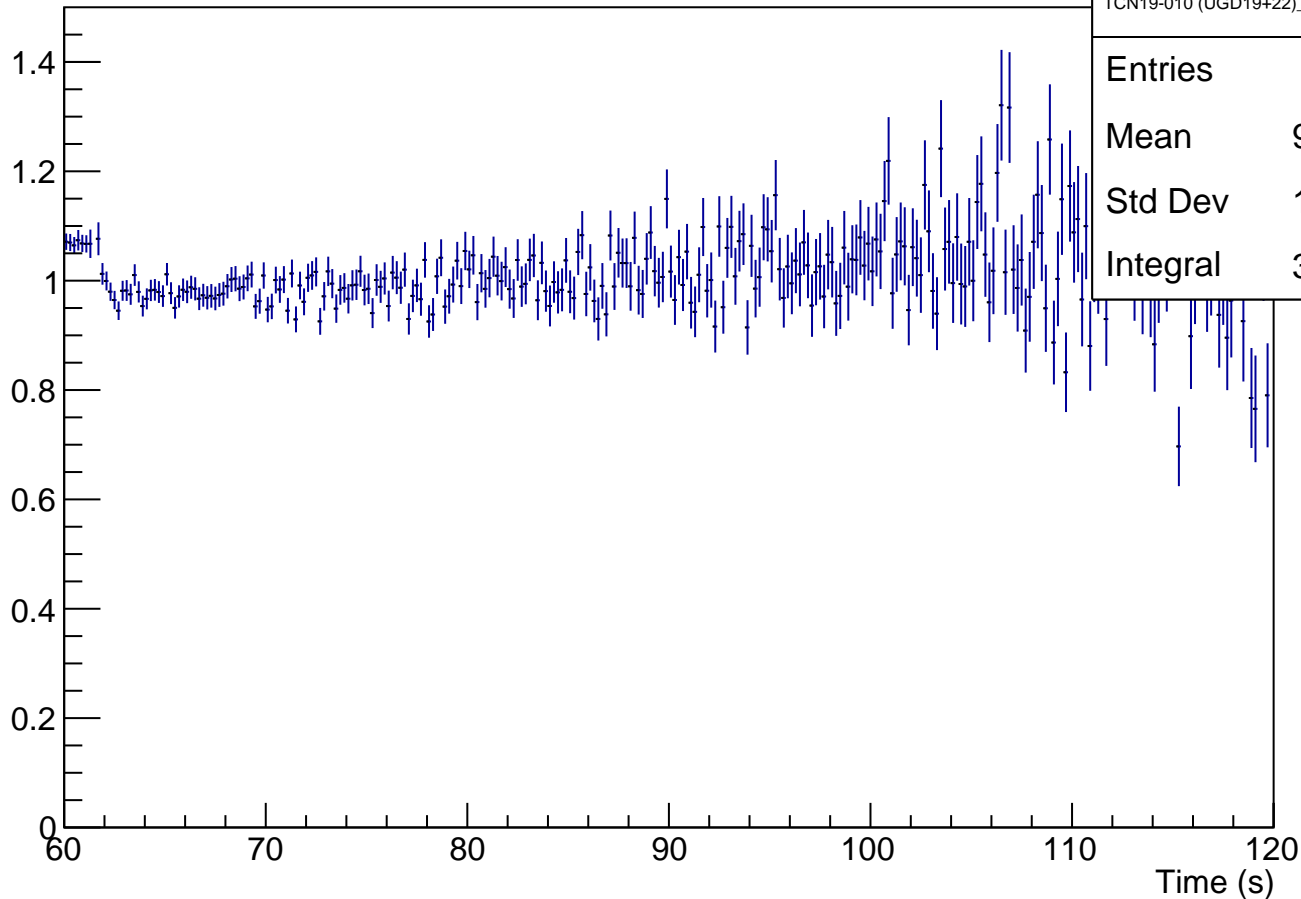

TCN19-010 normalized to TCN19-010D:  $0.989894179355 \pm 0.00789004622577$

Transmission (normalized during irradiation)

