


TCN19-120A normalized to TCN19-120: $0.915904647247 \pm 0.00535362034447$

Transmission (normalized during counting)

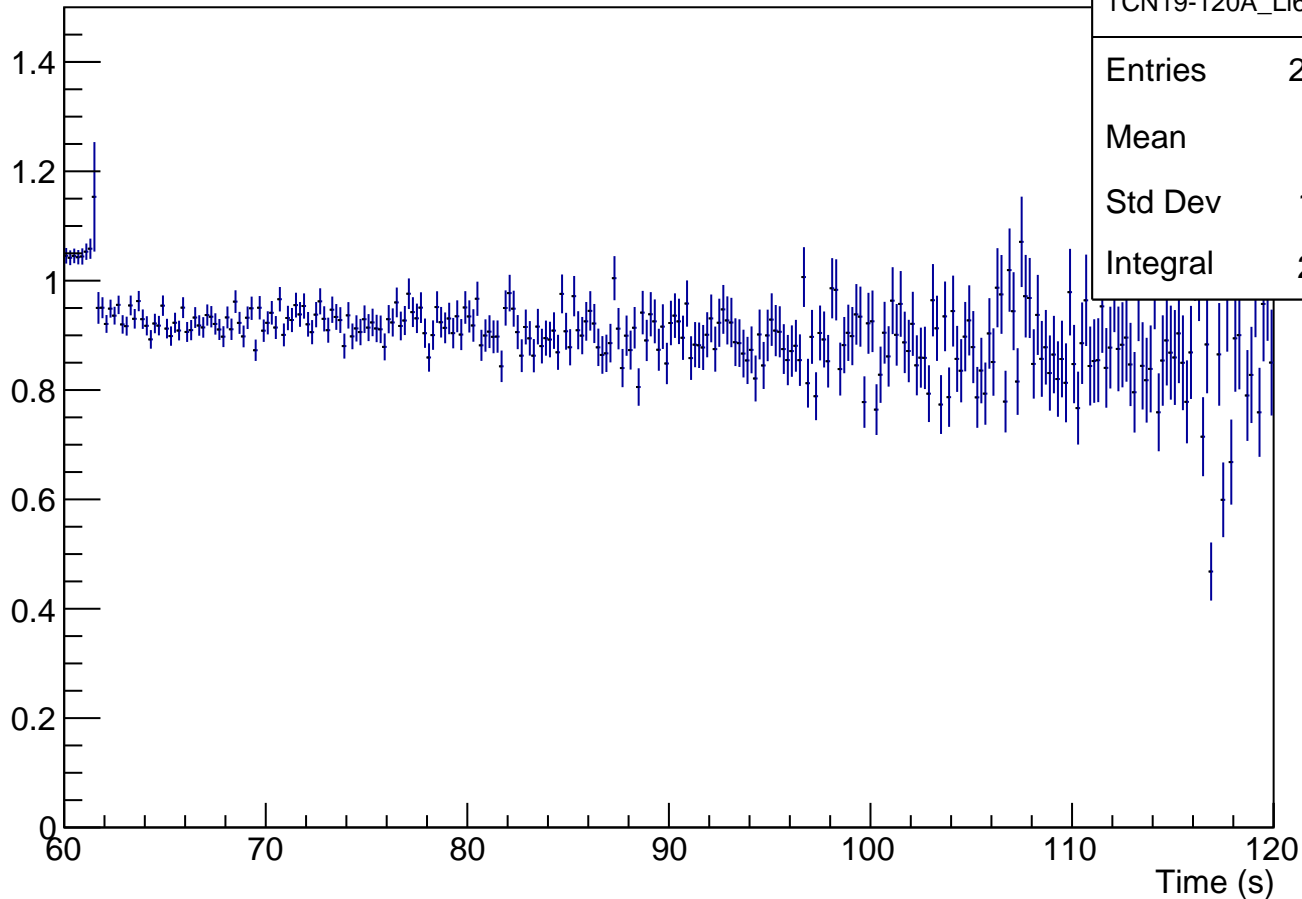

TCN19-120A_Li6_norm

Entries 25762

Mean 89.51

Std Dev 17.38

Integral 271.5

TCN19-120A normalized to TCN19-120: 0.916386513618 +/- 0.0058671326011

Transmission (normalized during irradiation)

