
距踵関節撮影用 補助具（片側用）設計図


素材：硬質発泡スチロール（押出法ポリスチレン/XPS） 200×100×50 mm ×1個 → 斜めに1回切って A・B の2個

狙い：背屈 14.0°（≒15°）＋ 内返し 20.2°（≒20°） ／ X線は頭尾方向（指先方向）へ30° 斜入

① 平面図（上から見た図・縮尺75%） 寸法はすべて P-Q 辺からの距離 mm

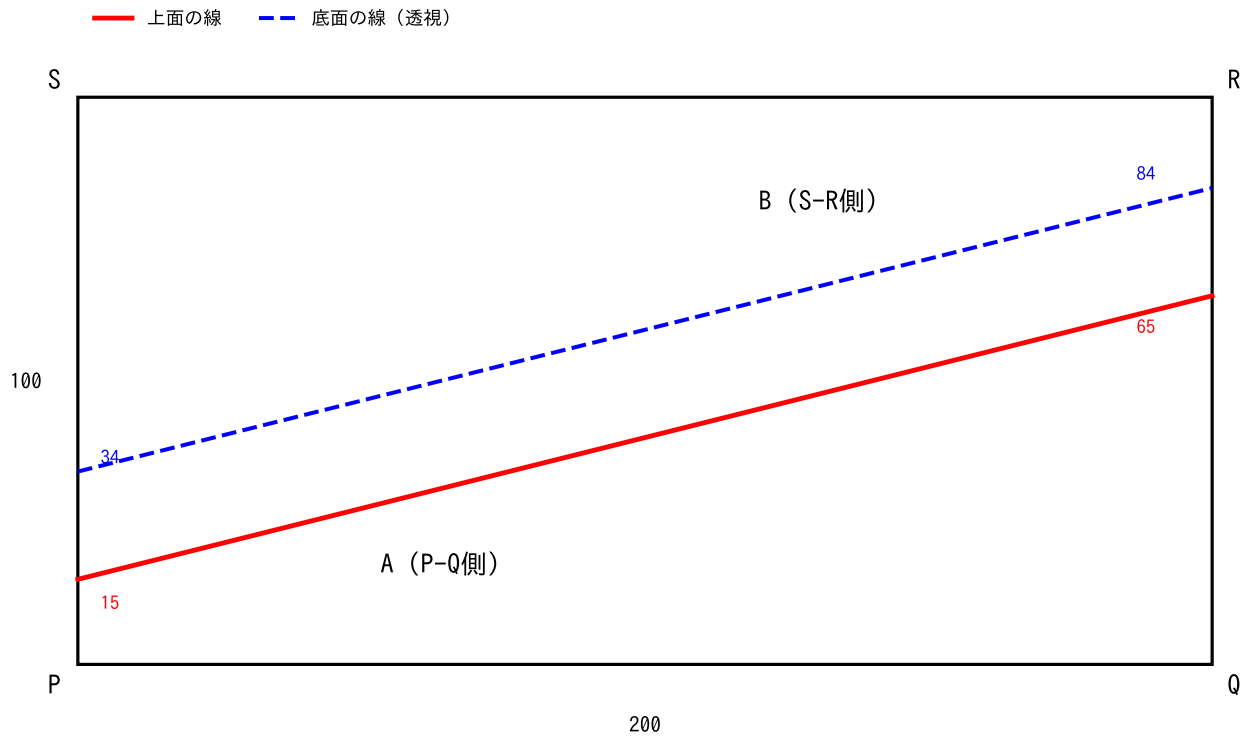

② 端面図（P-S側の端を外から見た図・原寸）

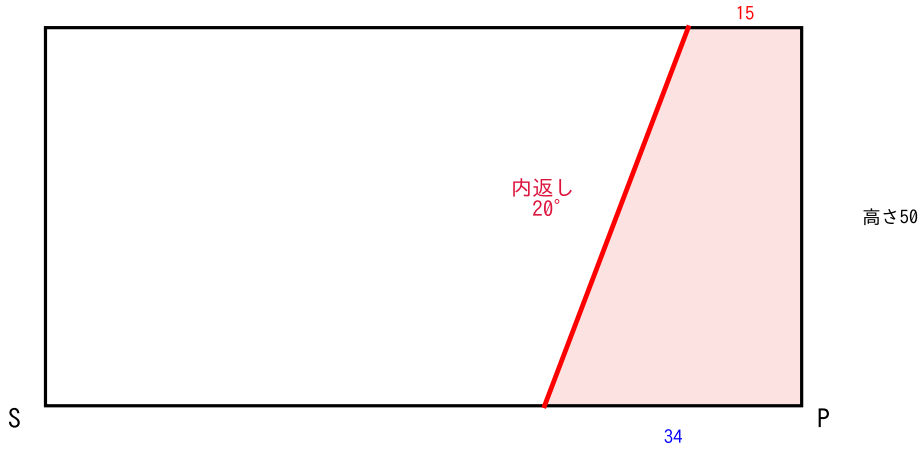

③ 作り方


1. ブロックの4本の縦の角に、マーカーで P・Q・R・S を書く（平面図と同じ並び）。
2. 2ページ目（上面）・3ページ目（底面）を【100%・実際のサイズ】で印刷。スケールが100mmか確認。
3. 上面に2ページ目、底面に3ページ目を、P・Q・R・Sの角を合わせて貼る（スプレーのり/マステ）。
4. 両端面に4ページ目の端面図を貼る（または端面に15→34mm、65→84mmの線を直接引く）。
5. 熱線カッター（スチロールカッター）の線を、上面の赤線と底面の青線に同時に沿わせて1回で切る。
   → 切り口は上と下でズレた『ねじれていない斜めの平面』になる。2人で上下を見ながら切ると確実。
6. 切り口を紙やすり（#120程度）で整え、分度器かスマホの傾斜計アプリで角度を確認。
7. 臨床使用は全体をビニール/ラップで覆うかビニールテープで巻き、清拭できるようにする。
   向き（左足底/右足底、↑30° の矢印、アントンセン）をマジックで書いておくと迷わない。

④ 左右と向き

・A と B は切り口の向きが逆。上下を裏返すと切り口の傾き（せり出し/オーバーハング）が反転する。
・実際に足底を当て、つま先側が背屈し、足底が内返し方向（外側を受像面につけた時に足底がやや天井を向く）
  になる置き方を左右それぞれで決めて、ピースに『左足底』『右足底』と書く。
・両側同時撮影用（スライドの台形タイプ）は、もう1個ブロックを同様に切り、Aと裏返したB(B')を
  まっすぐな200mmの面どうしで貼り合わせる（両面テープ/発泡スチロール用接着剤）。

※ 本図は研究会スライド（設計：三菱神戸病院 高井夏樹氏）の写真から角度条件（背屈15° ・内返し20°）を満たすよう
  再構成したもの。原図の15mm/35mmの取り方と完全一致は未確認。原典があればそちらを優先。


上面テンプレート（原寸 1:1）— ブロックを上から見た向き

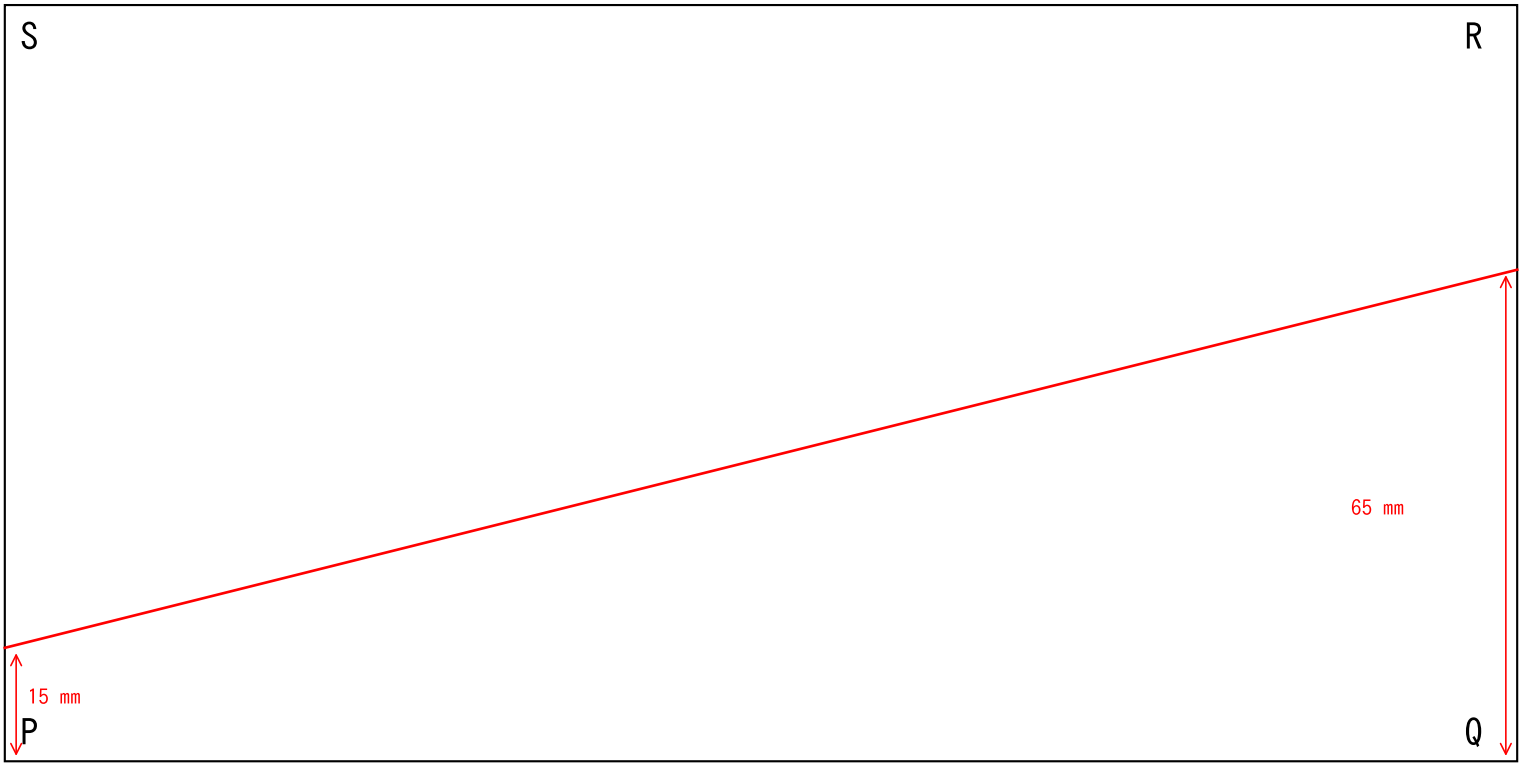

外周の長方形をブロックの面の縁に合わせ、P・Q・R・S を角の記号と一致させて貼る


確認用スケール 100 mm（印刷後に定規で測って100mmならOK）

底面テンプレート（原寸 1:1）— ブロックを裏返して底面を見た向き

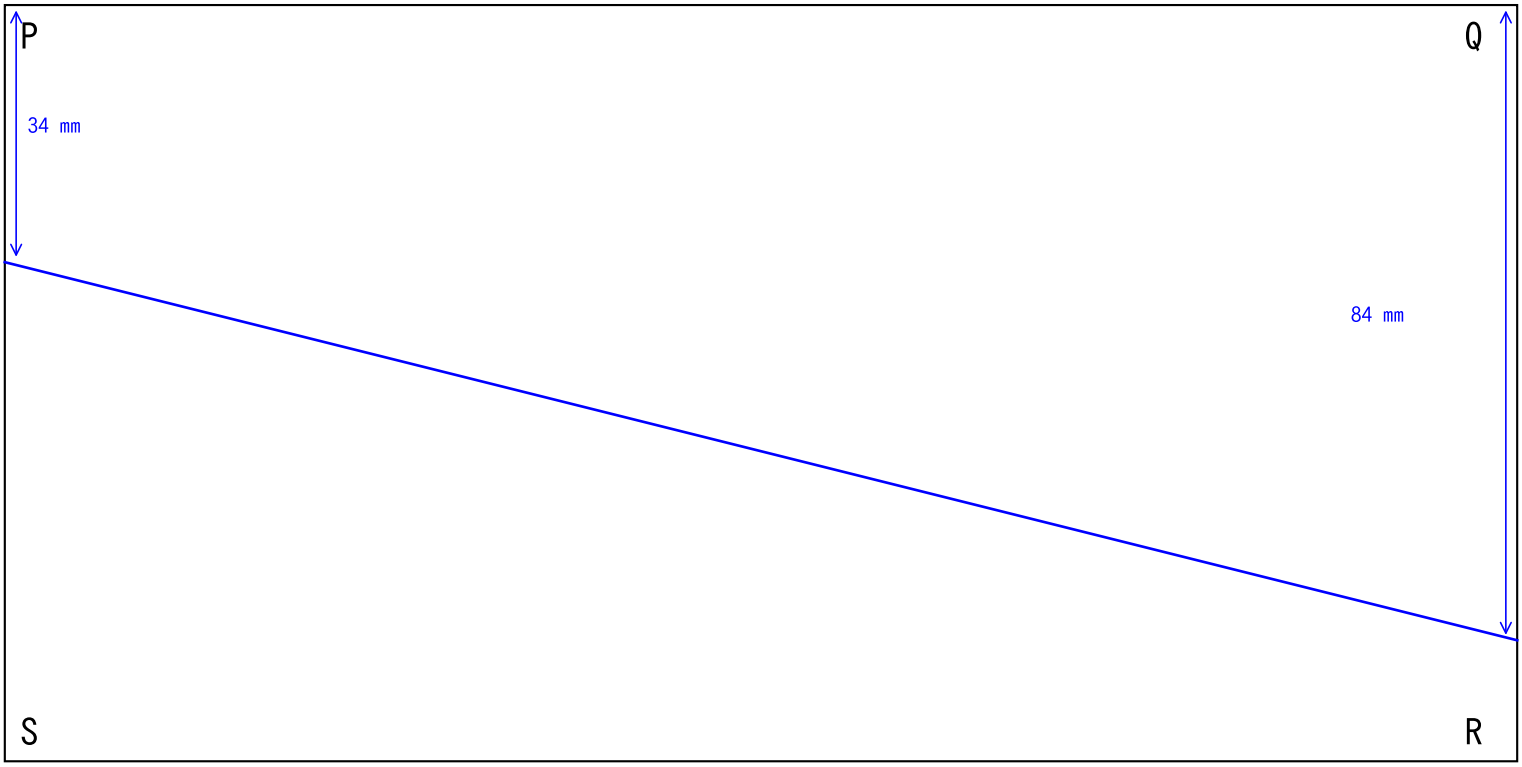


外周の長方形をブロックの面の縁に合わせ、P・Q・R・S を角の記号と一致させて貼る

確認用スケール 100 mm（印刷後に定規で測って100mmならOK）




端面テンプレート（原寸 1:1）— それぞれ外側から見た向き

P-S側の端面（数字は P-Q辺からの mm）

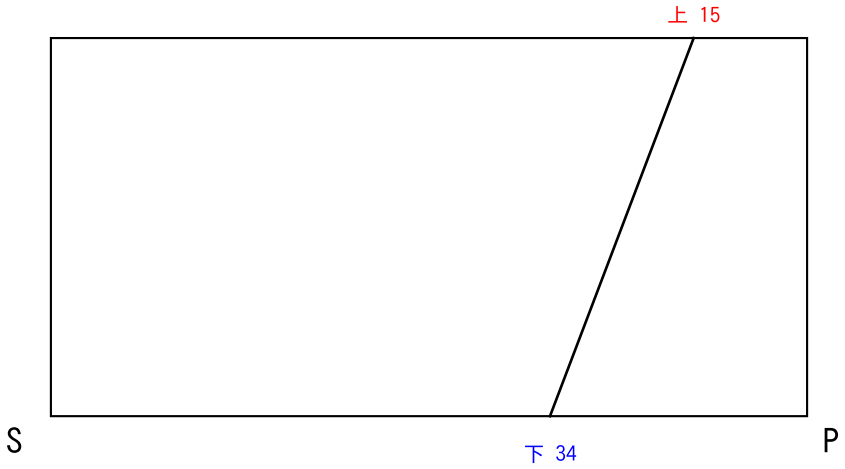

Q-R側の端面（数字は P-Q辺からの mm）

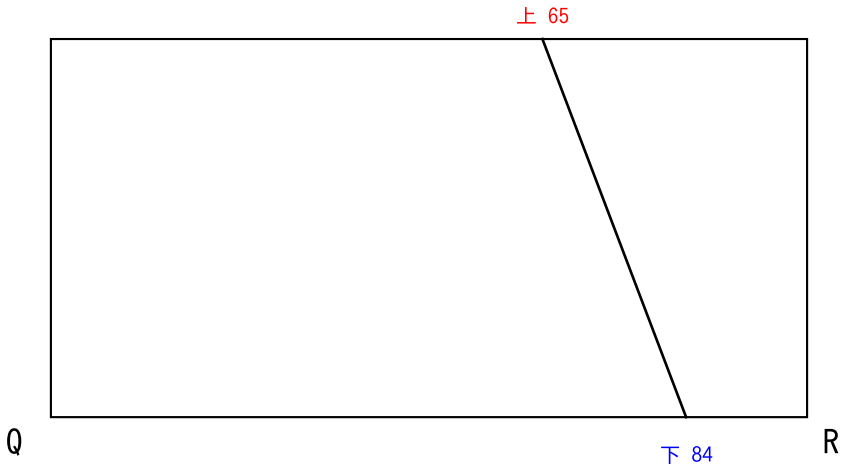

確認用スケール 100 mm（印刷後に定規で測って100mmならOK）

