
距踵関節撮影 クロステーブル用補助具（くさび2枚重ね）


基準面（足の裏をまっすぐ立てた面） ＋ 背屈くさび 14° ＋ 内返しくさび 20°

素材：硬質発泡スチロール（XPS：スタイロフォーム／ミラフォーム等）200×100×50 mm


① 横から見た図（縮尺50%）

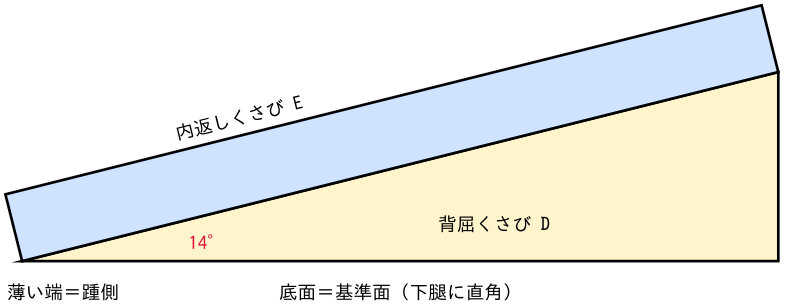

② つま先側から見た E

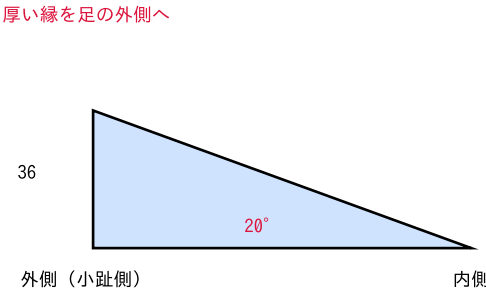

③ 使い方（真上から見た模式図・左足の例）

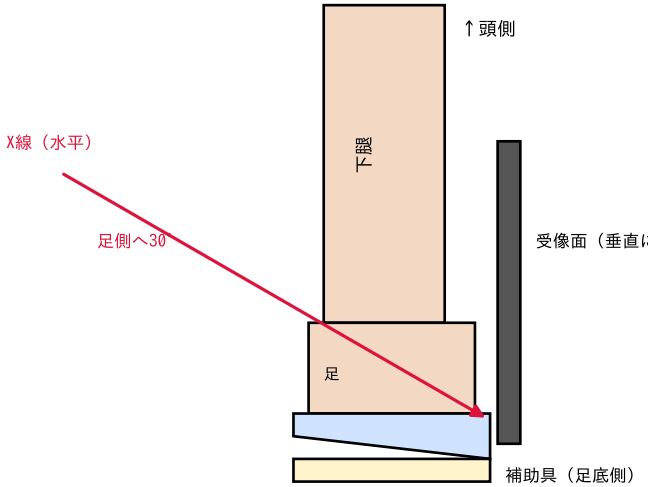

- 仰臥位。患側の下腿を台にのせて少し挙上し、健側と離す（X線の通り道をあける）。
- 受像面を足の外側に垂直に立てて密着。
- 補助具の底面（Dの平らな面）を下腿に直角＝『足の裏をまっすぐ立てた面』に合わせる。
- 足の裏を斜面にぴったり当てる
  → 背屈14° と内返し20° が同時に決まる。
- Dの厚い端がつま先側、Eの厚い縁が外側。
- X線は水平、頭尾方向（足側）へ30° 斜入。中心・距離・条件は施設の手順に従う。
- 固定：ベルト（面ファスナー）で足と補助具を一緒に巻くと手で押さえなくて済む。

④ 作り方


1. ブロック1個目 → 2ページ目の型紙を両方の側面（200×50の面）に貼り、対角線で切る → 背屈くさびDが2個とれる（同じ形）。
2. ブロック2個目 → 3ページ目の型紙を両方の端面（100×50の面）に貼り、線で切る → 内返しくさびE（厚さ36→0）。
   残りの上側（厚さ14→50、斜めの面がやはり20° ）も反対側の足用のEとして使える。
3. Dの斜面にEの平らな面を重ねる。向きは①②の図のとおり（Eの傾きはDの傾きと90° ちがう方向）。
4. 左右：Eを180° 回して（厚い縁を反対側にして）貼れば反対の足用。
   1セットで左右兼用にするなら、DとEを接着せず面ファスナーで留めて付け替える。
5. 仮止め（強力両面テープ）→ 足を当てて確認 → 本止め（『発泡スチロール用』接着剤）。
6. 全体をビニールテープで巻く（尖った縁の補強と清拭のため）。『右』『左』『つま先↑』『外側』を記入。
7. 患者さんに使う前に、補助具だけを臨床条件で1回撮影して、継ぎ目が写らないか確認。

※ 新潟救急撮影研究会のスライド（設計：三菱神戸病院 高井夏樹氏）の写真と『背屈14° ＋内返し20° 』の説明から再構成。
原図そのものではありません。原図が手に入ればそちらを優先。重ねによる角度の誤差は1° 未満。

購入：2〜3個（左右を固定で作るなら3個、失敗用の予備に＋1個）

背屈くさび D：側面の型紙（原寸 1:1）— 14.0°

50 mm（厚い端＝つま先側）

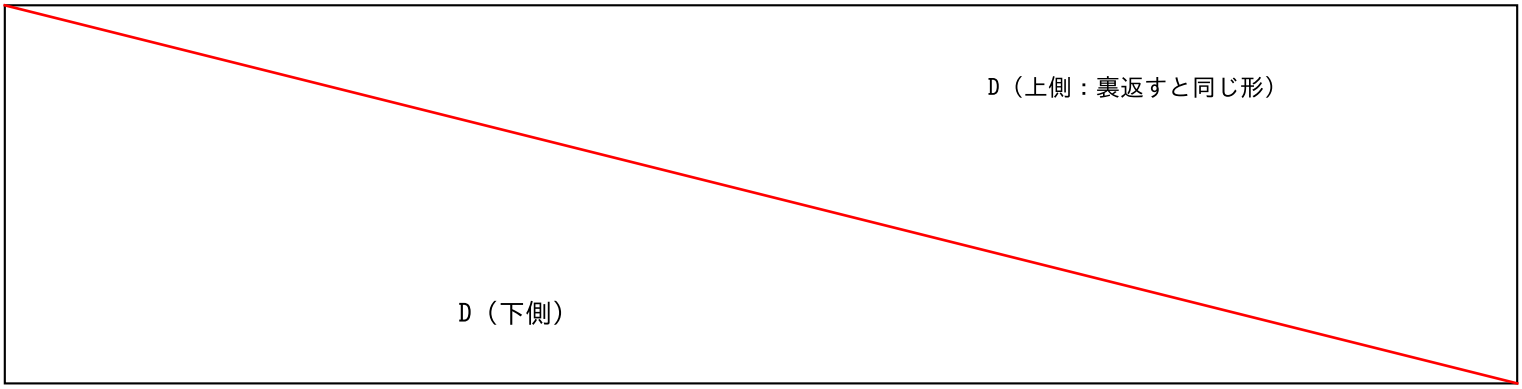


200 mm

ブロックの200×50の側面2面に、角を合わせて1枚ずつ貼る（2枚印刷）。赤線＝切る線


反対側の面に貼る時は裏から見た向きになるので、赤線が『同じ角どうし』を結んでいるか確認

確認用スケール 100 mm（印刷後に定規で測って100mmならOK）




内返しくさび E：端面の型紙（原寸 1:1）— 20°

端面その1

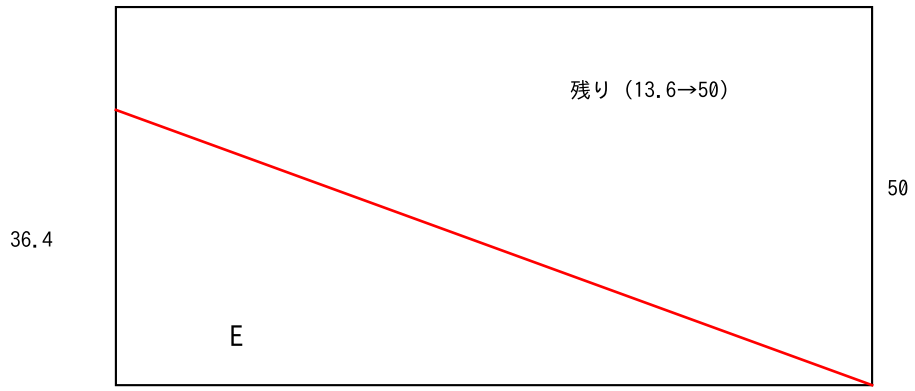

端面その2（もう一方の端）

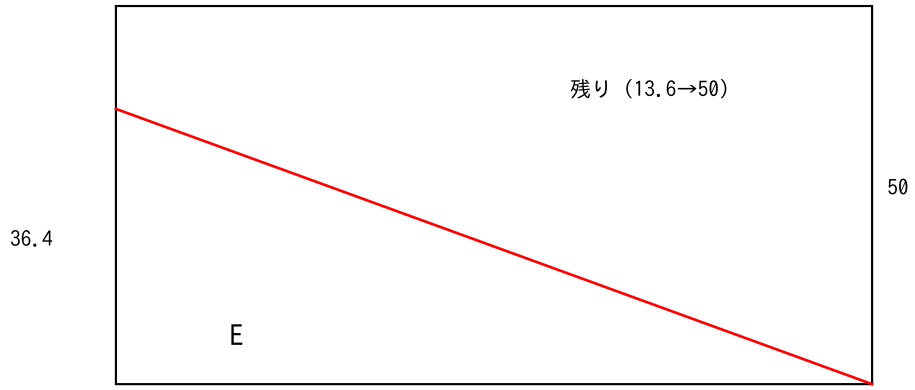

ブロックの100×50の端面2面に貼る。2面で『36.4mmの点』が同じ長い辺の側にくるように（ねじれ防止）

確認用スケール 100 mm（印刷後に定規で測って100mmならOK）

