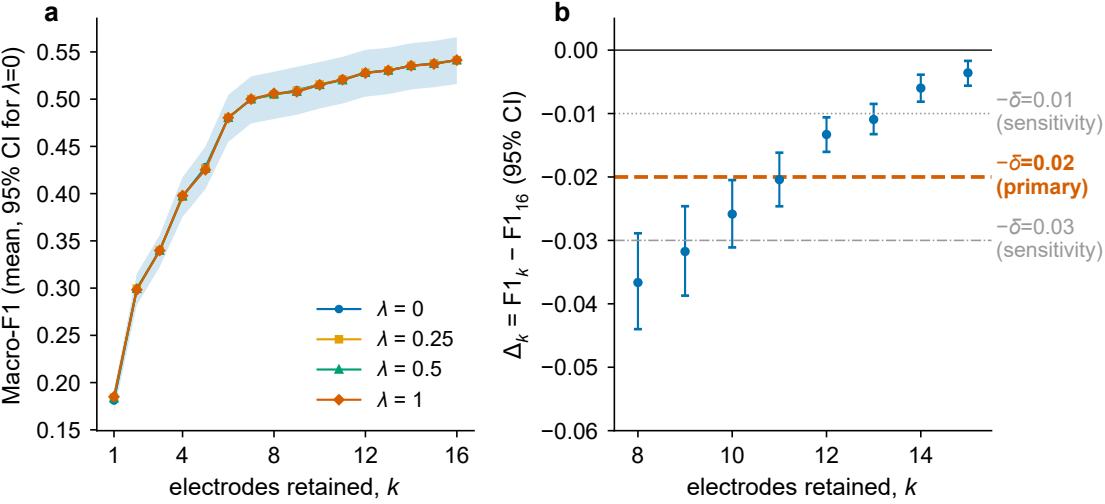
a
Macro-F1 (mean, 95% CI for λ=0)
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
1
4
8
12
16
electrodes retained, k
λ = 0
λ = 0.25
λ = 0.5
λ = 1
b
Δk = F1k − F116 (95% CI)
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
−0.05
−0.06
8
10
12
14
electrodes retained, k
−δ=0.01
(sensitivity)
−δ=0.02
(primary)
−δ=0.03
(sensitivity)