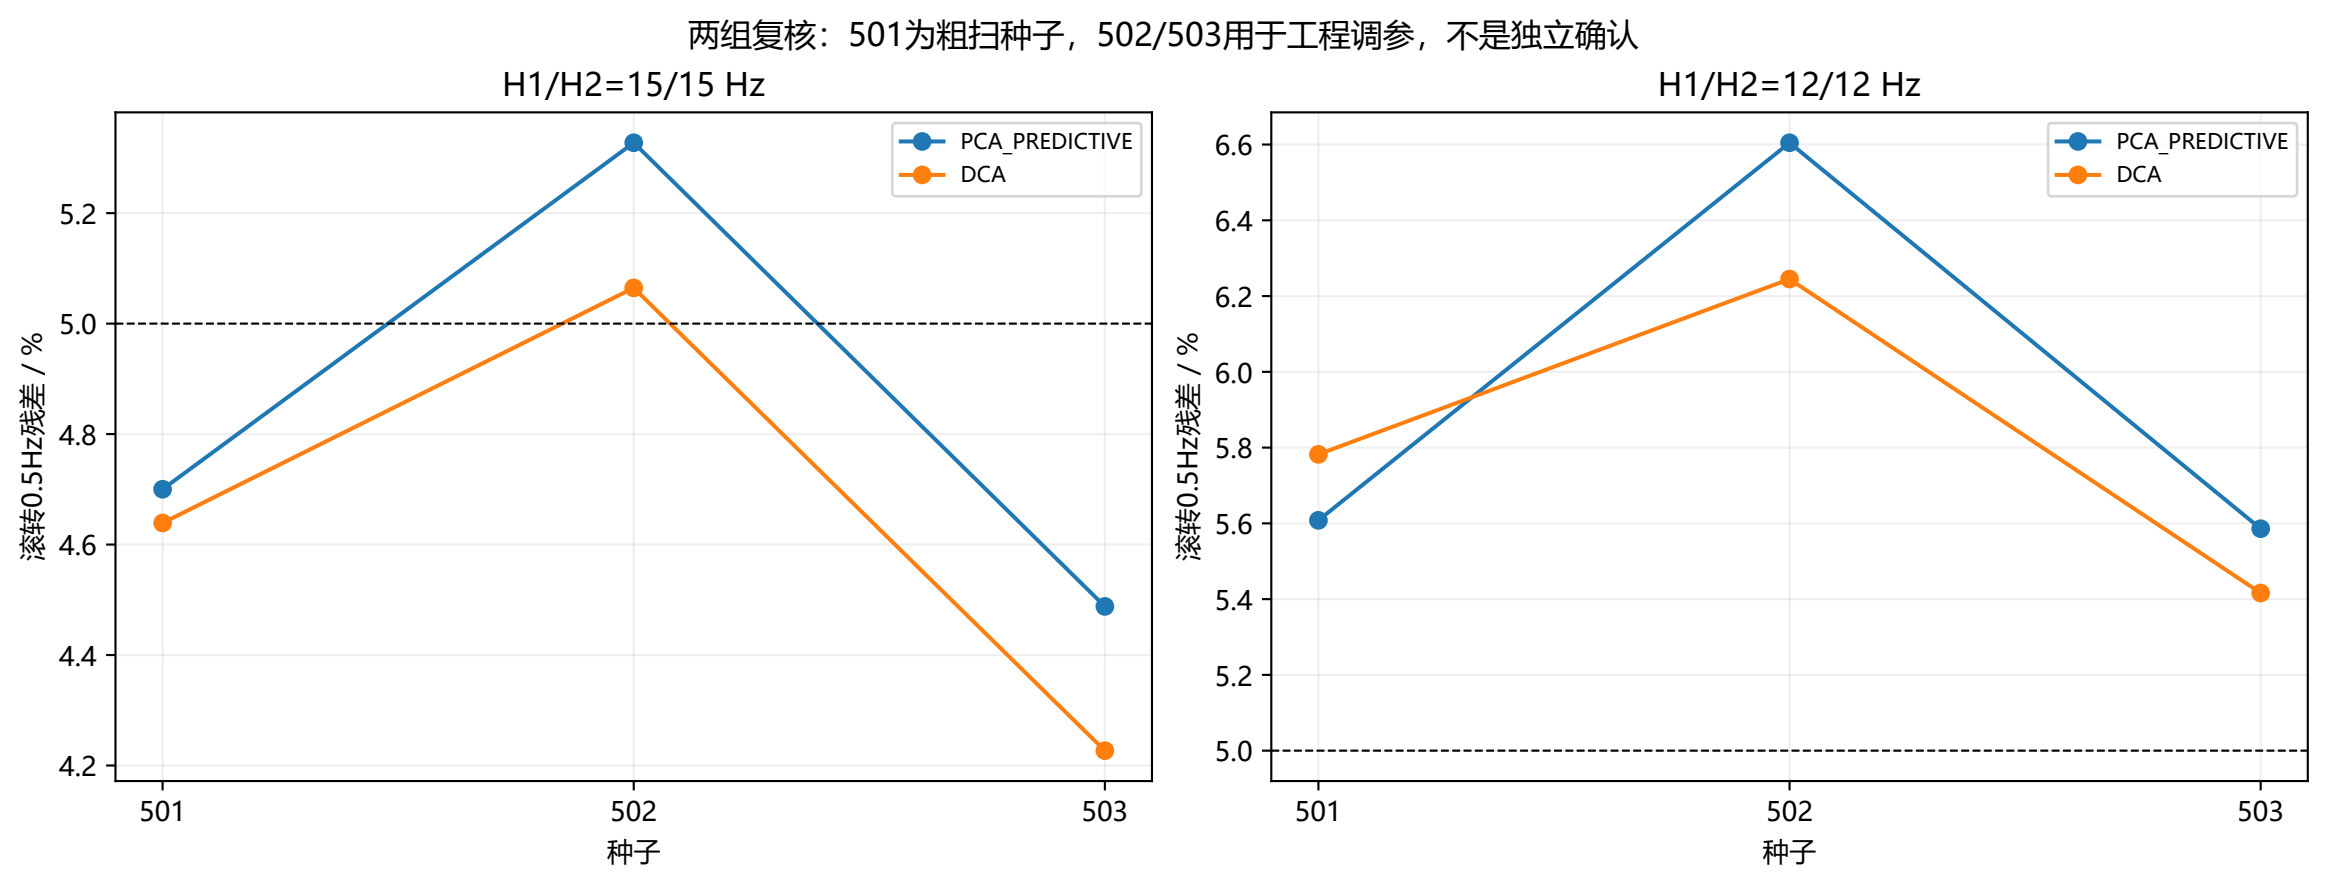
两组复核：501为粗扫种子，502/503用于工程调参，不是独立确认
H1/H2=15/15 Hz
H1/H2=12/12 Hz
PCA_PREDICTIVE
DCA
滚转0.5Hz残差 / %
种子
501
502
503
5.2
5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
6.6
6.4
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4