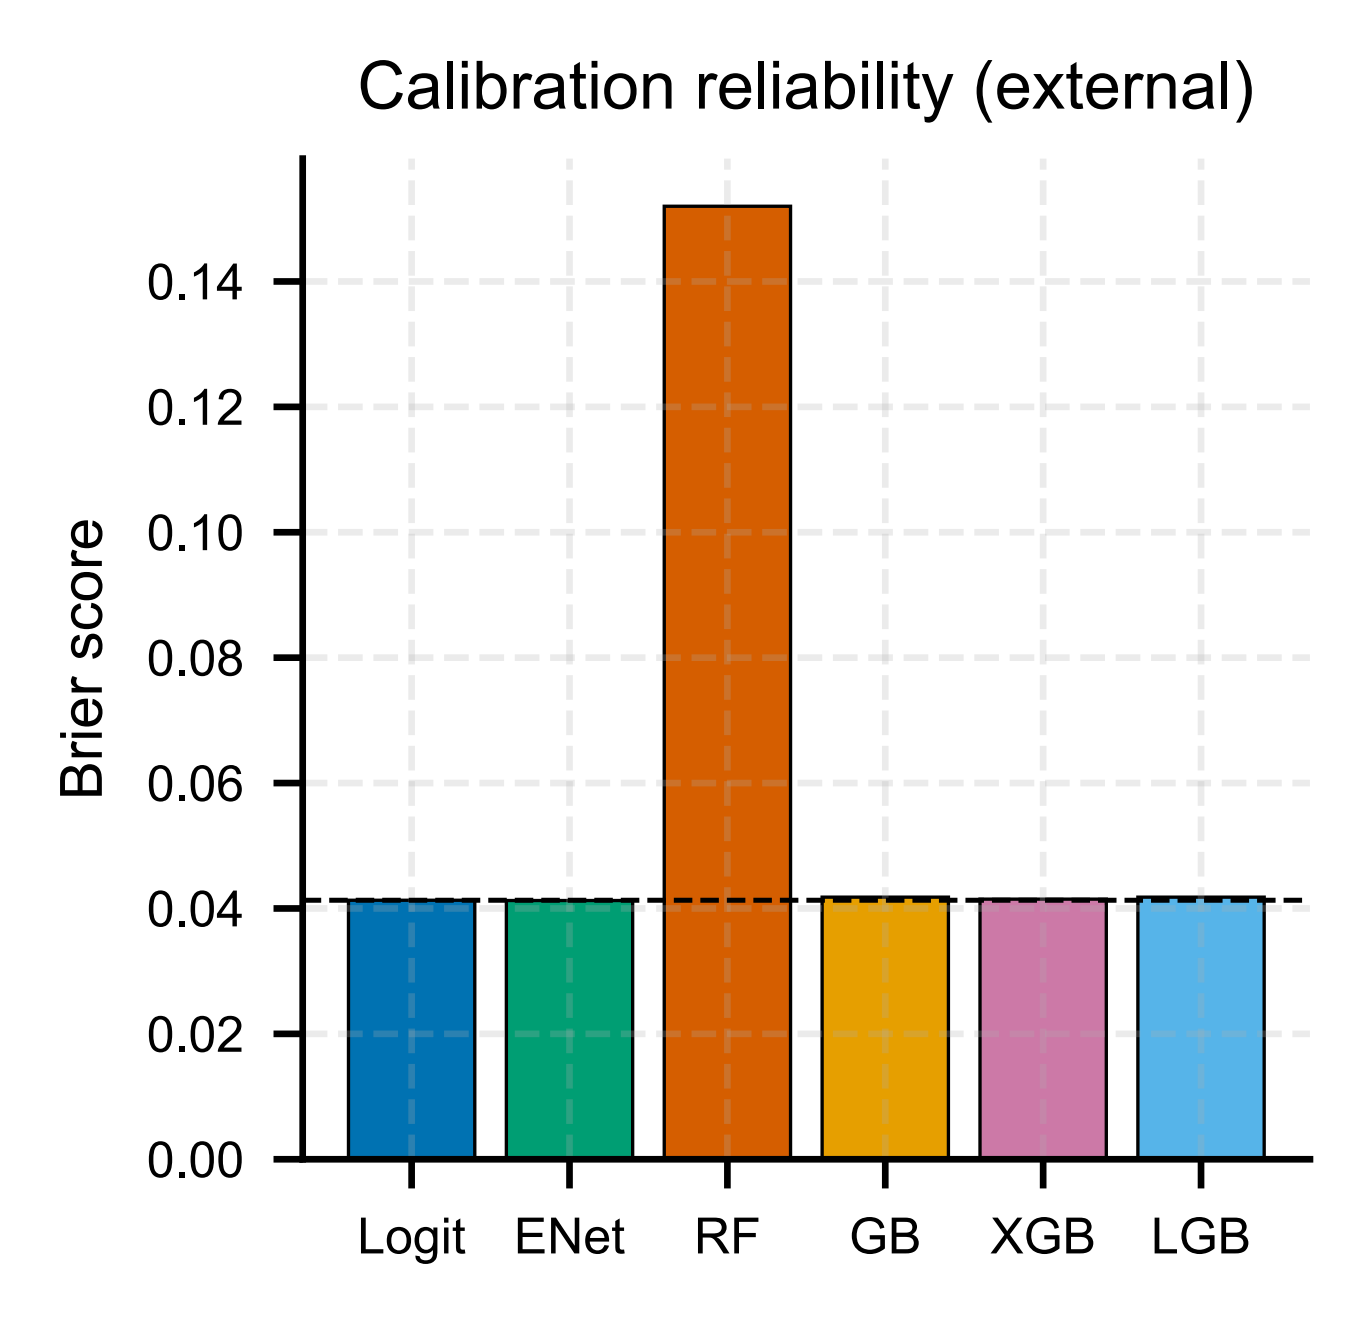
Calibration reliability (external)
Brier score
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Logit
ENet
RF
GB
XGB
LGB