

HOCHSCHULE LUZERN - TECHNIK & ARCHITEKTUR

MESSTECHNIK UND SENSORIK

**Labor:
Potentiometrischer &
Kapazitiver Sensor**

*Pascal Häfliger
Andreas Caduff*

28. Oktober 2016

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Messaufbau	2
2.1	Elektrisches Ersatzschaltbild	2
3	Potentiometer	3
3.1	Hysteresis und Nichtlinearität	3
3.2	Berechnungen	3
4	Kapazitiver Sensor	4
4.1	Linearisierung	4
4.2	Hysteresis und Nichtlinearität	4
4.3	Berechnungen	5
5	Ergebnisse	6
5.1	Gaussische Fehlerfortpflanzung	6
5.2	Dielektrikum	6
6	Diskussion	7

1 Einleitung

In diesem Labor wurden Sensordaten von einem Potentiometrischen- und Kapazitiven- Sensor Ausgewertet und mit den Sensor-Spezifikationen verglichen.
Für die Auswertung wurde der Datensatz C verwendet.

2 Messaufbau

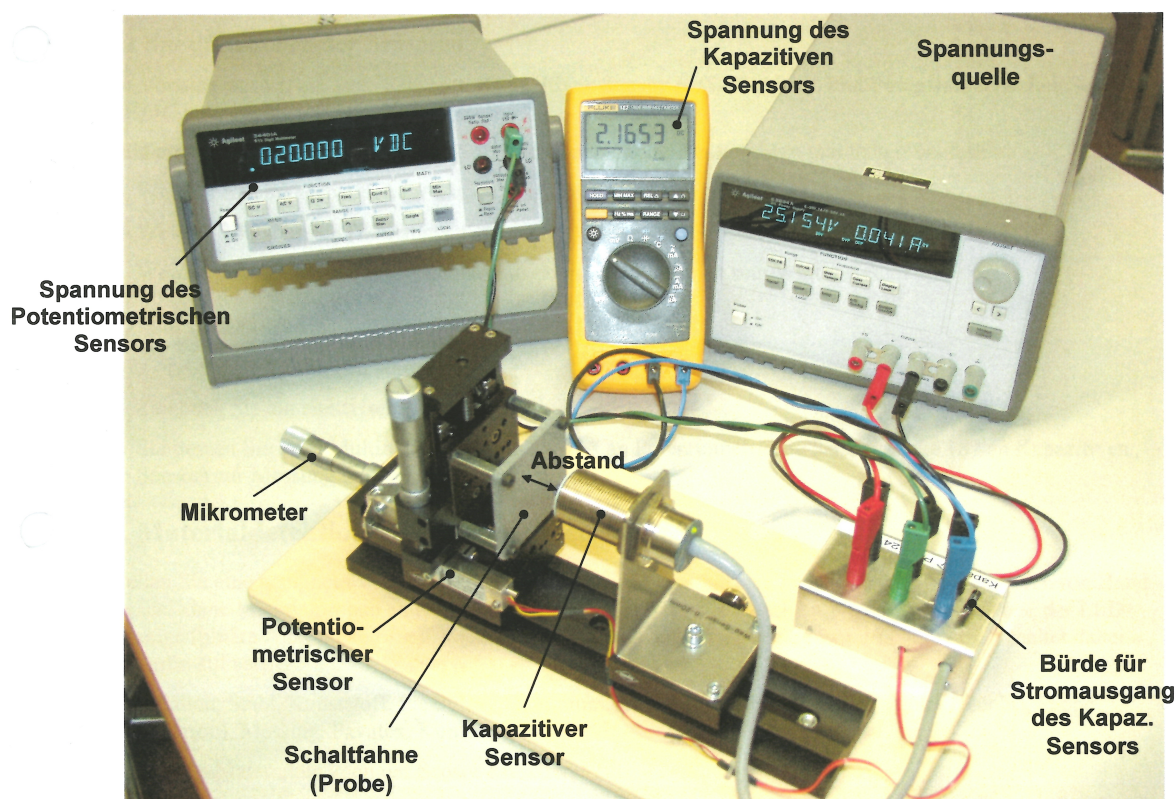


Abbildung 2: Messaufbau

Folgende Messgeräte wurden verwendet:

Hersteller	Typ	Verwendung
Agilent	E3634A Power Supply	Speisung Spannungsteiler
Agilent	34401A Multimeter	Spannung Potentiometer
Fluke	187 TRMS multimeter	Spannung kapazitiver Sensor
Rechner	KAS-80-A14-IL	kapazitiver Sensor
-	HP15C	Potentiometrischer Sensor

2.1 Elektrisches Ersatzschaltbild

Ist das Messgerät genug hoch- Ω oder wird der Spannungsteiler belastet?

3 Potentiometer

3.1 Hysterese und Nichtlinearität

Dieses Diagramm zeigt die Hysterese und die Nicht-linearität des Potentiometers im Bereich von 0 bis 20mm mit einer Schrittweite von 0.5mm.

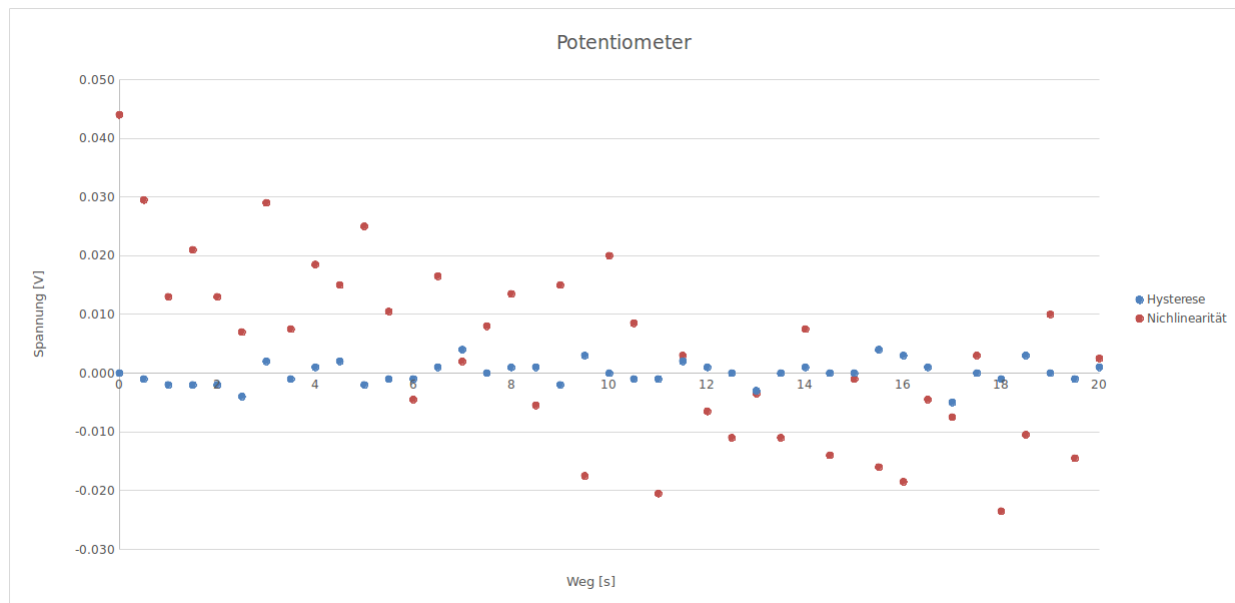


Abbildung 3: Potentiometrischer Sensor

Eine Hysterese ist nicht erkennbar aus der Grafik. Die Abweichung gegenüber zur Nominalspannung liegt innerhalb 5mV. Die entspricht $\frac{5mV}{20V} = 0.25\%$

Der Spannungsteiler wird von Potentiometer nicht signifikant belastet. Aus diesem Grund ist die Nicht-linearität sehr schwach ausgefallen.

3.2 Berechnungen

$$\begin{aligned} \text{Max. Nicht-linearität: } \varepsilon_L &= \frac{|max(\epsilon_L)|}{|Messbereich|} = \frac{|45mV|}{|20V|} = 0.225\% \\ \text{Max. Hysterese: } \varepsilon_H &= \frac{|max(\epsilon_H)|}{|Messbereich|} = \frac{|5mV|}{|20V|} = 0.025\% \end{aligned}$$

4 Kapazitiver Sensor

Der Kapazitive Sensor gibt einen Strom, in Abhängigkeit der Distanz zum Objekt, aus. Dieser Strom generiert einen Spannungsabfall über einen „Bürde-Widerstand“ von 100 Ohm.

4.1 Linearisierung

Dieses Diagramm zeigt den Mittelwert und die Linearisierung des Kapazitiven Sensors im Bereich von 0 bis 16mm mit einer Schrittweite von 0.5mm.

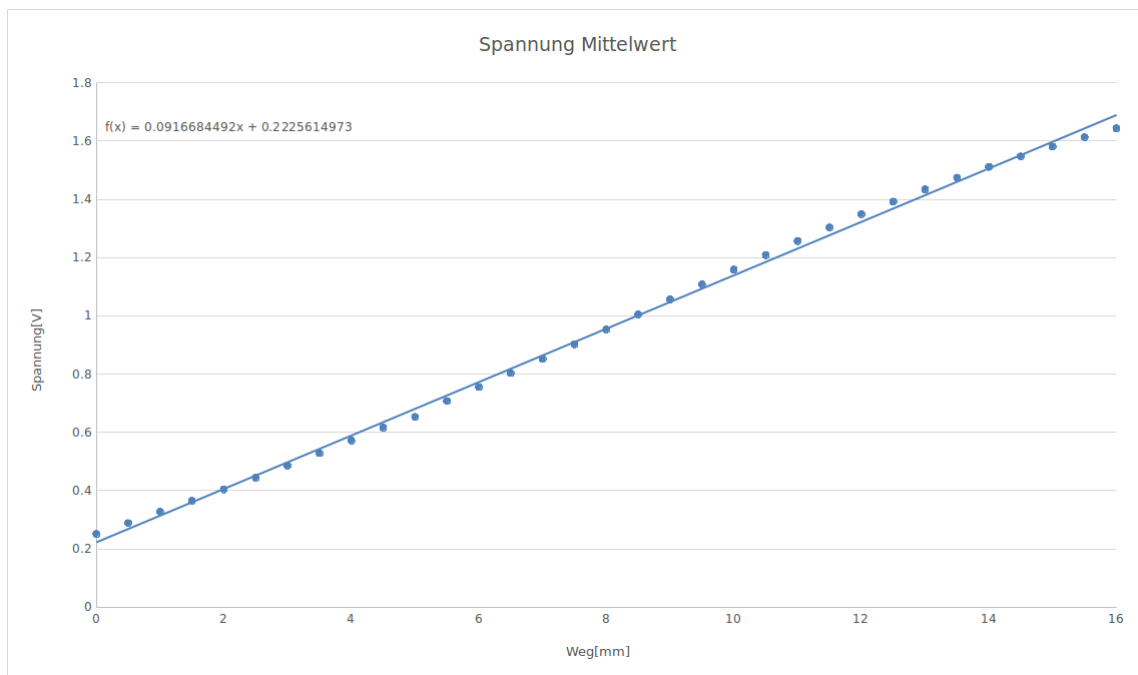


Abbildung 4: Kapazitiven Sensor

Die Linearisierung wurde anhand der Methode der kleinsten Quadrate vorgenommen. Die Geradengleichung der Linearisierung entspricht: $y = 0.0917x + 0.2228$

Diese Gleichung dient zur Rekonstruktion, damit die Spannung des Sensors in eine Distanz umgerechnet werden kann.

4.2 Hysterese und Nichtlinearität

Diese zwei Diagramme zeigen die Hysterese und die Nichtlinearität des Kapazitiven Sensors im Bereich von 0 bis 16mm mit einer Schrittweite von 0.5mm.

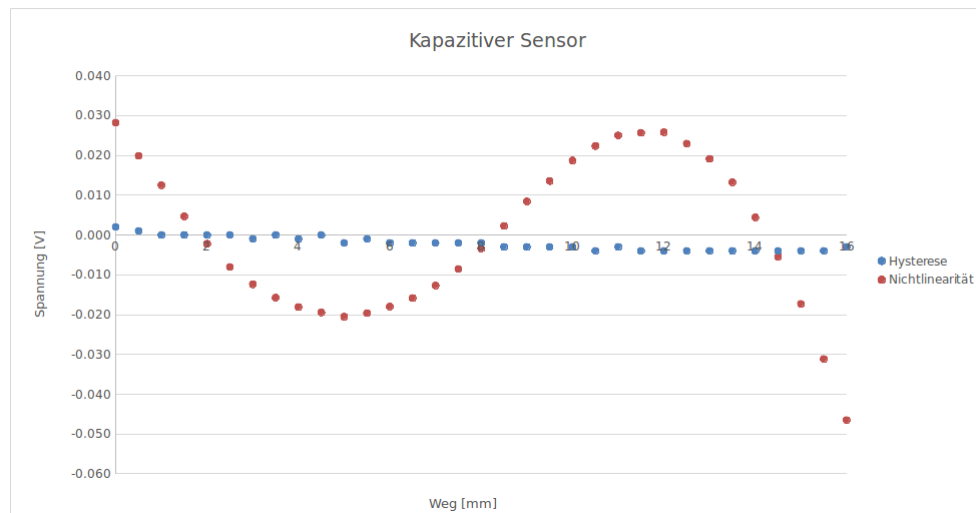


Abbildung 5: Kapazitiver Sensor

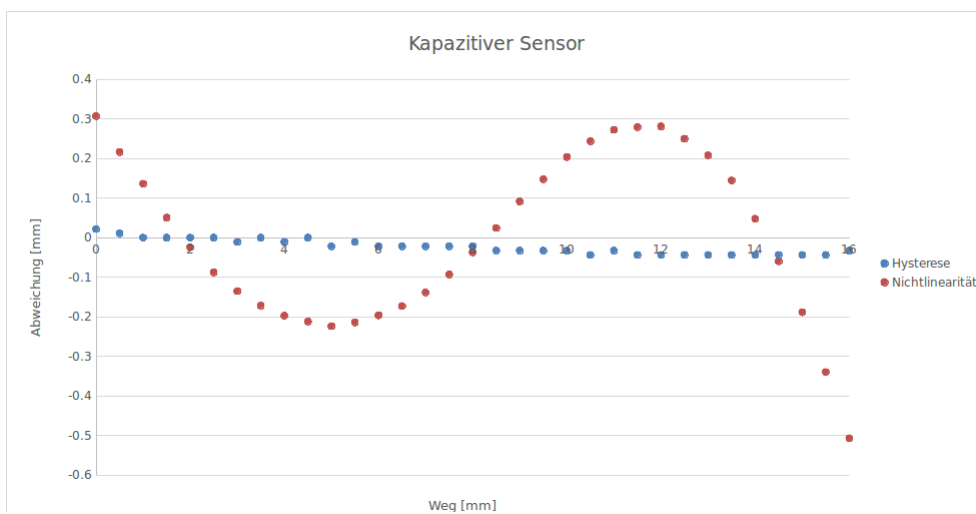


Abbildung 6: Kapazitiver Sensor

Die Abweichung in mm ist proportional zur Spannungsabweichung um den Faktor: $\frac{1}{0.0917} \approx 10$.

4.3 Berechnungen

$$\begin{aligned} \text{Max. Nicht-linearität: } \varepsilon_L &= \frac{|\max(\epsilon_L)|}{|\text{Messbereich}|} = \frac{|0.5\text{mm}|}{|16\text{mm}|} = 3.2\% \\ \text{Max. Hysterese: } \varepsilon_H &= \frac{|\max(\epsilon_H)|}{|\text{Messbereich}|} = \frac{|0.45\text{mm}|}{|16\text{mm}|} = 0.27\% \end{aligned}$$

5 Ergebnisse

	Potentiometer	Kapazitiver Sensor
Messbereich [mm]	0mm - 20mm	0mm - 16mm
max. Nichtlinearität [%]	± 0.22 %	± 3.2 %
max. Hysterese [%]	± 0.025 %	± 0.27 %
Rel. Genauigkeit [%]	± 0.22 %	± 3.2 %

5.1 Gaussische Fehlerfortpflanzung

$$Genauigkeit = \sqrt{(Nichtlinearität)^2 + (Hysterese)^2}$$

5.2 Dielektrikum

Material	Reduktionsfaktor
FE360	1
ST37	1
Wasser	1
Weizen	0.8
Holz	0.7
Glas	0.6
Öl	0.4
PVC	0.4
PVC	0.4
PE	0.37
Keramik	0.3

6 Diskussion

- Die Lineasierung für die Rekonstruktion wurde nur bis 16mm vorgenommen. Falls der Bereich überschritten wird, steigt der Fehler sehr stark an.
.
- Es wurde die Hystere sowie Nicht-linearität für beide Sensoren vorgenommen. Jedoch liegt weiterhin eine Exemplarstreuung der Typen vor. Die Messdaten gelten nicht für alle Sensoren des selben Types.
-