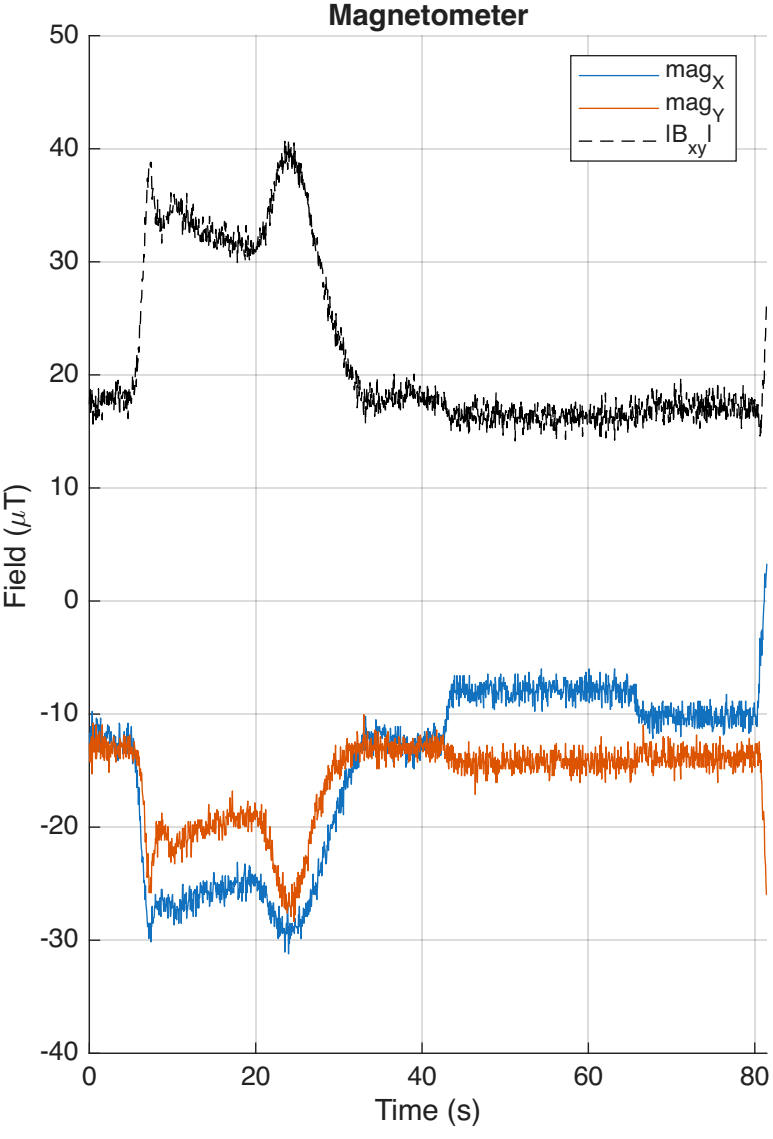
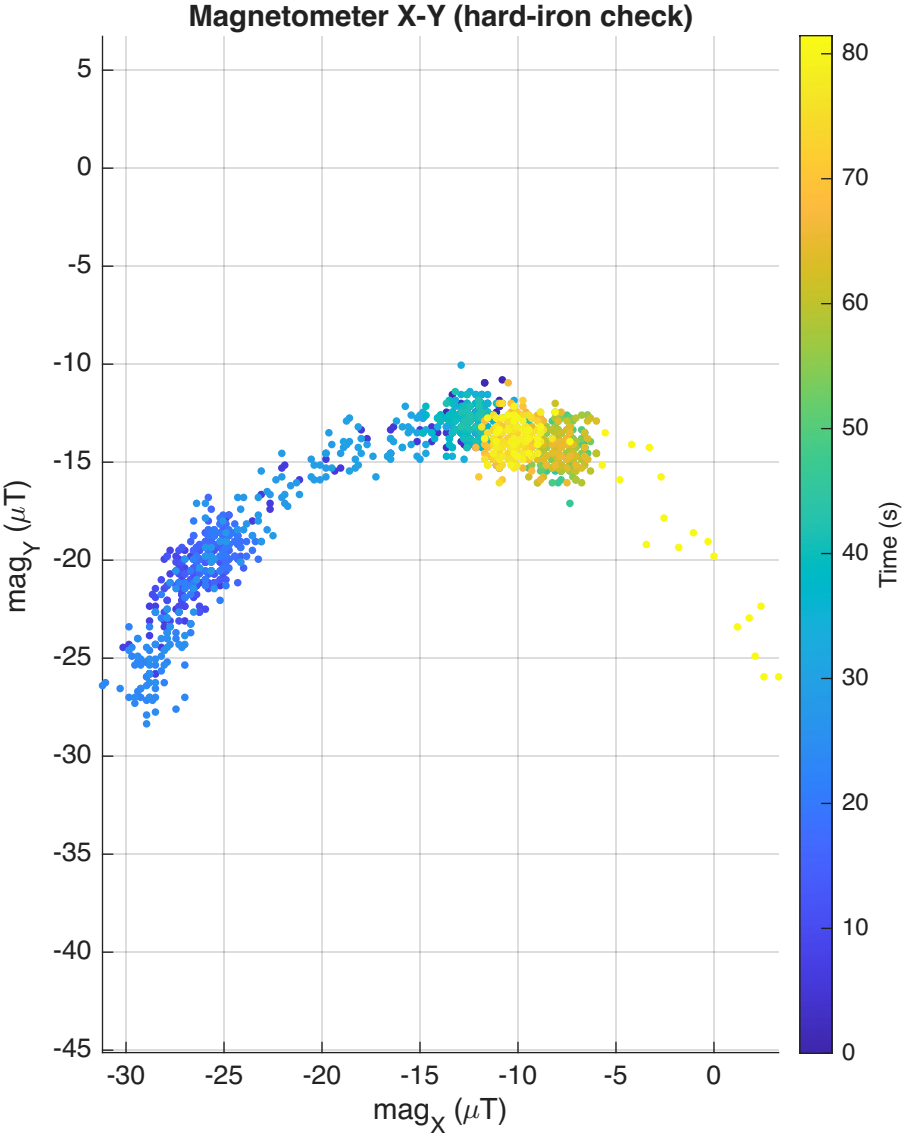

Magnetometer
magX
magY
|Bxy|
Field (μT)
Time (s)
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
0
20
40
60
80


Magnetometer X-Y (hard-iron check)
magY (μT)
magX (μT)
Time (s)
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
80
70
60
50
40
30
20
10
0