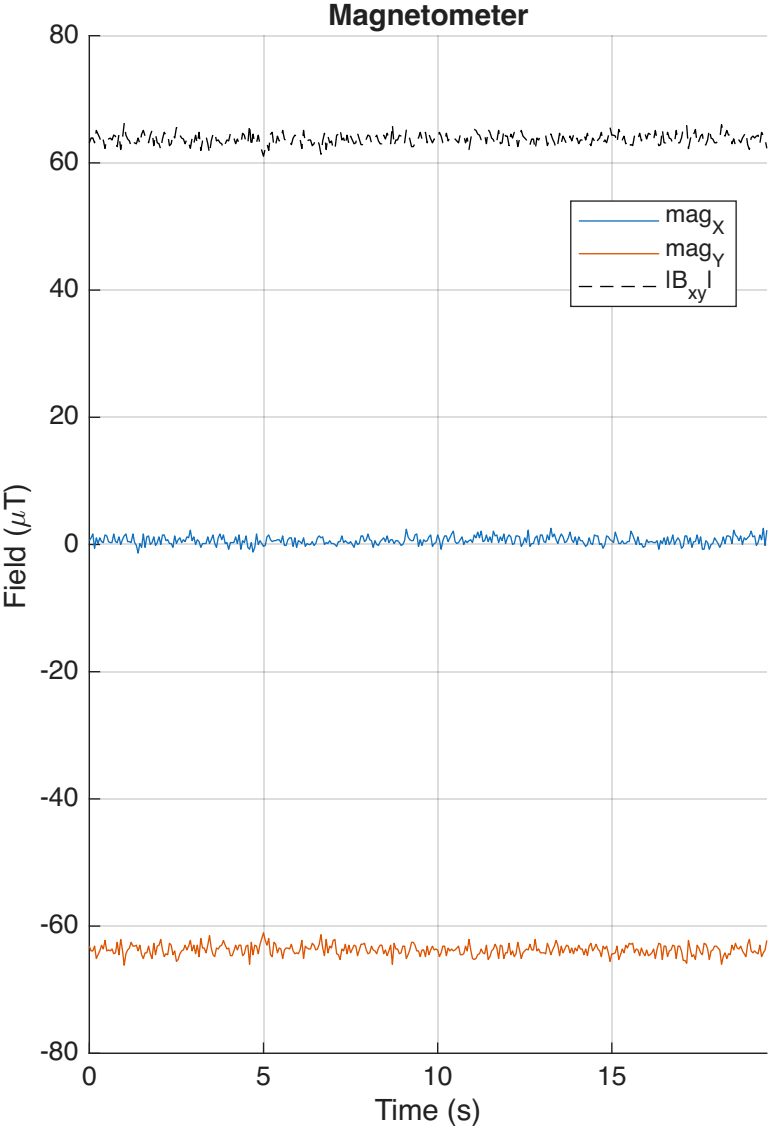
Magnetometer
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Field (μT)
0
5
10
15
Time (s)
mag_X
mag_Y
|B_xy|

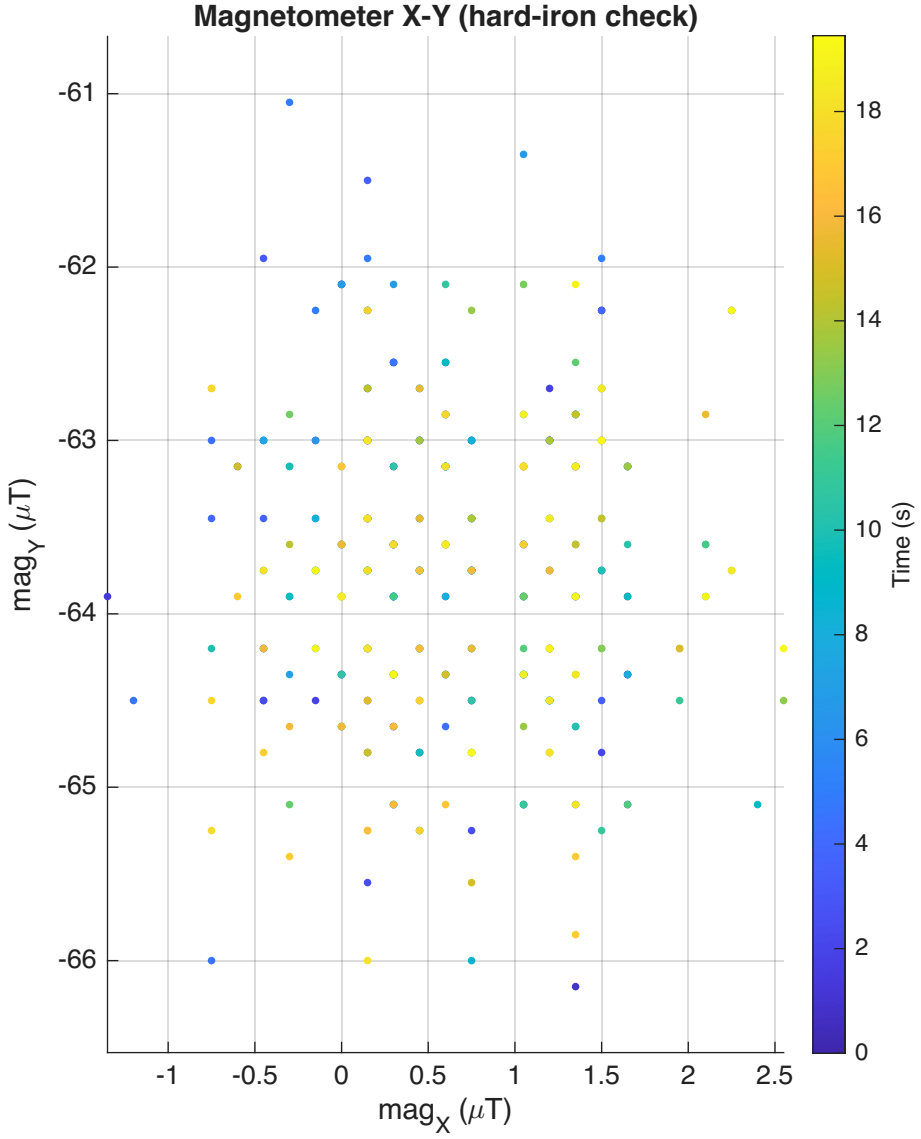
Magnetometer X-Y (hard-iron check)
-61
-62
-63
-64
-65
-66
mag_Y (μT)
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
mag_X (μT)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Time (s)