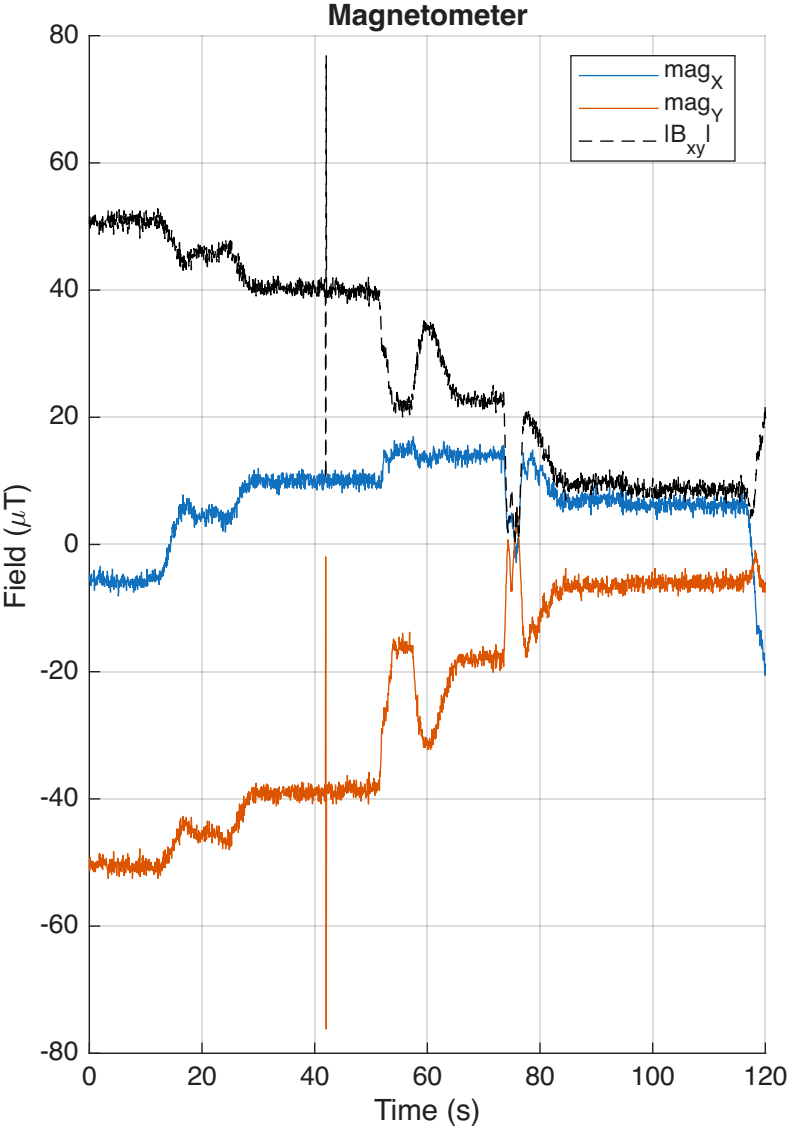
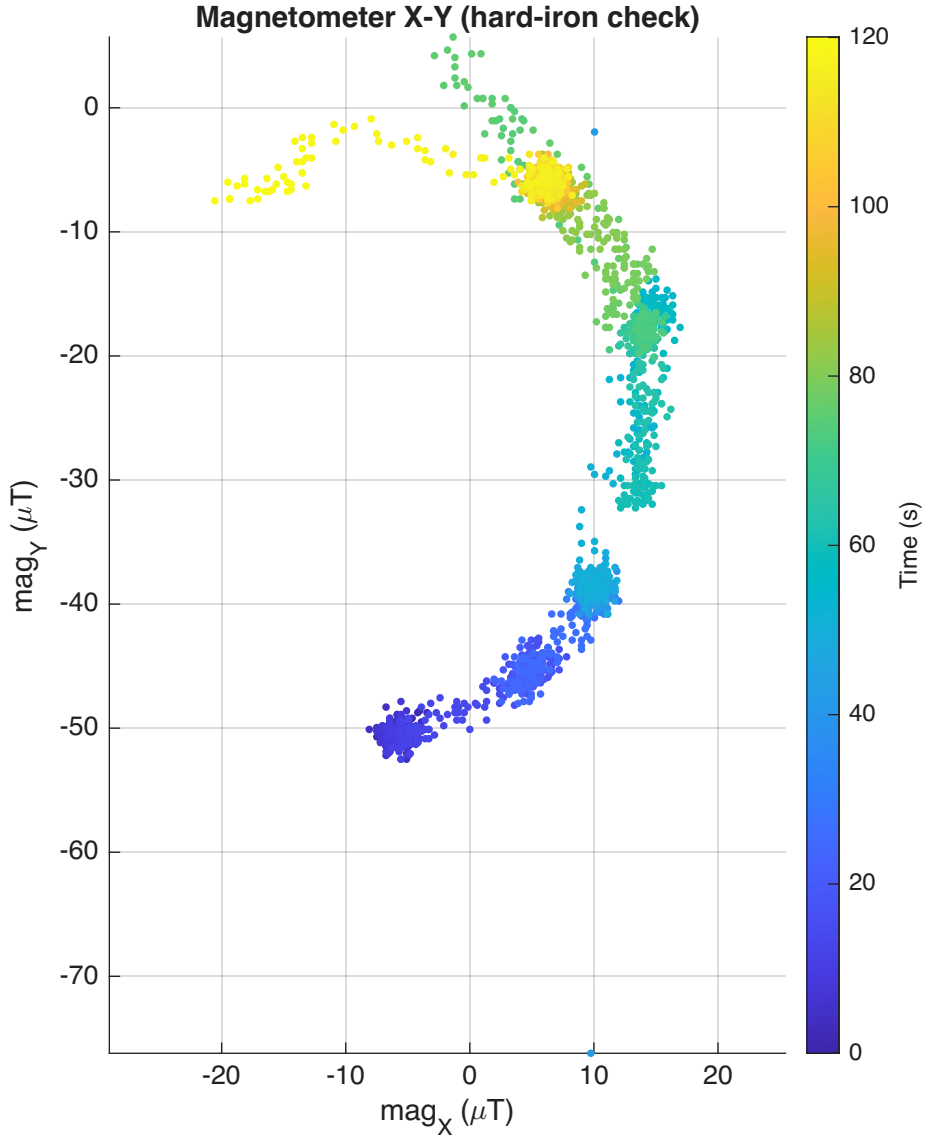

Magnetometer
magX
magY
|Bxy|
Field (μT)
Time (s)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
0
20
40
60
80
100
120


Magnetometer X-Y (hard-iron check)
magY (μT)
magX (μT)
Time (s)
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-20
-10
0
10
20
120
100
80
60
40
20
0