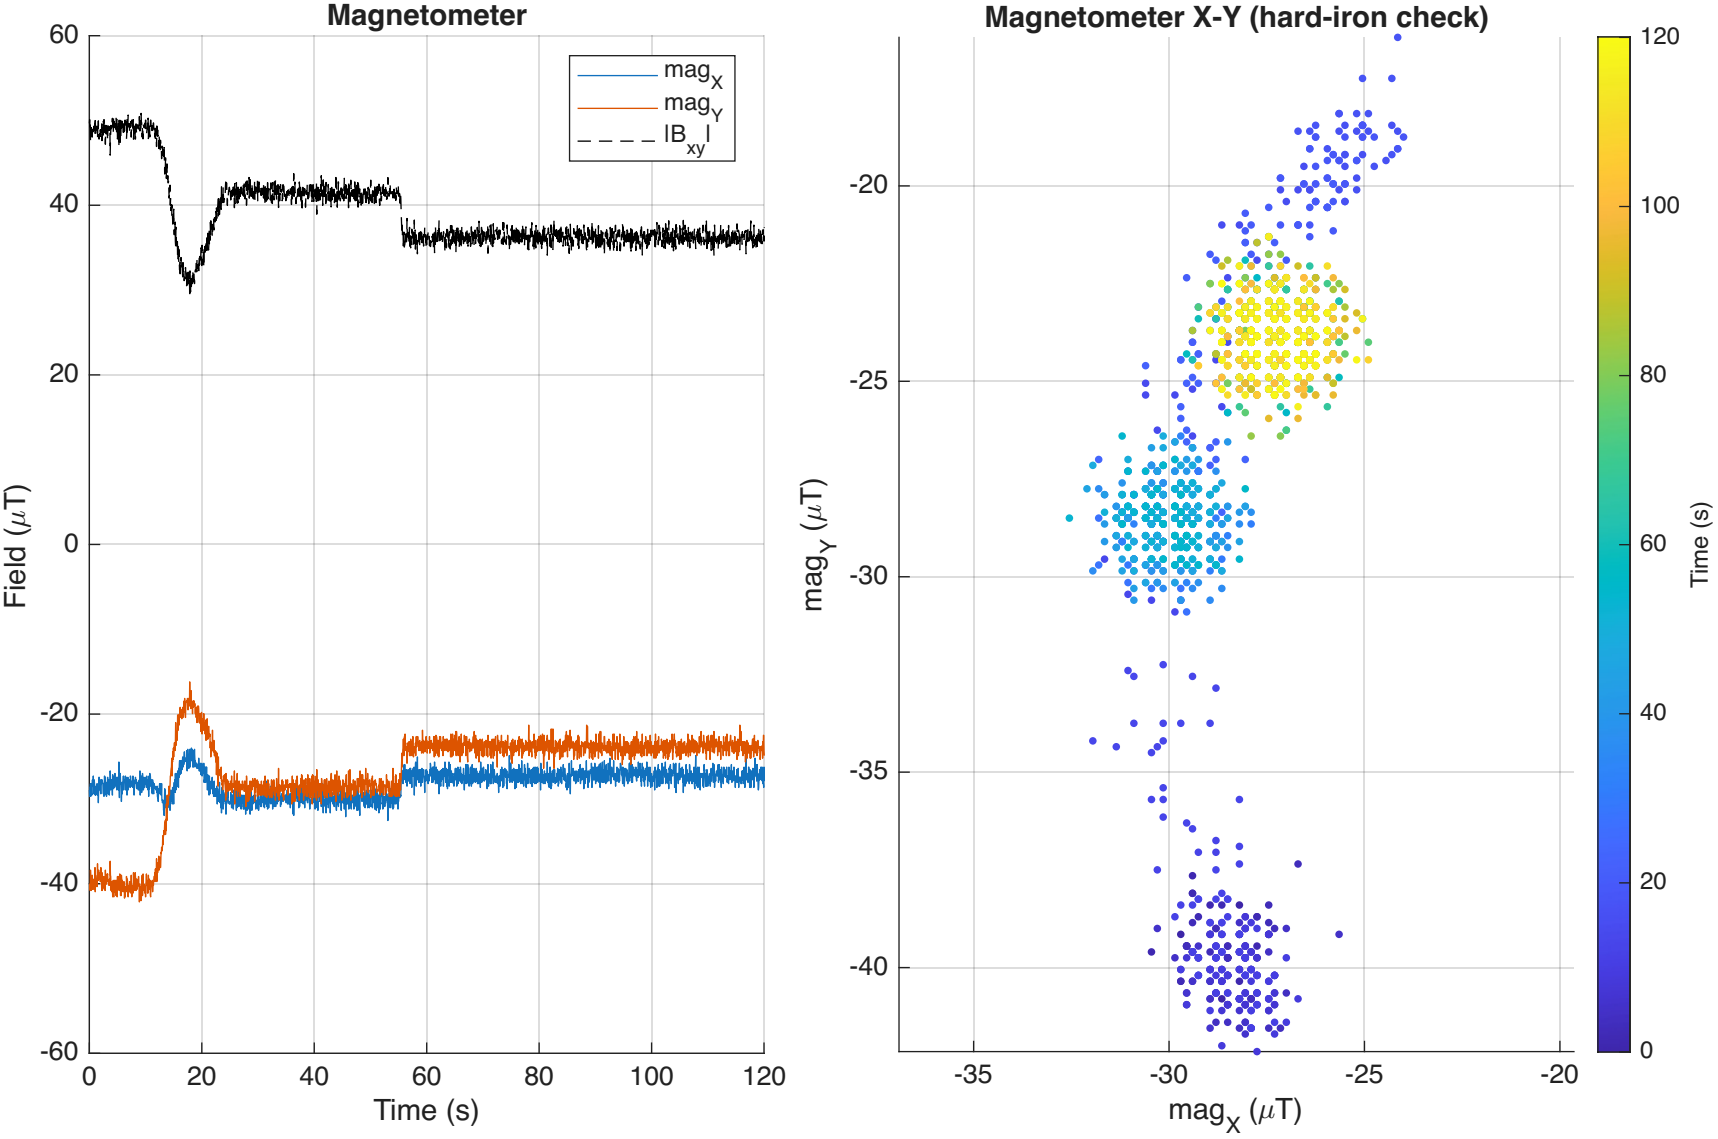

Magnetometer
mag_X
mag_Y
|B_xy|
Field (μT)
Time (s)
60
40
20
0
-20
-40
-60
0
20
40
60
80
100
120
Magnetometer X-Y (hard-iron check)
mag_Y (μT)
mag_X (μT)
-20
-25
-30
-35
-40
-35
-30
-25
-20
Time (s)
120
100
80
60
40
20
0