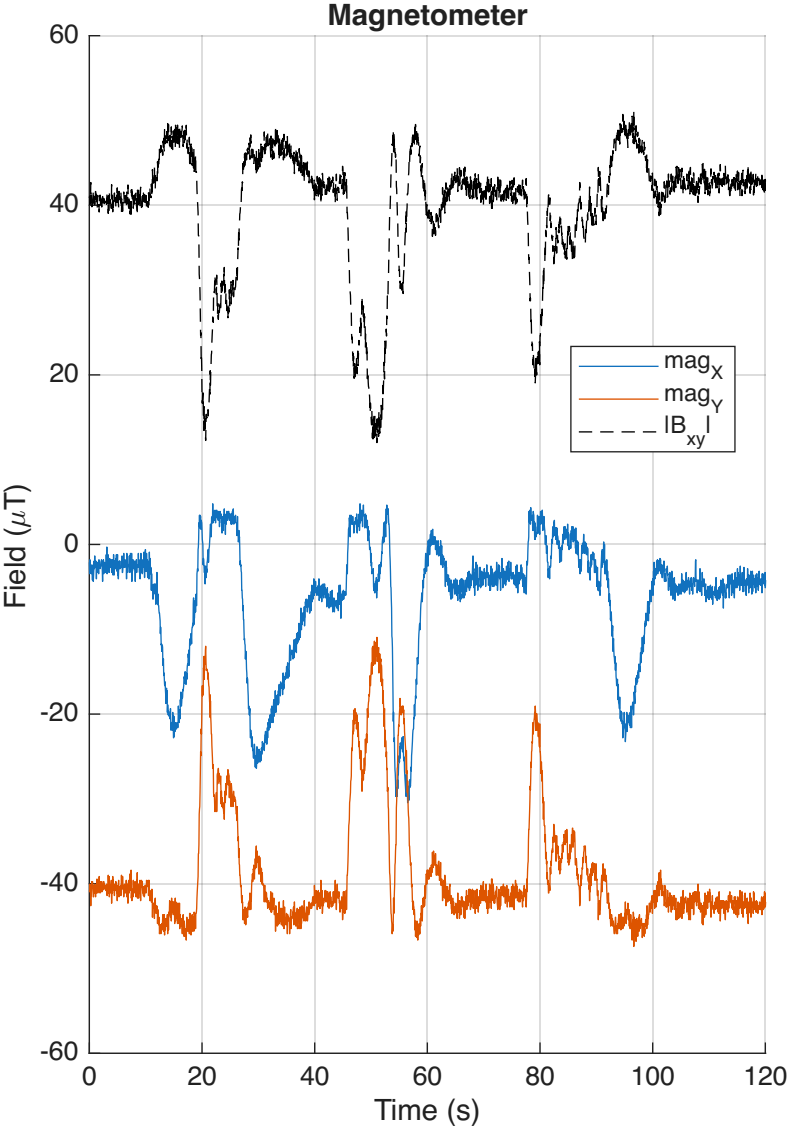
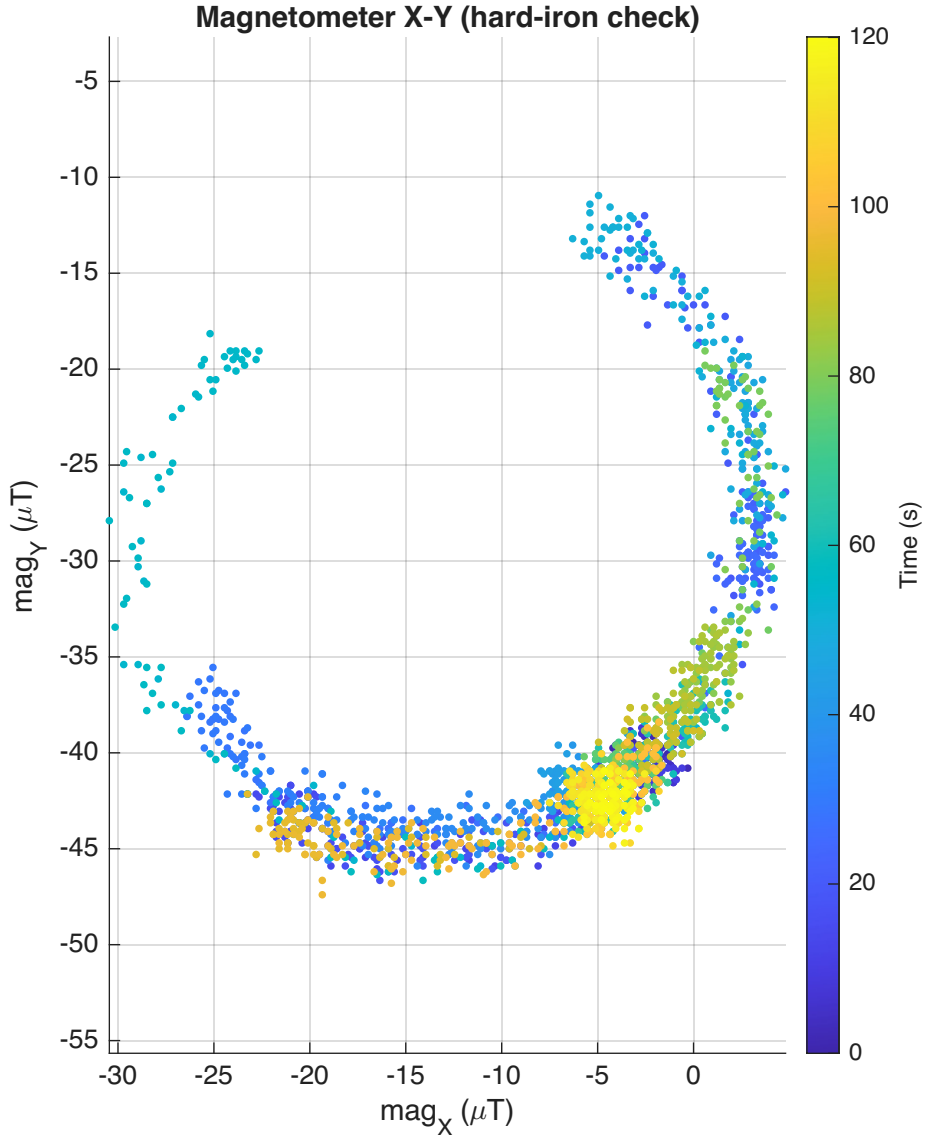

Magnetometer
Field (μT)
Time (s)
magX
magY
|Bxy|
60
40
20
0
-20
-40
-60
0
20
40
60
80
100
120


Magnetometer X-Y (hard-iron check)
magY (μT)
magX (μT)
Time (s)
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
120
100
80
60
40
20
0