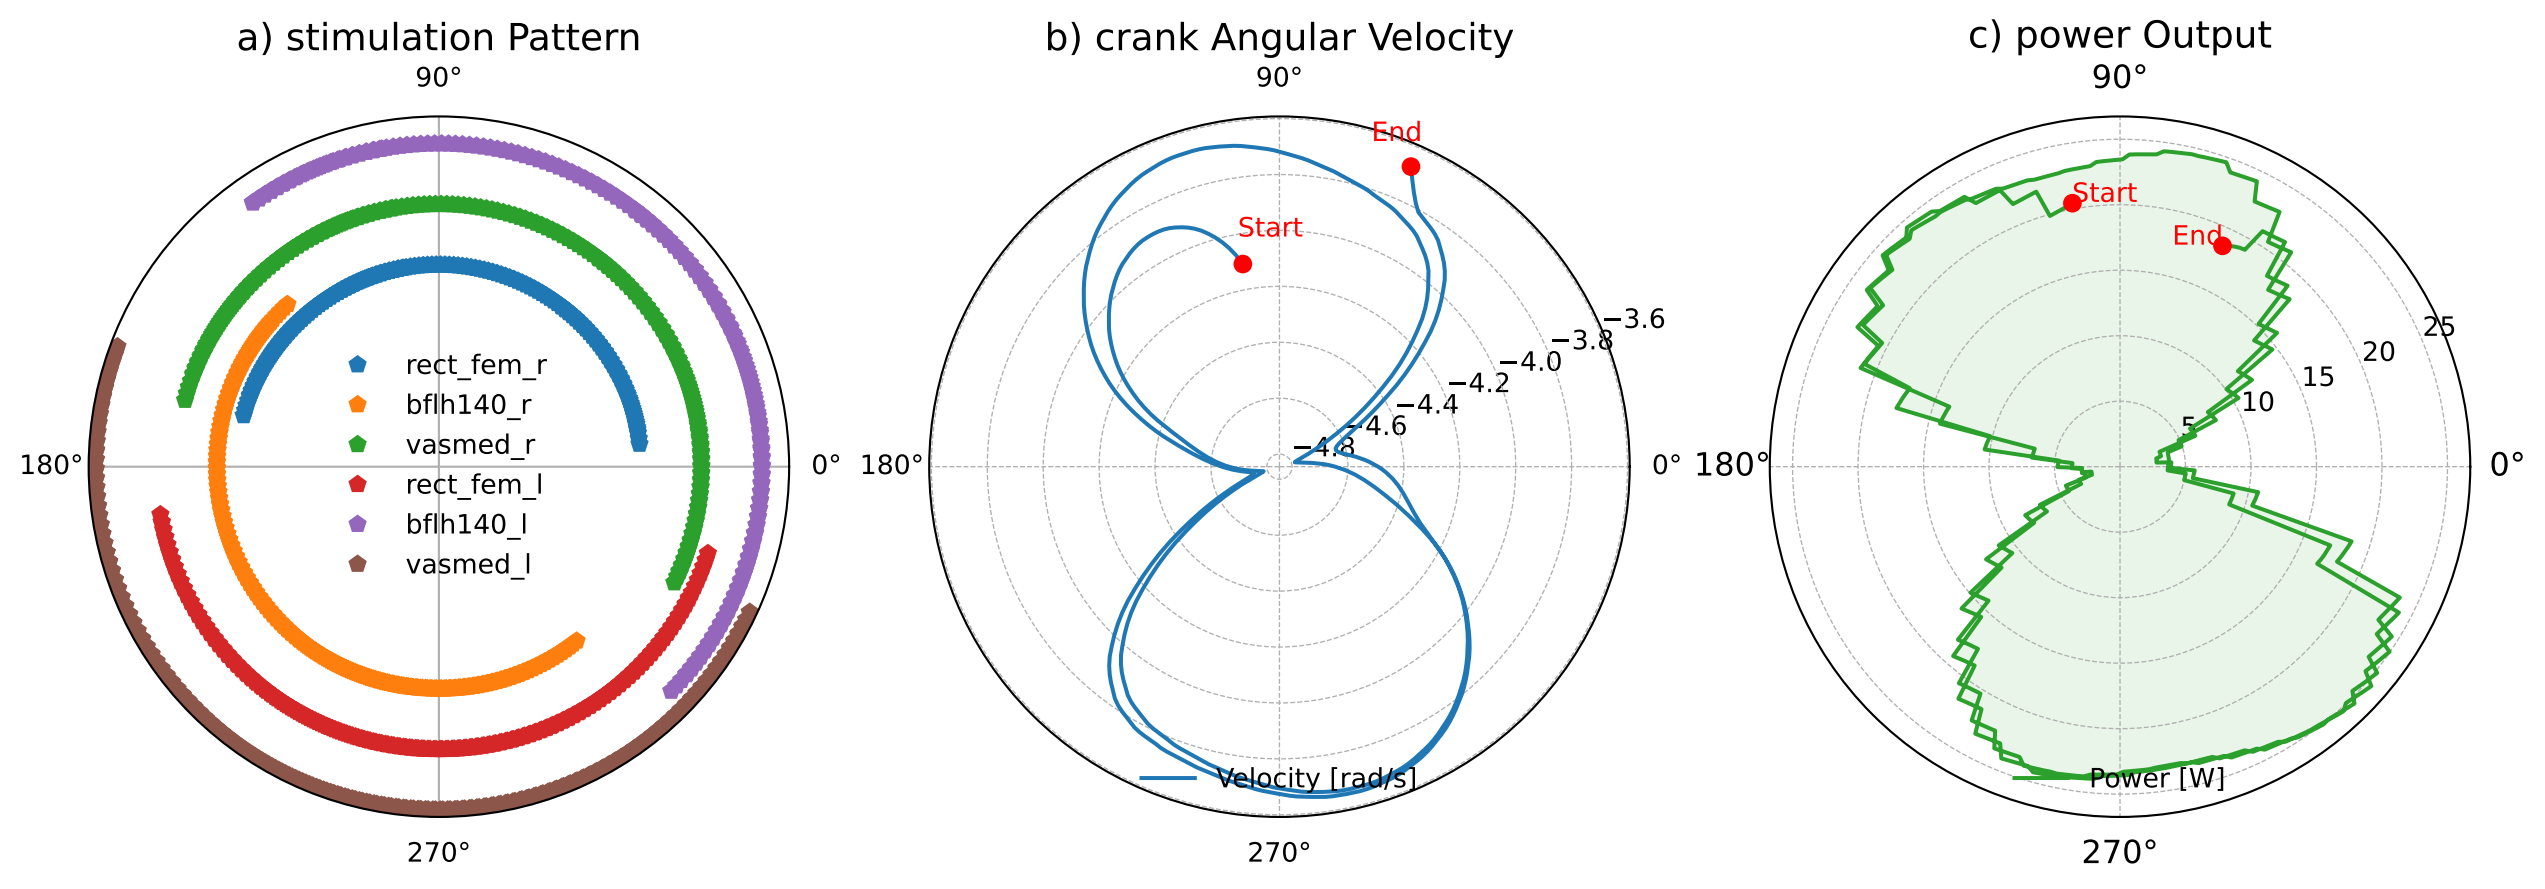

a) stimulation Pattern
90°
180°
0°
270°
rect_fem_r
bflh140_r
vasmed_r
rect_fem_l
bflh140_l
vasmed_l
b) crank Angular Velocity
90°
180°
0°
270°
End
Start
−3.6
−3.8
−4.0
−4.2
−4.4
−4.6
−4.8
Velocity [rad/s]
c) power Output
90°
180°
0°
270°
Start
End
5
10
15
20
25
Power [W]