
Lehrstuhl für Maschinenelemente
Technische Universität München
Boltzmannstr. 15, 85748 Garching


Auftraggeber:	Lw	Druckdatum	27.05.2026 10:47:20
Prüfer:	Bd	Flanke/Seite:	li
MeE-Nr.:	97364	Bemerkung:	neu
Prüfteil/Zustand:	KST_E		

Name	Einheit	Wert
Xq-Rmax	µm	19,322
Xq-Rz	µm	8,980
Xq-Ra	µm	1,603

Messung-1

Ra	1,532 µm	Rsk	-1,4359	Wt	6,785 µm	Rvk	5,690 µm
Rz	8,235 µm	Rt	13,278 µm	RΔq	0,2867	A1	56,58353 µm²/mm
Rmax	12,299 µm	Rp	2,237 µm	Rk	1,497 µm	A2	831,96190 µm²/mm
Rq	1,991 µm	RzISO	13,278 µm	Rpk	0,701 µm		

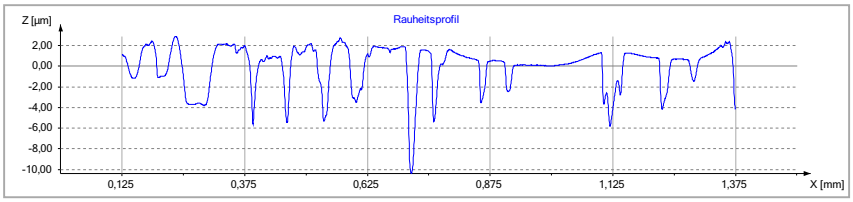


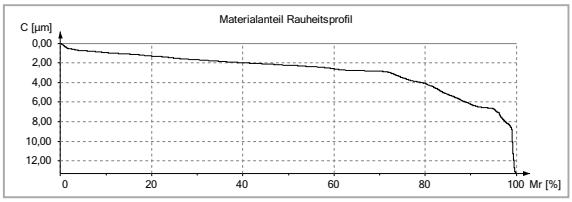


Auswertebedingungen		Form entfernen:	EIN	lp:	1,500 mm	Taststrecke:	1,50 mm	Messrichtung:	Von links	Tastspitzenra…	0,002 mm
λs:	2,50 µm (Auto)	Filter ISO 4287:	ISO 16610-21	lr:	0,250 mm	Geschwindigk…	0,50 mm/s	Messpunkte:	2978	Tastertyp:	TKU300
λc:	0,25 mm	Filter ISO 135…	ISO 13565-1	lw:	0,250 mm	Messbereich:	400 µm	Punktabstand:	0,5 µm	Zusätzliche Parameter	
λf:	AUS	Ausrichtung:	EIN	Messung-1							

Messung-2

Ra	1,417 µm	Rsk	-0,9059	Wt	13,103 µm	Rvk	9,393 µm
Rz	7,828 µm	Rt	16,031 µm	RΔq	0,2185	A1	258,09945 µm²/mm
Rmax	16,031 µm	Rp	2,441 µm	Rk	0,577 µm	A2	908,96006 µm²/mm
Rq	1,899 µm	RzISO	16,031 µm	Rpk	1,815 µm		

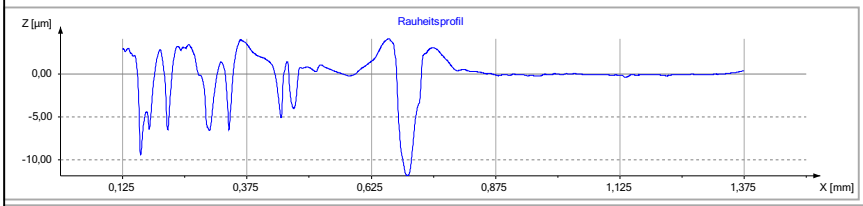


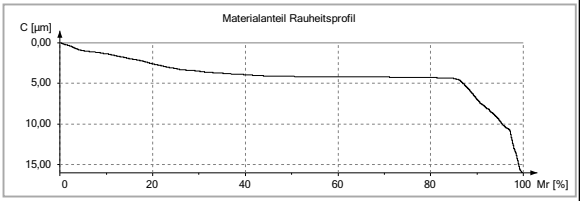


Auswertebedingungen		Form entfernen:	EIN	lp:	1,500 mm	Taststrecke:	1,50 mm	Messrichtung:	Von links	Tastspitzenra…	0,002 mm
λs:	2,50 µm (Auto)	Filter ISO 4287:	ISO 16610-21	lr:	0,250 mm	Geschwindigk…	0,50 mm/s	Messpunkte:	2978	Tastertyp:	TKU300
λc:	0,25 mm	Filter ISO 135…	ISO 13565-1	lw:	0,250 mm	Messbereich:	400 µm	Punktabstand:	0,5 µm	Zusätzliche Parameter	
λf:	AUS	Ausrichtung:	EIN	Messung-2							

Messung-3

Ra	1,861 µm	Rsk	-0,5767	Wt	17,916 µm	Rvk	12,610 µm
Rz	10,878 µm	Rt	29,636 µm	RΔq	0,2308	A1	433,43161 µm²/mm
Rmax	29,636 µm	Rp	4,239 µm	Rk	2,091 µm	A2	1014,72842 µm²/mm
Rq	2,618 µm	RzISO	29,636 µm	Rpk	5,002 µm		

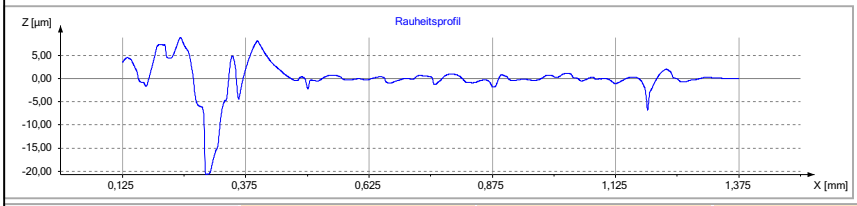

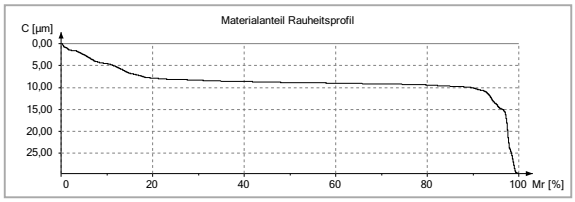

Auswertebedingungen		Form entfernen:	EIN	lp:	1,500 mm	Taststrecke:	1,50 mm	Messrichtung:	Von links	Tastspitzenra…	0,002 mm
λs:	2,50 µm (Auto)	Filter ISO 4287:	ISO 16610-21	lr:	0,250 mm	Geschwindig…	0,50 mm/s	Messpunkte:	2978	Tastertyp:	TKU300
λc:	0,25 mm	Filter ISO 135…	ISO 13565-1	lw:	0,250 mm	Messbereich:	400 µm	Punktabstand:	0,5 µm	Zusätzliche Parameter	
λf:	AUS	Ausrichtung:	EIN	Messung-3							