



Mode Refit Curve

Calib file


iBook\_G4\_HD :Users :paul\_local :Documents :LabVIEW\_data :  
Examples :Calib\_Files :Mano\_Calib.txt

Calib const

A	-0.001677
B	0.247531
Av % err	0.281435

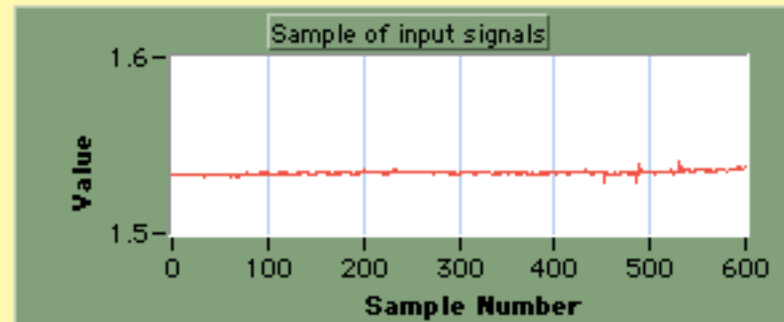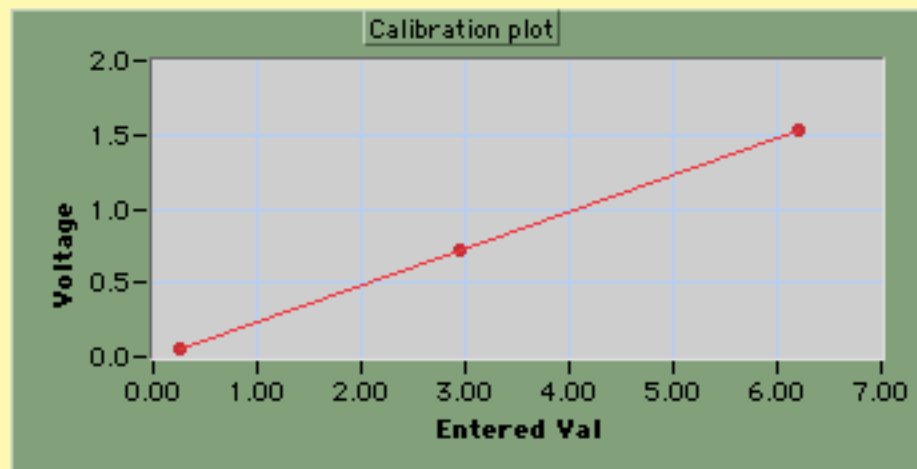

Pressure Trans



Samples /ch

600

Sampling Rate /ch (Hz)

100.00

Voltage

0.062

0.379

0.725

1.534

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Entered Val

0.250

1.540

2.950

6.200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Selector