

Calib
ProgMode **Take a New Calibration Point**

Calib file



iBook_G4_HD :Users :paul_local :Documents :LabVIEW_data :
Examples :Calib_Files :XW_Calib1.txt

Calib const

n1	0.655000
A1	-4.649065
B1	9.310622
Av % err1	0.010088
n2	0.645000
A2	-4.021394
B2	8.847764
Av % err2	0.007406
psi1	33.24690500
psi2	30.96760200

n 0.45

Find best n

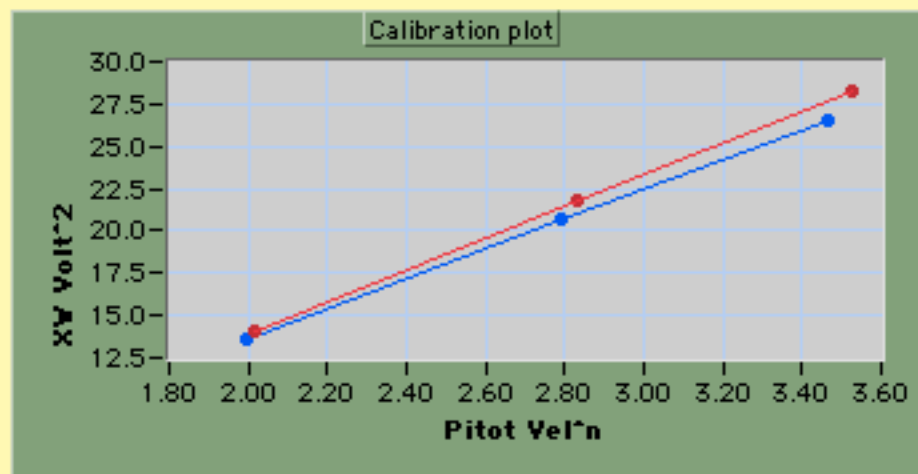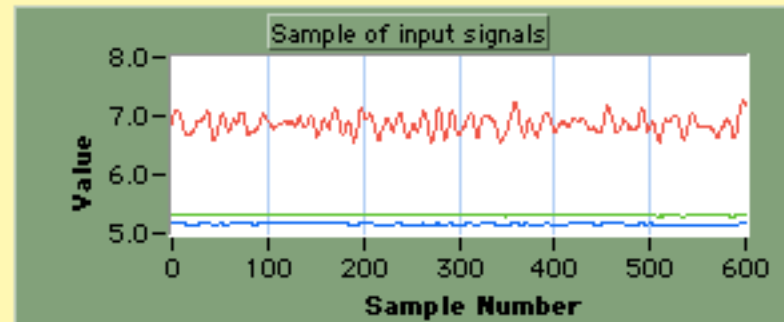

Pitot Vel

XW1 Voltage

XW2 Voltage

Samples /ch

600

Sampling Rate /ch (Hz)

100.00

XW1 Volt

3.761

4.661

5.311

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

XW2 Volt

3.694

4.544

5.158

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pitot Vel

2.921

4.903

6.857

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Selector