

Mode **Take a New Calibration Point**

Calib file



iBook_G4_HD :Users :paul_local :Documents :LabVIEW_data :
Examples :Calib_Files :XW_Calib1.txt

Calib const

n1	0.695000
A1	-3.264205
B1	8.267042
Av % err1	0.130332
n2	0.685000
A2	-2.705104
B2	7.849136
Av % err2	0.132219
psi1	33.24690500
psi2	30.96760200

n 0.45

Find best n

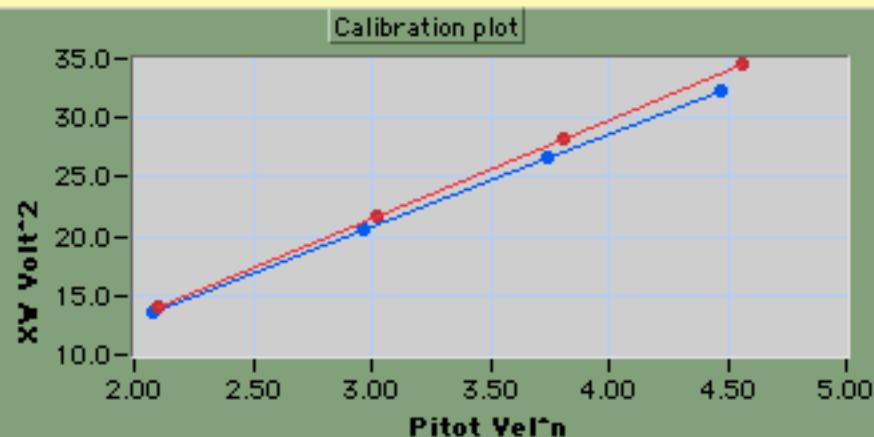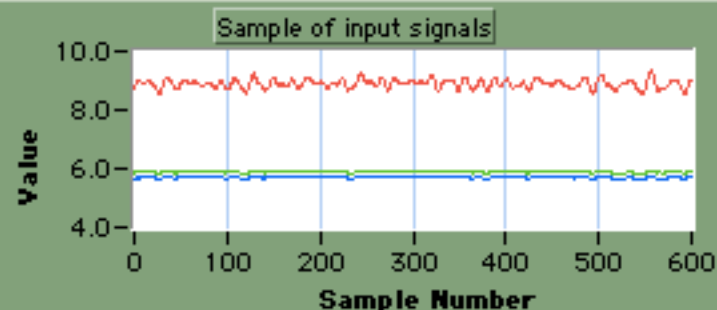

Pitot Vel

XW1 Voltage

XW2 Voltage

Samples /ch

600

Sampling Rate /ch (Hz)

100.00

XW1 Volt

3.761

4.661

5.311

5.873

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

XW2 Volt

3.694

4.544

5.158

5.690

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pitot Vel

2.921

4.903

6.857

8.891

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Selector