

Mode **Take a New Calibration Point**

Calib file



iBook\_G4\_HD :Users :paul\_local :Documents :LabVIEW\_data :  
Examples :Calib\_Files :HotWire\_Calib.txt

Calib const

n	0.925000
A	1.499708
B	4.559079
Av % err	0.000000


n 0.45

Find best n

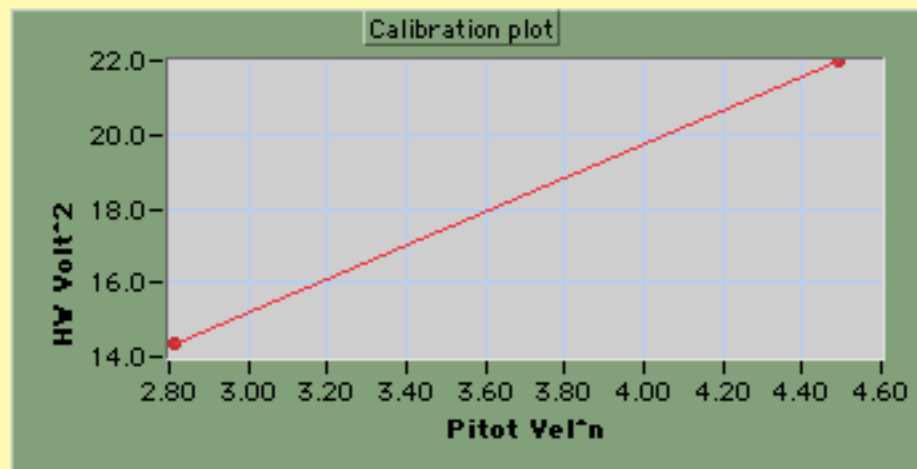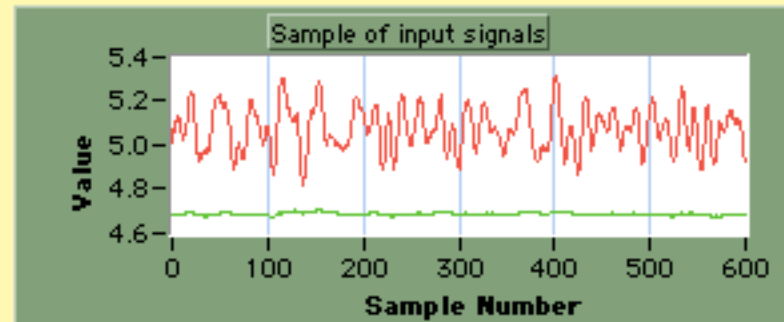

Pitot Vel

HW Voltage



Samples /ch

600

Sampling Rate /ch (Hz)

100.00

HW Volt

3.787

4.688

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pitot Vel

3.063

5.075

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Selector