

Mode Take a New Calibration Point



Calib file



iBook_G4_HD :Users :paul_local :Documents :LabVIEW_data :
Examples :Calib_Files :XW_Calib1.txt

Calib const

n1	0.100000
A1	NaN
B1	NaN
Av % err1	NaN
n2	0.100000
A2	NaN
B2	NaN
Av % err2	NaN
psi1	33.24690500
psi2	30.96760200

n 0.45

Find best n

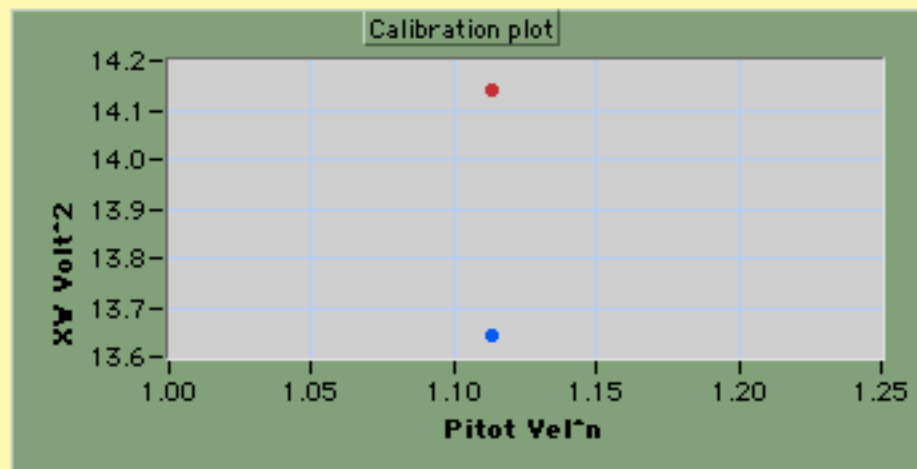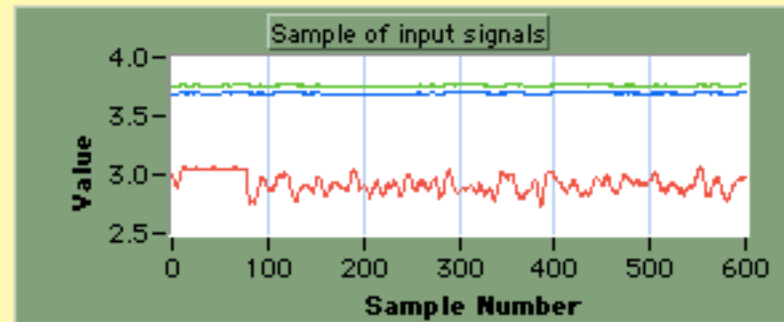

Pitot Vel

XW1 Voltage

XW2 Voltage

Samples /ch

600

Sampling Rate /ch (Hz)

100.00

XW1 Volt

3.761

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

XW2 Volt

3.694

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pitot Vel

2.921

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Selector