



Mode **Show Setup**

Calib file


iBook\_G4\_HD :Users :paul\_local :Documents :LabVIEW\_data :  
Examples :Calib\_Files :HotWire\_Calib.txt

Calib const

A	-0.001800
B	0.247548
Av % err	0.279784

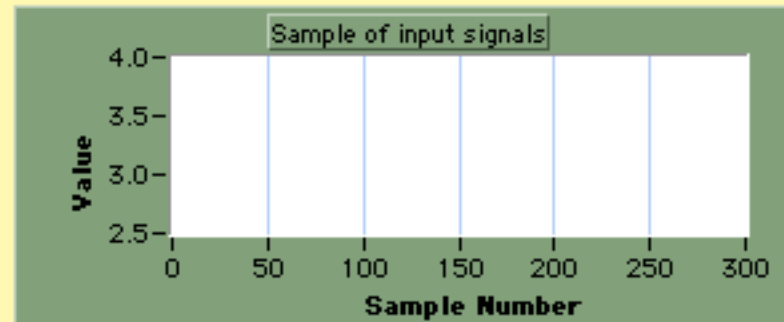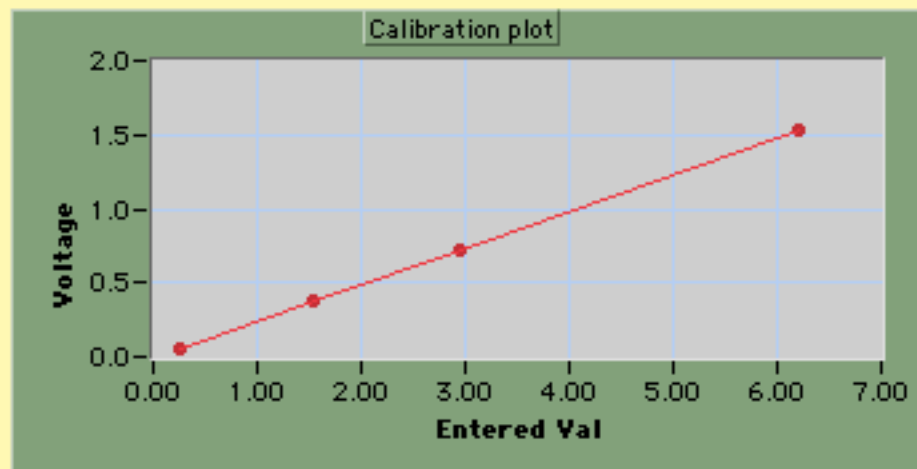

Pressure Trans



Samples /ch

600

Sampling Rate /ch (Hz)

100.00

Voltage

Entered Val

Selector

0.062

0.379

0.725

1.534

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.250

1.540

2.950

6.200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000