



Mode **Refit Curve**

Calib file


iBook_G4_HD :Users :paul_local :Documents :LabVIEW_data :
Examples :Calib_Files :Mano_Calib.txt

Calib const

A	-0.001800
B	0.247548
Av % err	0.279784

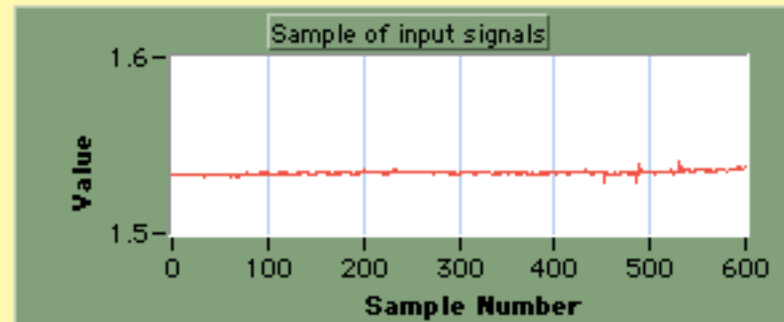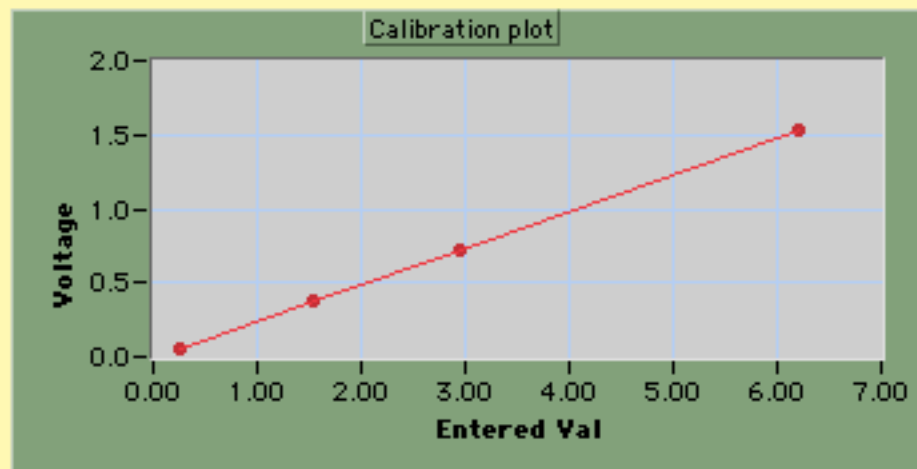

Pressure Trans



Samples /ch

600

Sampling Rate /ch (Hz)

100.00

Voltage

0.062

0.379

0.725

1.534

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Entered Val

0.250

1.540

2.950

6.200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Selector