

Mode **Take a New Calibration Point**

Calib file



iBook_G4_HD :Users :paul_local :Documents :LabVIEW_data :
Examples :Calib_Files :XW_Calib1.txt

Calib const

n1	0.760000
A1	-1.584306
B1	6.962975
Av % err1	0.000000
n2	0.855000
A2	1.071867
B2	5.027771
Av % err2	0.000000
psi1	33.24690500
psi2	30.96760200

n 0.45

Find best n

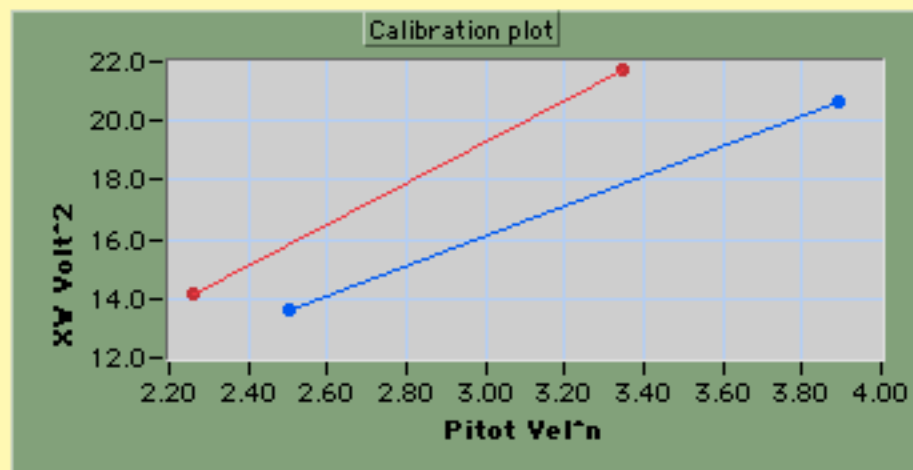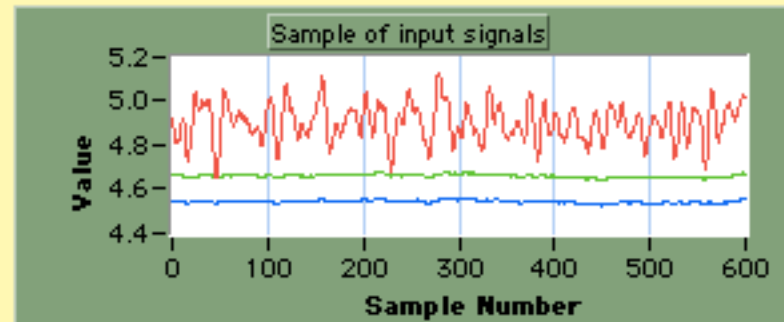

Pitot Vel

XW1 Voltage

XW2 Voltage

Samples /ch

600

Sampling Rate /ch (Hz)

100.00

XW1 Volt

3.761

4.661

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

XW2 Volt

3.694

4.544

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pitot Vel

2.921

4.903

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Selector