

Mode Take a New Calibration Point



Calib file



iBook_G4_HD :Users :paul_local :Documents :LabVIEW_data :
Examples :Calib_Files :HotWire_Calib.txt

Calib const

n	0.635000
A	-5.887349
B	9.936039
Av % err	0.005273


n 0.45

Find best n

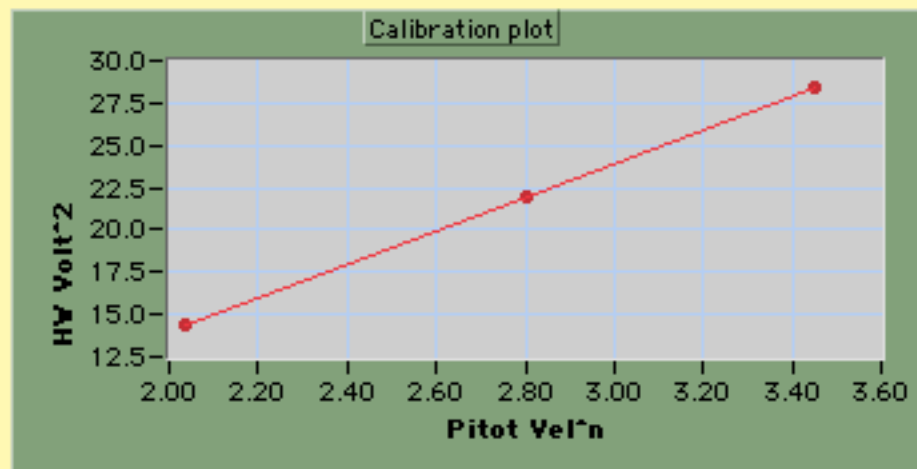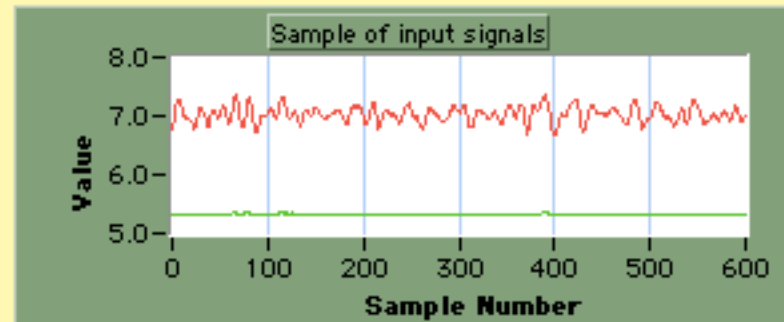

Pitot Vel

HW Voltage



Samples /ch

600

Sampling Rate /ch (Hz)

100.00

HW Volt

3.787

4.688

5.327

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pitot Vel

3.063

5.075

7.024

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Selector