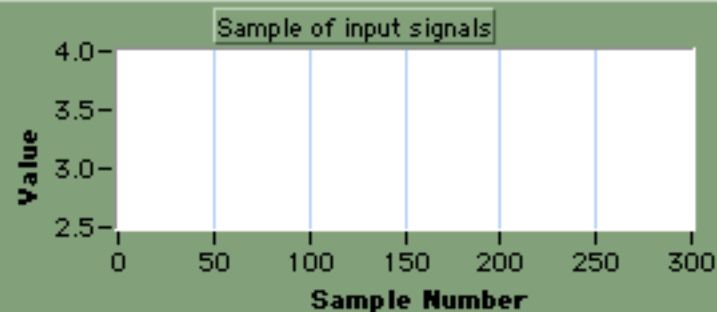


Mode Take a New Calibration Point


iBook_G4_HD :Users :paul_local :Documents :LabVIEW_data :
Examples :Calib_Files :HotWire_Calib.txt

Calib const

n	0.655000
A	-5.117176
B	9.347658
Av % err	0.063069


n 0.45

Find best n

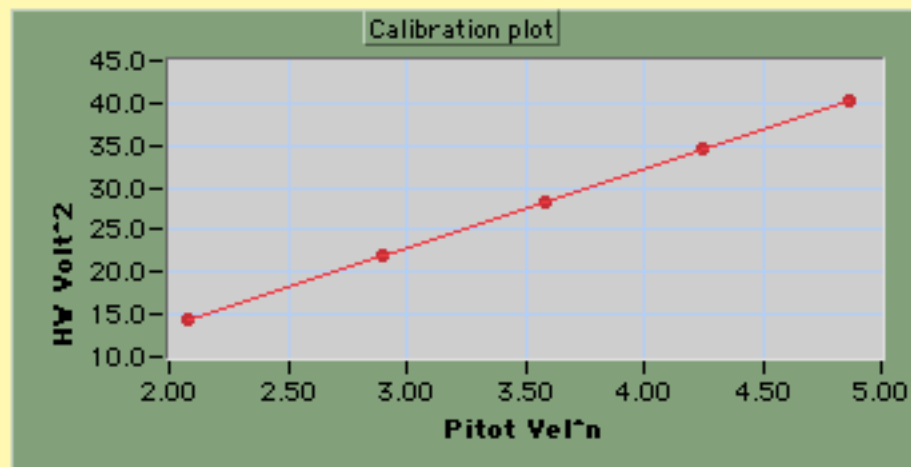

Pitot Vel

HW Voltage



Samples /ch

600

Sampling Rate /ch (Hz)

100.00

HW Volt

3.787

4.688

5.327

5.879

6.349

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pitot Vel

3.063

5.075

7.024

9.084

11.179

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Selector